


PBA439 / PBA439x / PBA439xx

English User Manual Weighing Platform

Svenska Användarmanual Vägningsplattform

Dansk Brugervejledning Vejeplatform

Norsk Brukermanual Veieplattform

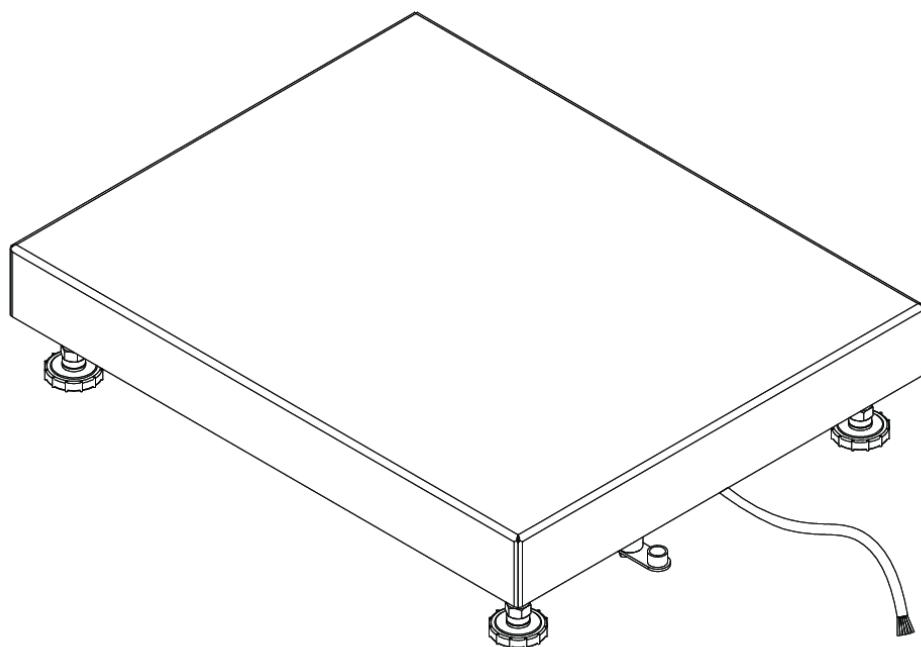

METTLER TOLEDO

User Manual

English

Användarmanual

Svenska

Brugervejledning

Dansk

Brukermanual

Norsk

METTLER TOLEDO Service

Congratulations on choosing the quality and precision of METTLER TOLEDO. Proper use of your new equipment according to this Manual and regular calibration and maintenance by our factory-trained service team ensures dependable and accurate operation, protecting your investment. Contact us about a service agreement tailored to your needs and budget. Further information is available at www.mt.com/service.

There are several important ways to ensure you maximize the performance of your investment:

- 1 **Register your product:** We invite you to register your product at www.mt.com/productregistration so we can contact you about enhancements, updates and important notifications concerning your product.
- 2 **Contact METTLER TOLEDO for service:** The value of a measurement is proportional to its accuracy – an out of specification scale can diminish quality, reduce profits and increase liability. Timely service from METTLER TOLEDO will ensure accuracy and optimize uptime and equipment life.
 - ➔ **Installation, Configuration, Integration and Training:** Our service representatives are factory-trained weighing equipment experts. We make certain that your weighing equipment is ready for production in a cost effective and timely fashion and that personnel are trained for success.
 - ➔ **Initial Calibration Documentation:** The installation environment and application requirements are unique for every industrial scale so performance must be tested and certified. Our calibration services and certificates document accuracy to ensure production quality and provide a quality system record of performance.
 - ➔ **Periodic Calibration Maintenance:** A Calibration Service Agreement provides on-going confidence in your weighing process and documentation of compliance with requirements. We offer a variety of service plans that are scheduled to meet your needs and designed to fit your budget.

Table of Contents

1	Safety Instructions	3
1.1	Intended use	3
1.2	Misuse	3
1.3	Safety Precautions	3
1.4	Specific Conditions of Use.....	3
2	Introduction	4
2.1	Assortment.....	4
2.2	About this Manual.....	4
2.3	Further Documents.....	4
3	Installation and Operation	5
3.1	Checking the Location	5
3.2	Connecting the Weighing Platform to the Weighing Terminal.....	5
3.3	Leveling	6
3.4	Equipotential Bonding	6
3.5	Checking the Weighing Platform.....	6
3.6	Operating the Weighing Platform	7
3.7	Installation, Configuration, Service and Repair.....	7
4	Maintenance	8
4.1	Notes on Cleaning	8
4.2	Subsequent Treatment	8
4.3	Disposal	8
5	Repair	9
6	Technical Data and Operating Limits	10
6.1	Maximum Verification Scale Interval	10
6.2	Maximum Permissible Load.....	10
6.3	Technical Data of Load Cell.....	11
6.3.1	Ex Approval.....	11
6.3.2	Load Cell Compliance Standard.....	11
6.4	Dimensions.....	13
6.5	Information about Capacity Preload	14
6.5.1	Preload Table in Kilogram.....	15
6.5.2	Preload Table in Pound	16
6.6	Accessories.....	17
7	Mounting Possibilities	19
8	Appendix	20
8.1	Label.....	20
8.2	Control Drawing.....	21
8.3	Installation Drawing	22

1 Safety Instructions

1.1 Intended use

PBA439(x/xx) weighing platforms are part of a modular weighing system consisting of a METTLER TOLEDO weighing terminal as indicator and at least one weighing platform.

- Use the weighing platform only for weighing in accordance with this manual.
- The weighing platform is intended for indoor use only.
- Only the PBA439x/xx weighing platform is suitable for use in hazardous environment as specified below.
- Any other type of use is considered as not intended.

Legal metrology

- For use in legal metrology, only use approved weighing platforms.
- When using in legal metrology, the operating company is responsible for observing all national weights & measurements requirements.
- Please contact the METTLER TOLEDO Service organization for questions related to the use in legal for trade applications.

1.2 Misuse

- Do not use the weighing terminal other than for weighing operations.
- Do not use the weighing platform in another environment than specified in the --- MISSING LINK ---.
- Do not modify the weighing platform.
- Do not use the weighing terminal beyond the limits of the technical specifications.
- Do not use the weighing platform for storing goods.
- Avoid falling goods on the weighing platform.

1.3 Safety Precautions

- Only personnel trained and qualified by METTLER TOLEDO may install and maintain the weighing platform.
- Be careful when transporting or lifting heavy devices.
- Always disconnect the weighing platform from the power source before installing, servicing, cleaning or performing maintenance.
- The connection cable may not be disconnected from the weighing terminal while energized.
- Make sure the weighing platform has reached room temperature before switching on the power supply.
- The explosion-protected weighing platforms PBA439x/xx are approved for operation in the following hazardous areas:
 - ATEX/IECEx Category 2, Category 3, gas/dust (Zone 1/21, Zone 2/22)
 - cFMus, Class I,II,III, Div. 1, Div. 2
- There is an increased risk of injury and damage when the weighing platforms are used in hazardous areas! Special care must be taken when working in such areas.
- In case of the PBA439x/xx weighing platform, only use cable glands that are suitable and approved for hazardous areas for inserting the weighing cell cable into the weighing terminal.
- Explosion-protected weighing platforms may only be used in hazardous areas in conjunction with weighing terminals with the appropriate approval and interface specification.

1.4 Specific Conditions of Use

- In an explosive atmosphere caused by air/dust moisture, the loose ends of the cable shall be connected outside the hazardous or in a suitable enclosure with a degree of protection of at least IP6X in accordance with IEC/EN 60529.

2 Introduction

2.1 Assortment

This manual focuses on the product series PBA439(x/xx).

The PBA439(x/xx) series offer a variety of weighing platforms to fit your requirements. It is approvable and offers various sizes and capacities

Type	Load Plate Material	Scale Frame Material	Load Cell Design	Environment IP Protection	Hazardous Approval
PBA439	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel, hermetically sealed	Dry, wet, IP68/IP69K	-
PBA439x	AISI304	AISI304			Zone 1/21, Div 1
PBA439xx					Zone 2/22, Div 2

2.2 About this Manual



This manual contains all information for the operator of the product.

- Read this manual carefully before use.
- Keep this manual for future reference.
- Pass this manual to any future owner or user of the product.

2.3 Further Documents

In addition to this manual you can download the following documents from www.mt.com:

- Brochure
- Installation information (for trained personnel under the control of the operating company)
- Type approval documents

Certificate Download


US, Canada, ATEX, UKEX and IECEx certificates can be downloaded from
<https://www.mt.com/us/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

3 Installation and Operation

3.1 Checking the Location

The correct location is crucial for the accuracy of the weighing results.

- 1 Ensure that the location of the weighing platform is stable, vibration-free and horizontal.
- 2 The surface must be able to bear the weighing platform under maximum load at the points of support.
- 3 Observe the following environmental conditions:
 - No direct sunshine
 - No strong draught or vibration
 - No excessive temperature fluctuations
 - Temperature range -10 °C to +40 °C / 14 °F to 104 °F

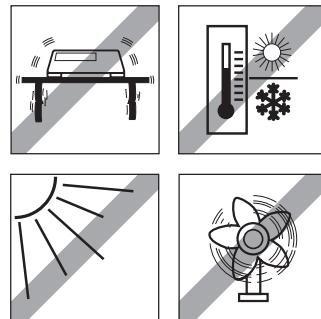

3.2 Connecting the Weighing Platform to the Weighing Terminal

The PBA439(x/xx) weighing platforms are designed for use with analog METTLER TOLEDO weighing terminals.

- 1 Insert the weighing platform cable through the cable gland into the weighing terminal.
- 2 Connect the weighing platform cable to the terminal strip of the weighing terminal according to the following table.

Signal	Wire Color	Connector
SIG+	White	6-WIRE CELLS
SIG-	Red	
EXC+	Green	
EXC-	Black	
SEN+	Yellow	
SEN-	Blue	

⚠ WARNING

The cable shield must be grounded.



Safety Precautions for Connections


- When connecting the weighing platform in hazardous area, strictly follow the requirements as stated in control drawing available in [Appendix ▶ Page 20].
- Please check the special conditions for safe use in the drawings and the certificates in [Appendix ▶ Page 20].
- The cable shield is connected to the load cell spring element (the body of the load cell). Please consider the appropriate connection between load cell and terminal (or junction box) based on the installation scenario.
- The resistance between all safety ground connections and the system grounding electrode must not exceed 1 ohm.
- Installation shall be in accordance with relevant electrical installation standards.
- Not following these instructions will jeopardize the explosion safety.

3.3 Leveling

Only a weighing platform which is aligned exactly horizontally supplies exact weighing results. The weighing platform has to be leveled during the initial installation and whenever its location is changed.

- 1 Turn the adjustable feet of the weighing platform until the air bubble of the spirit level is positioned in the inner circle.
- 2 Tighten the lock nuts of the adjustable feet.

☞ Scan the QR code to watch the video

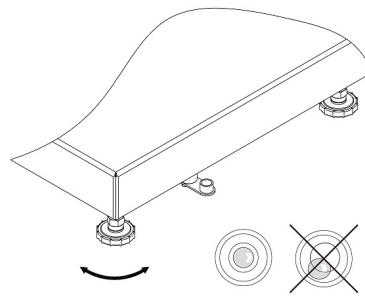


3.4 Equipotential Bonding

The equipotential bonding for the PBA439x/xx weighing platforms is mounted in the factory. The wiring must be installed by a professional electrician on customer site. METTLER TOLEDO Service only has a monitoring and consulting function here. Connect the equipotential bonding (PA) of all devices (weighing platform and weighing terminal) in accordance with the country-specific regulations and standards. In the process, make sure that all device housings are connected to the same potential via the PA terminal.

Note

The equipment is protected against electric shock acc. IEC60950, class II.

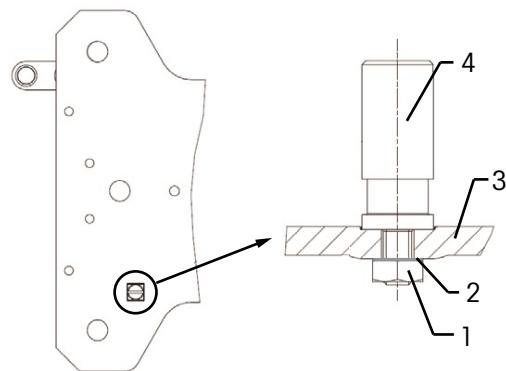


- 1 - Hexagonal lock nut, M4 KEPS
- 2 - Washer
- 3 - Base Frame
- 4 - Equipotential bonding terminal, torque 3.5 Nm

Order number of the equipotential bonding kit 72237321

3.5 Checking the Weighing Platform

Function Check

- 1 Make sure that the weighing platform is connected to a weighing terminal and that the weighing terminal is switched on.
- 2 Make sure that the weighing platform is unloaded and the display of the weighing terminal shows 0.
- 3 Load the weighing platform. The weighing terminal must show a value different from 0.
- 4 Unload the weighing platform. The weighing terminal must return to 0.

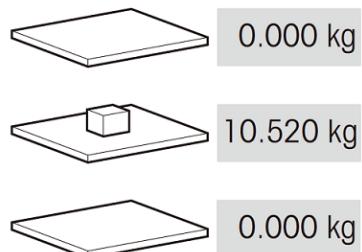


Verification Test

For a verification test refer to the user manual of the connected weighing terminal. If the verification seal is broken, verification is no longer valid.


3.6 Operating the Weighing Platform

For best weighing results, observe the following:


- Ensure the load plate is correctly placed.

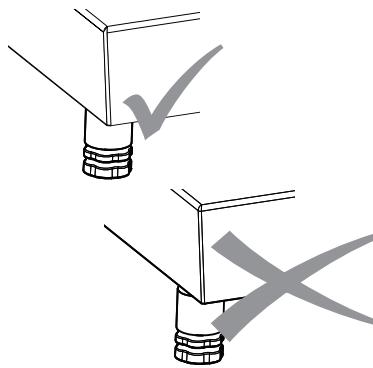


- To achieve best weighing results place the weighing sample always on the same position on the weighing platform.

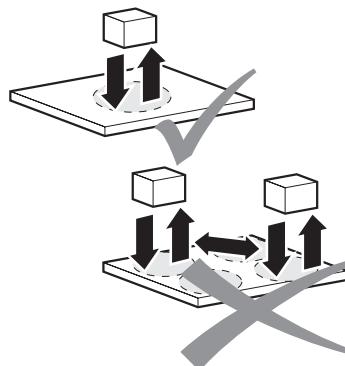

- Avoid abrasive and wear processes.

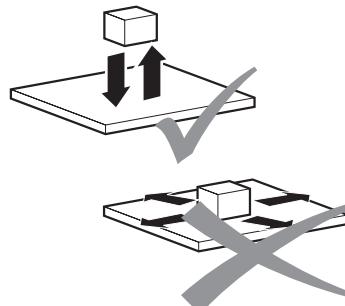

- Avoid falling loads, shocks and lateral impacts.



3.7 Installation, Configuration, Service and Repair

For installation, configuration, service and repair of the weighing platforms call the METTLER TOLEDO Service.

4 Maintenance

4.1 Notes on Cleaning

Note

Damage to the weighing platform due to incorrect use of cleaning agents.


- Only use disinfectants and cleaning agents in accordance with their manufacturer's instructions.
- Do not use highly acidic, highly alkaline or highly chlorinated cleaning agents. Avoid substances with a high or low pH value since increased danger of corrosion otherwise exists.
- Be particularly careful when cleaning the load cell.

Cleaning Procedure

- Remove dirt and deposits at regular intervals from the outside and inside of the weighing platform.
→ The procedure depends both on the type of surface and on the environmental conditions prevailing at the installation location.


Cleaning in a wet environment (stainless steel versions)

- Use a water jet up to 80 °C / 176 °F and max. 80 bars, minimum distance 40 cm / 16".
- Use household cleaning agents.



Cleaning in a corrosive environment (stainless steel versions)


- Use a water jet.
Inner cleaning, load cell, load plate opened: up to 60 °C / 140 °F and max. 2 bars, minimum distance 40 cm / 16".
Outer cleaning, load plat closed: to 80 °C / 176 °F and max. 80 bars, minimum distance 40 cm / 16".
- Remove corrosive substances at regular intervals.
- Only use disinfectants and cleaning agents in accordance with their manufacturer's specifications and instructions



4.2 Subsequent Treatment

In order to protect the scale, carry out the following subsequent treatment:

- Rinse the scale with clear water and remove cleaning agent completely.
- Dry off the scale with a lint-free cloth.
- With stainless steel scales, treat the inside and outside with an oil suitable for foodstuffs.



4.3 Disposal

In conformance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.



Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this device. Should this device be passed on to other parties, the content of this regulation must also be related.

5 Repair

This equipment is certified for use in hazardous locations, therefore no modifications are allowed. Repairs must only be performed by personnel specifically trained for repairs of this equipment.

6 Technical Data and Operating Limits

6.1 Maximum Verification Scale Interval


Max. verification scale interval [e] / OIML	Capacity							
	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
1 x 3000e Max / e [kg]	3 / 0.001	6 / 0.002	15 / 0.005	30 / 0.01	60 / 0.02	150 / 0.05	300 / 0.1	600 / 0.2

Max. verification scale interval [d] / NTEP	Capacity							
	-	10 lb	25 lb	50 lb	100 lb	250 lb	500 lb	1000 lb
1 x 5000d Max / d [lb]	-	10 / 0.002	25 / 0.005	50 / 0.01	100 / 0.02	250 / 0.05	500 / 0.1	1000 / 0.2

6.2 Maximum Permissible Load

All weighing platforms are equipped with an overload protection. With the robust scale design you can occasionally exceed the rated capacity of the platform without damage. The maximum static safe load must never be exceeded.

- Observe the following operation limits.



Model	A - Central Load	B - Side Load	C - Corner Load
PBA439(x/xx)-QA	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-A	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-QB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-BB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-B	200 kg / 400 lb	140 kg / 280 lb	75 kg / 150 lb
PBA439(x/xx)-BC	400 kg / 800 lb	300 kg / 600 lb	150 kg / 300 lb
PBA439(x/xx)-CC	700 kg / 1400 lb	400 kg / 800 lb	200 kg / 400 lb



⚠ WARNING

Avoid falling loads, shock loads as well as impacts from the side.

6.3 Technical Data of Load Cell

Rated Output	mV/V	1.8 ± 0.2
Input Resistance	Ω	384 ± 15
Output Resistance	Ω	350 ± 4
Recommended Voltage	V (DC / AC)	5 - 15
Max. Excited Voltage	V (DC / AC)	20
Cable Sheath	-	PVC
IP Rating	-	IP68/IP69K

6.3.1 Ex Approval

This section covers only the Ex-relevant aspects of the product.

The Load Cell SLP84x(x=6,7,8) has been granted with:

ATEX Certificate	FM21ATEX0003X, FM21ATEX0025X
UK Certificate	FM21UKEX0079X, FM21UKEX0080X
IECEx Certificate	IECEx FMG21.0003X
US Certificate	FM21US0005X
Canadian Certificate	FM21CA0002X

The certificates listed above and the related installation drawings please refer to [Appendix ▶ Page 20].

6.3.2 Load Cell Compliance Standard

US Standards

Title	Number	Issue Date
Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations – General Requirements	FM Class 3600	2018
Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II, and III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations	FM Class 3610	2021
Nonincendive Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2, and Class III, Divisions 1 and 2, Hazardous (Classified) Locations	FM Class 3611	2021
Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use	FM Class 3810	2021
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements	ANSI/UL 60079-0	2019
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"	ANSI/ISA 60079-11	2014
Nonincendive electrical equipment for use in Class I and II, Division 2 and Class III, Divisions 1 and 2 hazardous (classified) locations	ANSI/UL 121201	2017
Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements	ANSI/UL 61010-1	2012
Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)	ANSI/IEC 60529	2020

Canadian Standards

Title	Number	Issue Date
Non-Incendive Electrical Equipment for use in Class I, Division 2 Hazardous Locations	CSA C22.2 No. 213	2017
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0	2019
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11	2014
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-7	2018
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-31	2015

Title	Number	Issue Date
Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements	CSA C22.2 No. 61010-1	2012
Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)	CSA C22.2 No. 60529	2016

IECEx Standards

Title	Number	Issue Date
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements	IEC 60079-0	2017
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"	IEC 60079-11	2011
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"	IEC 60079-7	2017
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"	IEC 60079-31	2013
Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)	IEC 60529	2013


ATEX Standards

Title	Number	Issue Date
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements	EN IEC 60079-0	2018
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"	EN 60079-11	2012
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"	EN 60079-31	2014
Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

UKEX Standards

Title	Number	Issue Date
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements	EN IEC 60079-0	2018
Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"	EN 60079-11	2012
Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"	EN 60079-31	2014
Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

6.4 Dimensions

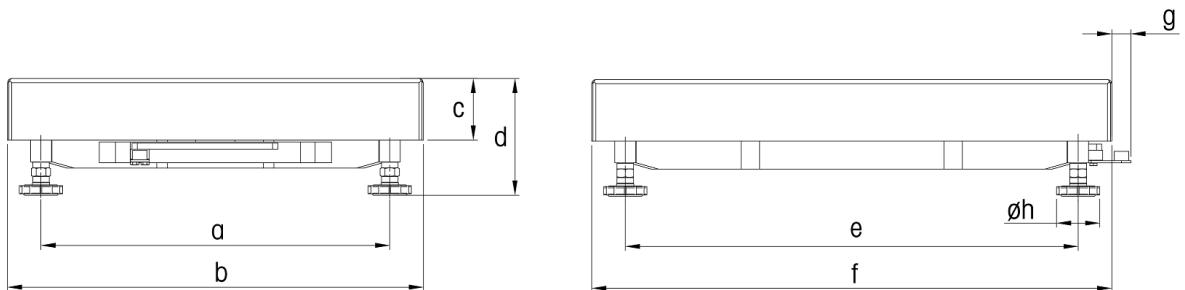


Dimensions		a	b	c	d *	e	f	g	h
PBA439(x/xx)-QA	mm	163	228	56	85.6	163	228	21	42
	inch	6.42	8.98	2.20	3.37	6.42	8.98	0.83	1.65
PBA439(x/xx)-A	mm	175	240	56	85.6	235	300	21	42
	inch	6.89	9.45	2.20	3.37	9.25	11.81	0.83	1.65
PBA439(x/xx)-QB	mm	240	305	57	96.6	253	305	18	42
	inch	9.45	12.01	2.24	3.8	9.96	12.01	0.71	1.65
PBA439(x/xx)-BB	mm	235	300	57	96.6	335	400	18	42
	inch	9.25	11.81	2.24	3.8	13.19	15.75	0.71	1.65
PBA439(x/xx)-B	mm	335	400	59	100.1	435	500	18	42
	inch	13.19	15.75	2.32	3.94	17.13	19.69	0.71	1.65
PBA439(x/xx)-BC	mm	437	500	73	106.8	584	650	17	42
	inch	17.20	19.69	2.87	4.2	22.99	25.59	0.67	1.65
PBA439(x/xx)-CC	mm	503	600	85	128.3	724	800	18	42
	inch	19.80	23.62	3.35	5.05	28.5	31.50	0.71	1.65

* : 1) d= minimum platform height. With the adjustable scale feet, the platform height can increase by 10 mm / 0.39 inch at maximum.

2) With the hygienic kit option, the minimum platform height (d) increases by 12 mm / 0.47 inch.

6.5 Information about Capacity Preload

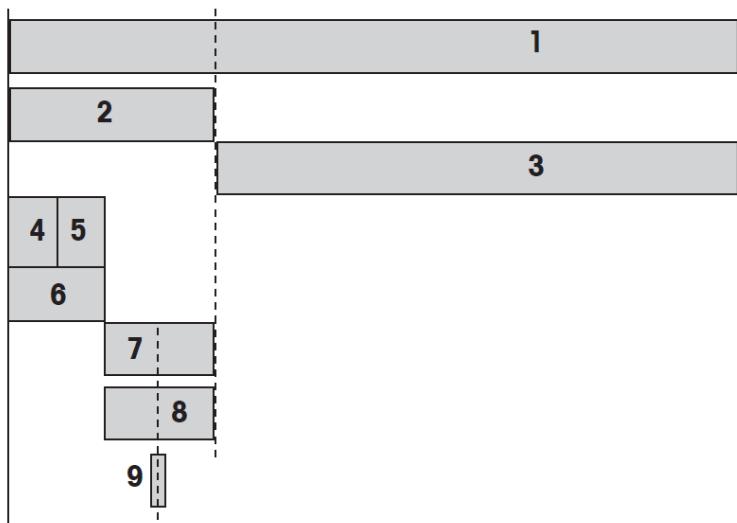

1	Maximum load range of the load cell (E_{\max})
2	Maximum preload = Maximum load range 1 – Maximum load 3
3	Maximum load = Maximum load range 1 – Maximum preload 2
4	Preload top section
5	Preload weighing pan
6	Preload ex works = Preload top section 4 + Preload weighing pan 5
7	Mechanical prelaod reserve = Maximum preload 2 – Preload ex works 6
8	The zero-set range (switching on) can be set. The zero-set range must lie within the maximum preload. The zero-set range may amount to a max. of 18 % of the maximum load.
9	Zero-set range $\pm 2 \%$ of the maximum load

6.5.1 Preload Table in Kilogram

Type	Dimensions [mm]	Max. load (3)	Preload top section (4)	Preload weighing pan (5)	Preload ex works (6)	Mech. preload reserve (7)	Zero set range (8)	Max. load range (1)
PBA439(x/xx)-QA3	228x228	3	1.04	0.95	1.99	6.01	0.54	11
PBA439(x/xx)-QA6	228x228	6	1.04	0.95	1.99	3.01	1.08	11
PBA439(x/xx)-A3	240x300	3	1.49	1.23	2.72	5.28	0.54	11
PBA439(x/xx)-A6	240x300	6	1.49	1.23	2.72	2.28	1.08	11
PBA439(x/xx)-A15	240x300	15	1.49	1.23	2.72	4.28	2.70	22
PBA439(x/xx)-QB15	305x305	15	1.70	1.51	3.21	3.79	2.70	22
PBA439(x/xx)-QB30	305x305	30	1.70	1.51	3.21	16.79	5.40	50
PBA439(x/xx)-QB60	305x305	60	1.70	1.51	3.21	36.79	10.80	100
PBA439(x/xx)-BB30	300x400	30	2.08	1.86	3.94	16.06	5.40	50
PBA439(x/xx)-BB60	300x400	60	2.08	1.86	3.94	36.06	10.80	100
PBA439(x/xx)-B30	400x500	30	3.45	2.85	6.30	13.70	5.40	50
PBA439(x/xx)-B60	400x500	60	3.45	2.85	6.30	33.70	10.80	100
PBA439(x/xx)-B150	400x500	150	3.45	2.85	6.30	43.70	27.00	200
PBA439(x/xx)-BC60	500x650	60	7.00	5.80	12.80	27.20	10.80	100
PBA439(x/xx)-BC150	500x650	150	7.00	58.00	65.00	35.00	27.00	250
PBA439(x/xx)-BC300	500x650	300	7.00	5.80	12.80	187.20	54.00	500
PBA439(x/xx)-CC60	600x800	60	9.36	11.00	20.36	19.64	10.80	100
PBA439(x/xx)-CC150	600x800	150	9.36	11.00	20.36	79.64	27.00	250
PBA439(x/xx)-CC300	600x800	300	9.36	11.00	20.36	179.64	54.00	500
PBA439(x/xx)-CC600	600x800	600	11.50	14.10	25.60	124.40	108.00	750

6.5.2 Preload Table in Pound

Type	Dimensions [inch]	Max. load (3)	Preload top section (4)	Preload weighing pan (5)	Preload ex works (6)	Mech. preload reserve (7)	Zero set range (8)	Max. load range (1)
PBA439(x/xx)-QA6	9x9	10	2.29	2.09	4.39	9.86	1.8	24
PBA439(x/xx)-A6	9.5x11.8	10	3.28	2.71	6.00	8.25	1.8	24
PBA439(x/xx)-A15	9.5x11.8	25	3.28	2.71	6.00	17.51	4.5	49
PBA439(x/xx)-QB15	12x12	25	3.75	3.33	7.08	16.42	4.5	49
PBA439(x/xx)-QB30	12x12	50	3.75	3.33	7.08	53.15	9.0	110
PBA439(x/xx)-QB60	12x12	100	3.75	3.33	7.08	113.39	18.0	220
PBA439(x/xx)-BB30	11.8x15.7	50	4.59	4.10	8.69	51.54	9.0	110
PBA439(x/xx)-BB60	11.8x15.7	100	4.59	4.10	8.69	111.78	18.0	220
PBA439(x/xx)-B30	15.7x19.7	50	7.61	6.28	13.89	46.34	9.0	110
PBA439(x/xx)-B60	15.7x19.7	100	7.61	6.28	13.89	106.57	18.0	220
PBA439(x/xx)-B150	15.7x19.7	250	7.61	6.28	13.89	177.04	45.0	441
PBA439(x/xx)-BC60	19.7x25.6	100	15.43	12.79	28.22	92.24	18.0	220
PBA439(x/xx)-BC150	19.7x25.6	250	15.43	127.87	143.30	157.86	45.0	551
PBA439(x/xx)-BC300	19.7x25.6	500	15.43	12.79	28.22	574.09	90.0	1102
PBA439(x/xx)-CC60	23.6x29.5	100	20.64	24.25	44.89	75.58	18.0	220
PBA439(x/xx)-CC150	23.6x29.5	250	20.64	24.25	44.89	256.27	45.0	551
PBA439(x/xx)-CC300	23.6x29.5	500	20.64	24.25	44.89	557.43	90.0	1102
PBA439(x/xx)-CC600	23.6x29.5	1000	25.35	31.09	56.44	597.03	180.0	1653

6.6 Accessories

Column

Article #	Designation	Description
72229393	Column open 120 mm / 4.7"	Fits for all platform size
72198702	Column open 330mm / 13"	Fits for all platform size
72198703	Column open 660 mm / 26"	Fits for all platform size
72198704	Column open 900 mm / 35.4"	Fits for all platform size larger than A-size

Stainless Steel Cart

Article #	Designation	Description
72225939	Stainless steel cart BC	Fits for BC-size platform
72225940	Stainless steel cart CC	Fits for CC-size platform

Roller Track

Article #	Designation	Description
30253326	Roller track 400 × 500 mm / 15.7" × 19.7" stainless steel	Fits for B-size platform. Roll to short side of platform
30253328	Roller track 500 × 650 mm / 19.7" × 25.6" stainless steel	Fits for BC-size platform. Roll to short side of platform
30253330	Roller track 600 × 800 mm / 23.6" × 31.5" stainless steel	Fits for CC-size platform. Roll to short side of platform
30253327	Roller track 400 × 500 mm / 15.7" × 19.7" stainless steel	Fits for B-size platform. Roll to long side of platform
30253329	Roller track 500 × 650 mm / 19.7" × 25.6" stainless steel	Fits for BC-size platform. Roll to long side of platform
30253331	Roller track 600 × 800 mm / 23.6" × 31.5" stainless steel	Fits for CC-size platform. Roll to long side of platform
30640393	Roller track 400 × 500 mm / 15.7" × 19.7" stainless steel	Fits for hazardous area
30640394	Roller track 500 × 650 mm / 19.7" × 25.6" stainless steel	Fits for hazardous area
30640395	Roller track 600 × 800 mm / 23.6" × 31.5" stainless steel	Fits for hazardous area

Front Mount Bracket

Article #	Designation	Description
22021062	Front mount bracket	Fit for ICS4_9 front mount

Stainless Steel Platter


Article #	Designation	Description
30676769	AISI 316 stainless steel platter 240 x 300 mm / 9.5" x 11.8"	Fits for A-size platform
30676770	AISI 316 stainless steel platter 300 x 400 mm / 11.8" x 15.7"	Fits for BB-size platform
30676771	AISI 316 stainless steel platter 400 x 500 mm / 15.7" x 19.7"	Fits for B-size platform
30676772	AISI 316 stainless steel platter 228 x 228 mm / 9" x 9"	Fits for QA-size platform
30676773	AISI 316 stainless steel platter 305 x 305 mm / 12" x 12"	Fits for QB-size platform
30676774	AISI 316 stainless steel platter 500 x 650 mm / 19.7" x 25.6"	Fits for BC-size platform

Article #	Designation	Description
30676775	AISI 316 stainless steel platter, thickness 2.0 mm, 600 x 800 mm / 23.6" x 31.5"	Fits for CC-size platform
30676776	AISI 316 stainless steel platter, thickness 2.5 mm, 600 x 800 mm / 23.6" x 31.5"	Fits for CC-size platform

7 Mounting Possibilities



The PBA439(x/xx) supports mounting on stable device. In case drilling on the weighing platform is required, follow the drilling pattern below.

NOTE: The shadow areas are where drilling on the weighing platform is allowed.

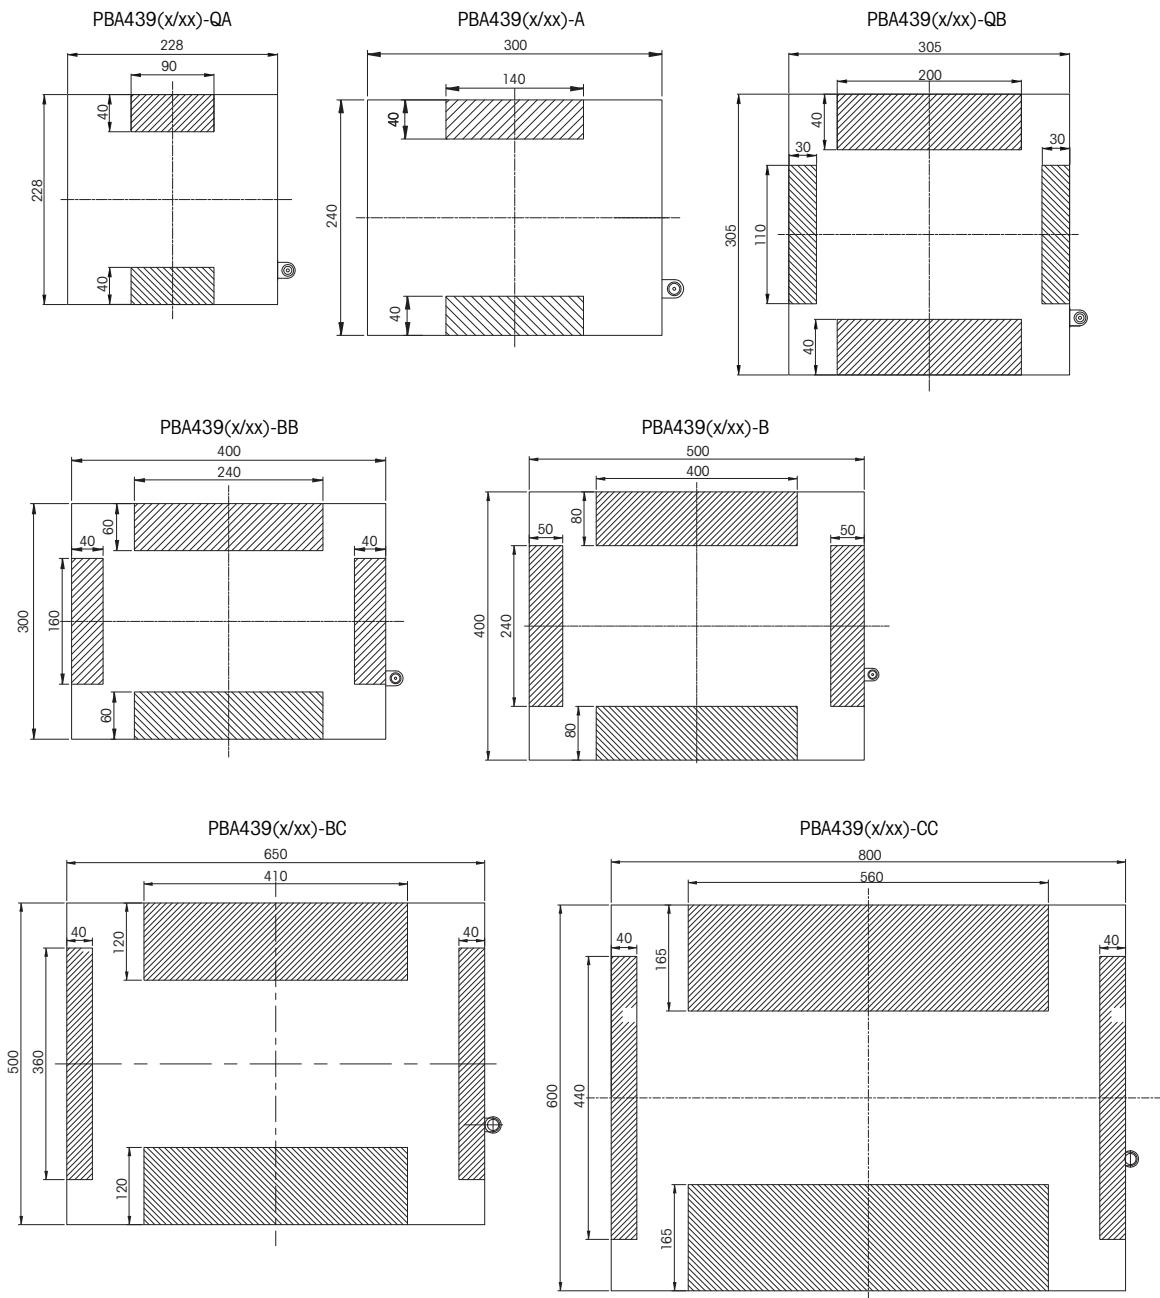


8 Appendix

8.1 Label

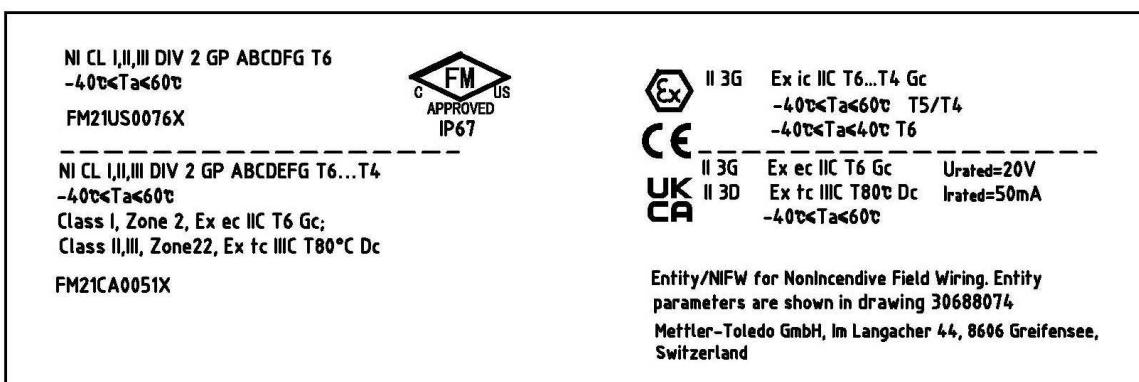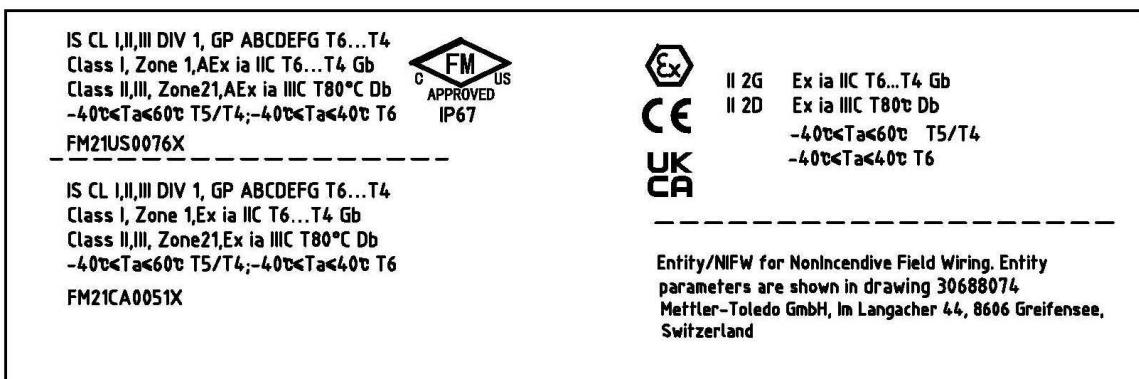

8.2 Control Drawing

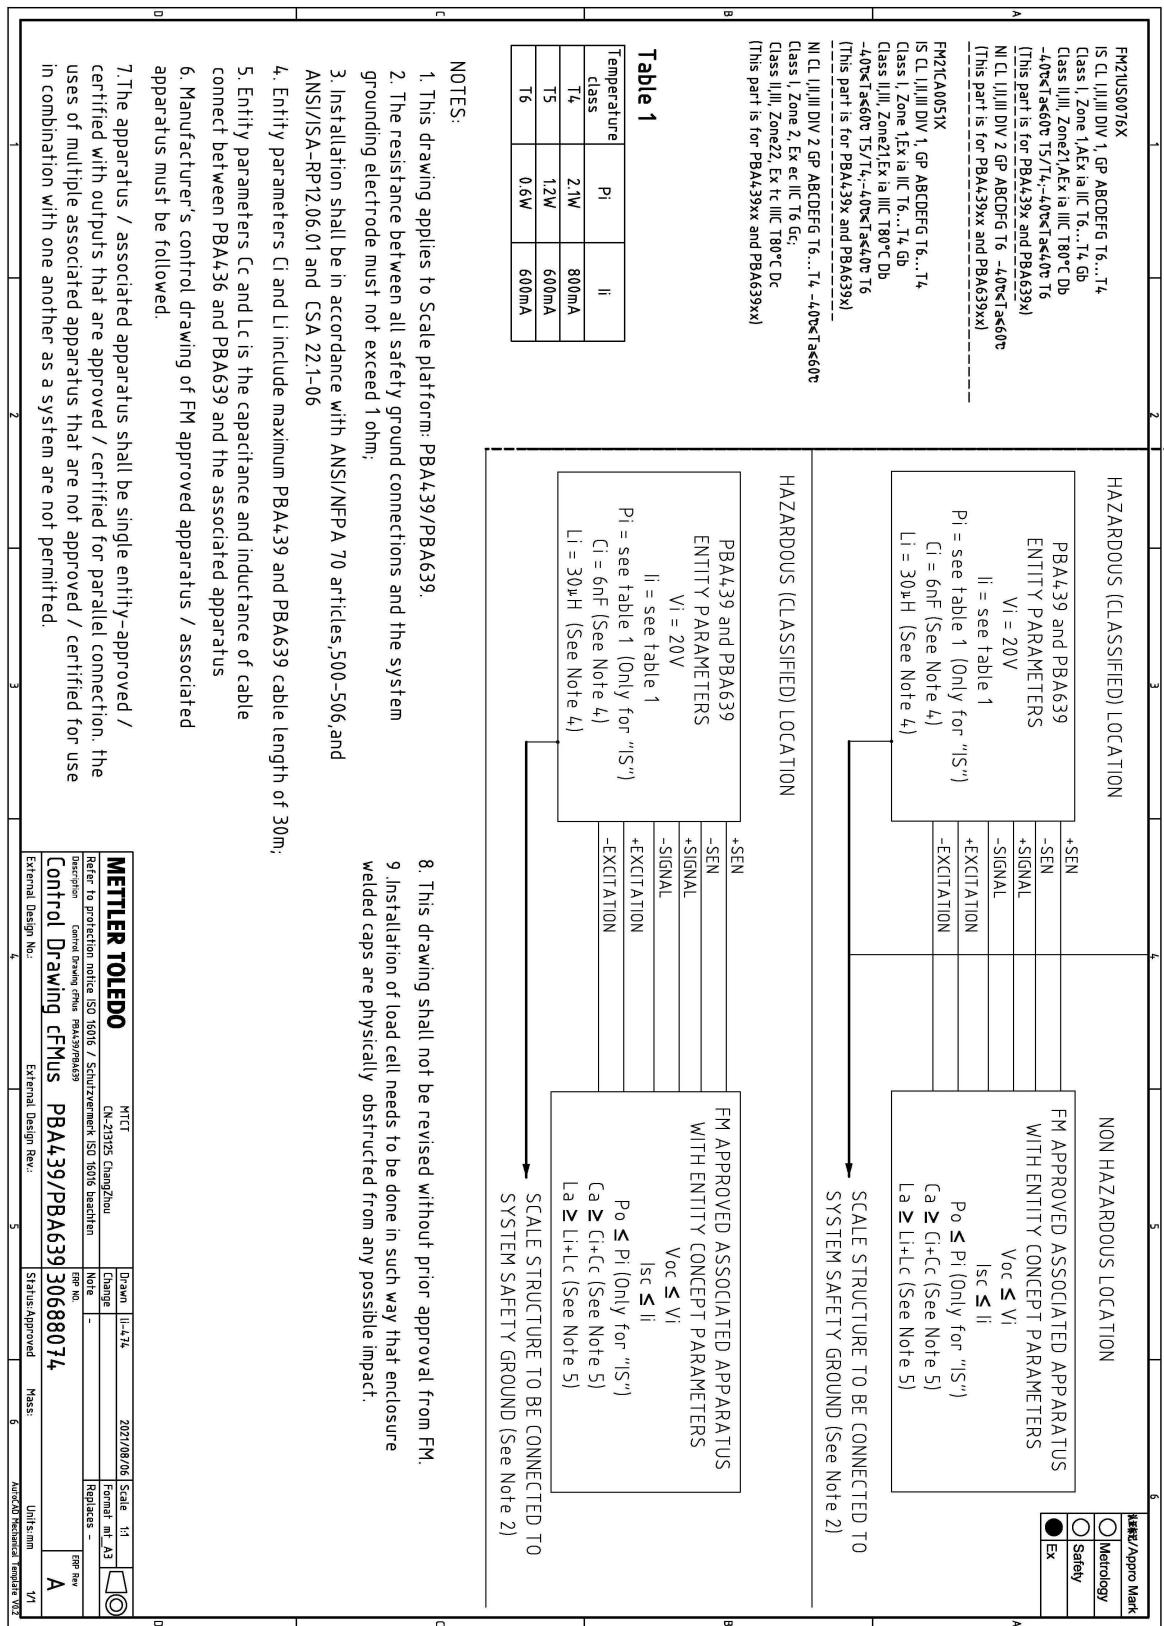

8.3 Installation Drawing

<p>Hazardous (Classified) Location</p> <p>IP67 II 3G Ex ic IIC T6...T4 Gc $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tas} \leq 60^{\circ}\text{C}$ T5/T4; $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tas} \leq 40^{\circ}\text{C}$ T6</p> <p>CE II 3G Ex ec IIC T6 Gc $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tas} \leq 60^{\circ}\text{C}$ T6</p> <p>UKCA II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc</p> <p>FM21UKEX0080X FM21ATEX0025X IECEEx FMG21.0003X</p> <hr/> <p>CE 0344 II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tas} \leq 60^{\circ}\text{C}$ T5/T4; $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Tas} \leq 40^{\circ}\text{C}$ T6</p> <p>UKCA 22815 II 2D Ex ia IIIC T80°C Db</p> <p>FM21UKEX0079X FM21ATEX0003X IECEEx FMG21.0003X</p> <p>SLP84x Load Cell $Ui = 20\text{V}$ $li = \text{see table2}$ $Pi = \text{see table 2}$ $Ci = 6\text{nF}$ $Li = 30\mu\text{H}$</p> <p>+Excitation(Green) -Excitation(Black) +SEN(Yellow) -SEN(Blue) +Signal(White) -Signal(Red)</p> <p>Unclassified Location</p> <p>Ex Approved Associated Apparatus with Entity Concept Parameters $Uo \leqslant Ui$ $Io \leqslant li$ $Po \leqslant pi$ $Co \geqslant Cc + Ci$ $Lo \geqslant Lc + Li$</p> <p>Scale structure (attached to load cell) to be connected to system safety ground. See Note.</p> <p>NOTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> The resistance between all safety ground connections and the system grounding electrode must not exceed 1ohm. Installation shall be in accordance with relevant electrical installation standards (Being shown in Table 1)in hazardous areas(other than mines). Entity Parameters Ci And Li Include Maximum Load Cell Cable Length Of 30m Entity Parameters Cc and Lc is the capacitance and inductance of cable connect between load cell and the associated apparatus. In an explosive atmosphere caused by air/dust mixtures, the loose ends of the cable shall be connected outside the hazardous area or in a suitable enclosure with a degree of protection of at least IP6X in accordance with EN 60529. For the application of Ex ec, Ex tc: Urated=20V, Irated=50mA. Installation of load cell needs to be done in such way that enclosure welded caps are physically obstructed from any possible impact. Not following these instructions will jeopardize the explosion safety. For the application of Ex ec, The equipment shall only be used in an area of at least pollution degree 2, as defined in IEC 60664-1. <p>Table 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">EN60079-0: 2018</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-14: 2014</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-11: 2012</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-31: 2014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">EN61241-14: 2004</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-31: 2013</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-7: 2015</td> <td style="padding: 2px;">IEC60079-31: 2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-0-2017</td> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-11-2011</td> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-14-2013</td> <td style="padding: 2px;">IEC60079-7: 2015</td> </tr> </table> <p>Table 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Temperature class</th> <th style="width: 20%;">Pi</th> <th style="width: 20%;">li</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T4</td> <td>2.1W</td> <td>800mA</td> </tr> <tr> <td>T5</td> <td>1.2W</td> <td>600mA</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>0.6W</td> <td>600mA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland Mettler-Toledo Ltd. 64 Boston Rd, Leicester, LE4 1AW, United Kingdom</p> <p>REVISION HISTORY</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">D</th> <th style="width: 50%;">DESCRIPTION</th> <th style="width: 10%;">BY</th> <th style="width: 10%;">APPVD</th> <th style="width: 10%;">AGENCY</th> <th style="width: 10%;">E.R. No.</th> <th style="width: 10%;">DATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>update drawing status</td> <td>Wang jianwen</td> <td>Liu yuchun</td> <td></td> <td></td> <td>2021-7-26</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>removed Ex nA of note6</td> <td>Wang jianwen</td> <td>Liu yuchun</td> <td></td> <td></td> <td>2021-1-15</td> </tr> <tr> <td>REV / CHG</td> <td>RECORD OF CHANGES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>METTLER TOLEDO MTCZ CN-213022 ChangZhou</p> <p>Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten</p> <p>Description 防爆安装图 SLP84X INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx 30555321</p> <p>External Design No.: D000644580 External Design Rev.: D Status: Approved Mass: Units: mm 1/1</p> <p>ERP NO. Replaces - ERP Rev. D</p> <p>AutoCAD Mechanical Template V0.2</p>	EN60079-0: 2018	EN60079-14: 2014	EN60079-11: 2012	EN60079-31: 2014	EN61241-14: 2004	EN60079-31: 2013	EN60079-7: 2015	IEC60079-31: 2013	IEC 60079-0-2017	IEC 60079-11-2011	IEC 60079-14-2013	IEC60079-7: 2015	Temperature class	Pi	li	T4	2.1W	800mA	T5	1.2W	600mA	T6	0.6W	600mA	D	DESCRIPTION	BY	APPVD	AGENCY	E.R. No.	DATE	D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun			2021-7-26	C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun			2021-1-15	REV / CHG	RECORD OF CHANGES						<p>Approval Mark</p> <p>THIS ITEM IS PART OF AGENCY APPROVED PRODUCT</p> <p><input type="checkbox"/> Metrology <input checked="" type="checkbox"/> Safety <input checked="" type="checkbox"/> Ex</p> <p>DO NOT CHANGE DOCUMENT WITHOUT APPROPRIATE APPROVAL</p>
EN60079-0: 2018	EN60079-14: 2014	EN60079-11: 2012	EN60079-31: 2014																																																		
EN61241-14: 2004	EN60079-31: 2013	EN60079-7: 2015	IEC60079-31: 2013																																																		
IEC 60079-0-2017	IEC 60079-11-2011	IEC 60079-14-2013	IEC60079-7: 2015																																																		
Temperature class	Pi	li																																																			
T4	2.1W	800mA																																																			
T5	1.2W	600mA																																																			
T6	0.6W	600mA																																																			
D	DESCRIPTION	BY	APPVD	AGENCY	E.R. No.	DATE																																															
D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun			2021-7-26																																															
C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun			2021-1-15																																															
REV / CHG	RECORD OF CHANGES																																																				

METTLER TOLEDO Service

Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna bruksanvisning och regelbunden kalibrering och underhåll av vårt fabriksutbildade service-team säkerställer tillförlitlig och exakt drift för att skydda din investering. Kontakta oss för ett serviceavtal skräddarsytt till dina behov och din budget. Mer information finns på www.mt.com/service.

Det finns flera viktiga sätt att säkerställa att du maximerar prestandan på din investering:

- 1 **Registrera din produkt:** Du kan registrera produkten på www.mt.com/productregistration så att vi kan kontakta dig om förbättringar, uppdateringar och viktiga aviseringar gällande din produkt.
- 2 **Kontakta METTLER TOLEDO för service:** Värde på ett mått är proportionellt till dess exakthet – en våg som inte följer specifikationerna kan försämra kvaliteten, minska nyttan och öka bördan. Service i rätt tid från METTLER TOLEDO säkerställer exaktheten och optimerar klartid och utrustningens livslängd.
 - ➔ **Installation, konfiguration, integration och utbildning:** Våra servicerepresentanter är fabriksutbildade experter för vägningsutrustning. Vi säkerställer att din vägningsutrustning är produktionsklar på ett kostnadseffektivt och tidsenligt sätt och att vår personal är utbildad för framgång.
 - ➔ **Dokumentation för första kalibrering:** Installationsmiljön och applikationskraven är unika för varje industriwäg, så prestandan måste testas och certifieras. Våra kalibreringstjänster och certifikat dokumenterar exakthet för att säkerställa produktionskvalitet och tillhandahålla ett kvalitetssystem med topprestanca.
 - ➔ **Periodiskt kalibreringsunderhåll:** Ett serviceavtal för kalibrering ger ständig tillförsikt i vägningsprocessen och dokumentation för överensstämelse med kraven. Vi erbjuder en mångfald av serviceplaner som är utformade för att uppfylla dina behov och passa med din budget.

Register

1	Säkerhetsinstruktioner	3
1.1	Avsedd användning	3
1.2	Felaktig användning	3
1.3	Säkerhetsåtgärder	3
1.4	Specifika förhållanden för användning	3
2	Inledning	4
2.1	Sortiment	4
2.2	Om denna bruksanvisning	4
2.3	Ytterligare dokument	4
3	Installation och drift	5
3.1	Kontroll av platsen	5
3.2	Ansluta vägningsplattformen till vägningsterminalen	5
3.3	Nivellering	6
3.4	Potentialutjämning	6
3.5	Kontrollera vägningsplattformen	6
3.6	Använda vägningsplattformen	7
3.7	Installation, konfiguration, service och reparation	7
4	Underhåll	8
4.1	Noteringar om rengöring	8
4.2	Efterföljande behandling	8
4.3	Kassering	8
5	Reparationer	9
6	Tekniska data och driftgränser	10
6.1	Maximalt verifieringsvägintervall	10
6.2	Maximalt tillåten belastning	10
6.3	Tekniska data för lastcellen	11
6.3.1	Ex-godkännande	11
6.3.2	Överensstämmelsestandard för lastcell	11
6.4	Mått	13
6.5	Information om kapacitetsförbelastning	14
6.5.1	Förbelastningstabell i kilogram	15
6.5.2	Förbelastningstabell i pund	16
6.6	Tillbehör	17
7	Monteringsmöjligheter	19
8	Bilaga	20
8.1	Etikett	20
8.2	Kontrollritning	21
8.3	Installationsritning	22

1 Säkerhetsinstruktioner

1.1 Avsedd användning

PBA439(x/xx) Vägningsplattformar är en del av ett modulärt vägningssystem bestående av en METTLER TOLEDO-vägningsterminal som indikator och minst en vägningsplattform.

- Använd vägningsplattformen endast för vägning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Vägningsplattformen är avsedd endast för användning inomhus.
- Endast PBA439x/xx-vägningsplattformen är lämplig för användning i farlig miljö enligt specifikationen nedan.
- All annan användning betraktas som ej avsedd.

Legal metrologi

- Använd endast godkända vägningsplattformar för användning i legal metrologi.
- Vid användning i legal metrologi ansvarar driftbolaget för att observera alla nationella vikt- och måttkrav.
- Kontakta METTLER TOLEDO:s serviceorganisation för frågor rörande användning i lagliga handelsapplikationer.

1.2 Felaktig användning

- Använd inte vägningsterminalen för annat än vägningsarbeten.
- Använd inte vägningsplattformen i en annan miljö än vad som anges i --- MISSING LINK ---.
- Modifiera inte vägningsplattformen.
- Använd inte vägningsterminalen bortom gränserna för tekniska specifikationer.
- Använd inte vägningsplattformen för förvaring av varor.
- Undvik fallande gods på vägningsplattformen.

1.3 Säkerhetsåtgärder

- Endast personal som utbildats och kvalificerats av METTLER TOLEDO får installera och underhålla vägningsplattformen.
- Var försiktig när du transporterar eller lyfter tunga enheter.
- Koppla alltid bort vägningsplattformen från strömkällan innan du installerar, utför service, rengöring eller underhåll.
- Anslutningskabeln får inte kopplas bort från vägningsterminalen när den är strömsatt.
- Se till att vägningsplattformen har nått rumstemperatur innan du slår på strömförsörjningen.
- De explosionsskyddade vägningsplattformarna PBA439x/xx är godkända för användning i följande farliga områden:
 - ATEX/IECEx kategori 2, kategori 3, gas/damm (zon 1/21, zon 2/22)
 - cFMus, klass I,II,III, div. 1, div. 2
- Det föreligger en ökad risk för personskador och materiella skador när vägningsplattformarna används i farliga områden! Särskild försiktighet måste vidtas vid arbete i sådana områden.
- Gällande PBA439x/xx-vägningsplattformen, använd endast packboxar som är lämpliga och godkända för farliga områden för att föra in vägningscellkabeln i vägningsterminalen.
- Explosionsskyddade vägningsplattformar får endast användas i farliga områden i samband med vägningsterminaler med lämplig godkännande- och gränssnittsspecifikation.

1.4 Specifika förhållanden för användning

- I en explosiv atmosfär orsakad av luft/damm och fukt ska de lösa ändarna av kabeln anslutas utanför den farliga atmosfären eller i en lämplig inhägnad med en skyddsgrad på minst IP6X i enlighet med IEC/EN 60529.

2 Inledning

2.1 Sortiment

Denna bruksanvisning fokuserar på produktserien PBA439(x/xx).

PBA439(x/xx) Serien erbjuder en mångfald av vägningsplattformar för att uppfylla dina behov. Den är möjliga att godkänna och erbjuder olika storlekar och kapacitet.

Typ	Lastplattans ma- terial	Vågramens ma- terial	Lastcellens de- sign	Miljö-IP-skydd	Färgodkän- nande
PBA439	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål, her- metiskt kapslad	Torr, våt, IP68/IP69K	-
PBA439x	AISI304	AISI304			Zon 1/21, div 1
PBA439xx					Zon 2/22, div 2

2.2 Om denna bruksanvisning



Denna bruksanvisning innehåller all information för operatören av produkten.

- Läs denna bruksanvisning noga före användning.
- Bevara denna bruksanvisning för framtida referens.
- Vidarebefordra denna bruksanvisning till eventuell framtida ägare eller användare av produkten.

2.3 Ytterligare dokument

Utöver denna utskrivna bruksanvisning kan du ladda ner följande dokument från www.mt.com:

- Broschyr
- Installationsinformation (för utbildad personal under kontroll av driftbolaget)
- Typgodkännandedokument

Ladda ner certifikat


Certifikat för US, Kanada, ATEX, UKEX och IECEEx kan laddas ner från
<https://www.mt.com/us/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

3 Installation och drift

3.1 Kontroll av platsen

Korrekt plats är avgörande för noggrannheten på vägningsresultaten.

- 1 Se till att platsen för vägningsplattformen är stabil, vibrationsfri och horisontell.
- 2 Underlaget måste kunna bärä vägningsplattformen under maximal belastning vid stödpunkterna.
- 3 Observera följande miljöförhållanden:
 - Inget direkt solljus
 - Inga kraftiga luftdrag eller vibrationer
 - Inga stora temperatursvängningar
 - Temperaturområde -10°C till $+40^{\circ}\text{C}$ / 14°F till 104°F

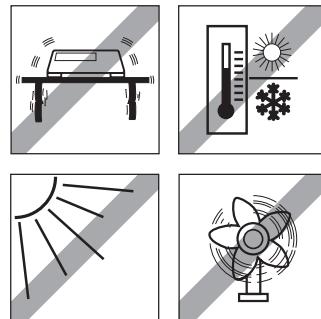

3.2 Ansluta vägningsplattformen till vägningsterminalen

PBA439(x/xx) Vägningsplattformarna är utformade för användning med analoga METTLER TOLEDO-vägningsterminaler.

- 1 För in vägningsplattformens kabel genom packboxen och in i vägningsterminalen.
- 2 Anslut vägningsplattformens kabel till anslutningsplinten för vägningsterminalen i enlighet med följande tabell.

Signal	Ledningsfärg	Kontaktdon
SIG+	Vit	CELLER FÖR 6 LEDNING/
SIG-	Röd	
EXC+	Grön	
EXC-	Svart	
SEN+	Gul	
SEN-	Blå	

VARNING

Kabelavskärmningen måste vara jordad.



Säkerhetsåtgärder för anslutningar


- Vid anslutning av vägningsplattformen i ett farligt område, fölж ovillkorligen kraven som anges i kontrollritningen som finns i [Bilaga ▶ sidan 20].
- Kontrollera de särskilda förhållandena för säker användning i ritningarna och certifikaten i [Bilaga ▶ sidan 20].
- Kabelavskärmningen ansluts till lastcellens fjäderelement (lastcellens stomme). Beakta lämplig anslutning mellan lastcellen och terminalen (eller kopplingsboxen) baserat på installationsscenariot.
- Resistansen mellan alla skyddsjordade anslutningar och den systemjordade elektroden får inte överstiga 1 ohm.
- Installationen ska ske i enlighet med relevanta standarder för elektrisk installation.
- Om dessa instruktioner inte följs äventyras explosionssäkerheten.

3.3 Nivellering

För att leverera korrekta vägningsresultat måste vägningsplattformen stå helt horisontellt. Vägningsplattformen måste nivelleras under den inledande installation och när dess plats byts.

- 1 Skruva på vägningsplattformens justerbara fötter tills luftbubblan i vattenpasset befinner sig i den inre cirkeln.
- 2 Dra åt de justerbara fötternas låsmuttrar.

☞ **Skanna QR-koden för att se videon**

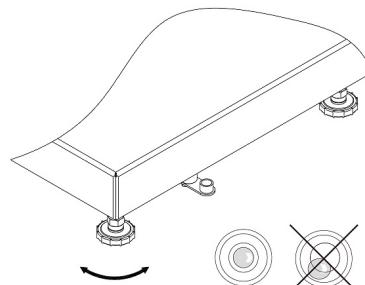


3.4 Potentialutjämning

Potentialutjämningen för PBA439x/xx-vägningsplattformarna monteras på fabriken. Ledningarna måste installeras av en professionell elektriker på kundplatsen. METTLER TOLEDO service har här endast en övervakande och konserterande funktion. Anslut potentialutjämningen (PA) för alla enheter (vägningsplattform och vägningsterminal) i enlighet med de landsspecifika föreskrifterna och standarderna. Se i denna process till att alla enhetshus ansluts till samma potential via PA-terminalen.

Obs!

Utrustningen är skyddad mot elstötar enligt IEC60950, klass II.

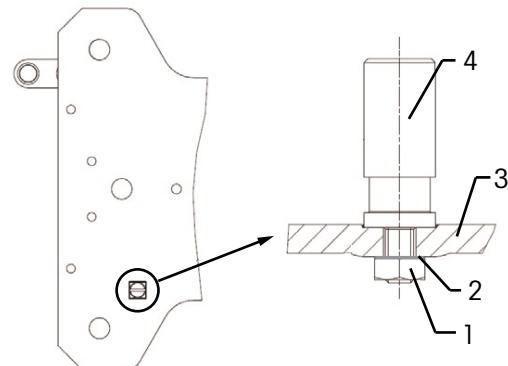


- 1 - Sextantlåsmutter, M4 KEPS
- 2 - Bricka
- 3 - Fundament
- 4 - Potentialutjämningsterminal, vridmoment 3,5 Nm

Beställningsnummer för
potentialutjämningssatsen
72237321

3.5 Kontrollera vägningsplattformen

Funktionskontroll

- 1 Se till att vägningsplattformen är ansluten till en vägningsterminal och att vägningsterminalen är påslagen.
- 2 Se till att inga föremål befinner sig på vägningsplattformen och att vägningsterminalens display visar 0.
- 3 Lägg ett föremål på vägningsplattformen. Vägningsterminalen måste visa ett annat värde än 0.
- 4 Ta bort föremålet från vägningsplattformen. Vägningsterminalen måste återgå till 0.

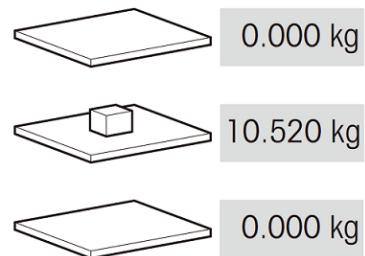


Verifikationstest

Se bruksanvisningen till den anslutna vägningsterminalen för ett verifikationstest. Om verifikationsplomberingen är bruten är inte längre verifikationen giltig.


3.6 Använda vägningsplattformen

Observera följande för bästa vägningsresultat:


- Se till att lastplattan är korrekt på plats.

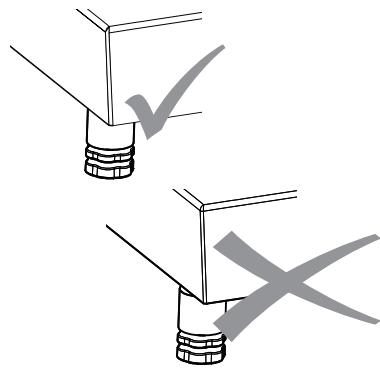


- Placera alltid vägningsprovet på samma position på vägningsplattformen för att uppnå bästa vägningsresultat.

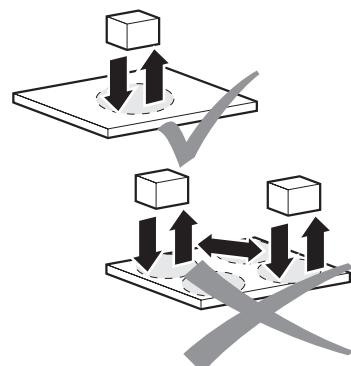

- Undvik slipande och nötande procedurer.

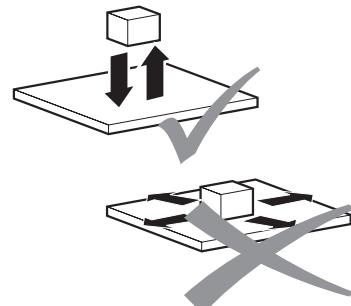

- Undvik fallande last, stötar och sidokollisioner



3.7 Installation, konfiguration, service och reparation

För installation, konfiguration, service och reparation av vägningsplattformarna, ring METTLER TOLEDO service.

4 Underhåll

4.1 Noteringar om rengöring

Anteckning

Skada på vägningsplattformen på grund av felaktig användning av rengöringsmedel.


- Använd endast desinfektionsmedel och rengöringsmedel i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd inte mycket syrahaltiga, alkaliska eller klorhaltiga rengöringsmedel. Undvik ämnen med ett högt eller lågt pH-värde, eftersom ökad korrosionsrisk annars föreligger.
- Var särskilt försiktig när du rengör lastcellen.

Rengöringsprocedur

- Avlägsna smuts och avlagringar vid regelbundna intervall från utsidan och insidan av vägningsplattformen.
→ Proceduren beror på både typen av yta och miljöförhållandena som råder på installationsplatsen.


Rengöring i en våt miljö (versioner i rostfritt stål)

- Använd en vattenstråle upp till 80 °C / 176 °F och max. 80 bar, minsta avstånd 40 cm / 16".
- Använd hushållsrengöringsmedel.



Rengöring i en korrosiv miljö (versioner i rostfritt stål)


- Använd en vattenstråle.
Inre rengöring, lastcell, lastplatta öppnad: upp till 60 °C / 140 °F och max. 2 bar, minsta avstånd 40 cm / 16".
Yttre rengöring, lastplatta stängd: till 80 °C / 176 °F och max. 80 bar, minsta avstånd 40 cm / 16".
- Avlägsna korrosiva ämnen vid regelbundna intervall.
- Använd endast desinfektionsmedel och rengöringsmedel i enlighet med tillverkarens specifikationer och instruktioner.



4.2 Efterföljande behandling

Utför därför följande behandling för att skydda vågen:

- Skölj vågen med klart vatten och avlägsna rengöringsmedel helt.
- Torka av vågen med en luddfri trasa.
- Med vågar i rostfritt stål, behandla insidan och utsidan med en olja som är lämplig för livsmedel.



4.3 Kassering

I överensstämmelse med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna enhet inte kastas bland hushållsavfall. Detta gäller även för länder utanför EU enligt respektive lands specifika krav.

Denna produkt ska lämnas in till en insamlingsanläggning för elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med nationella bestämmelser. Vid eventuella frågor kontaktar du ansvarig myndighet eller den leverantör som du köpte denna utrustning av. Om den här enheten lämnas vidare till andra parter måste innehörd i denna regel också följa med.



5 Reparationer

Denna utrustning är certifierad för användning på farliga platser, och därför är inga modifieringar tillåtna. Reparationer får endast utföras av personal med särskild utbildning för reparationer av denna utrustning.

6 Tekniska data och driftgränser

6.1 Maximalt verifieringsvågintervall


Max. verifieringsvågintervall [e] / OIML	Kapacitet							
	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
1 x 3000e Max / e [kg]	3 / 0.001	6 / 0.002	15 / 0.005	30 / 0.01	60 / 0.02	150 / 0.05	300 / 0.1	600 / 0.2

Max. verifieringsvågintervall [d] / NTEP	Kapacitet							
	-	10 lb	25 lb	50 lb	100 lb	250 lb	500 lb	1000 lb
1 x 5000d Max / d [lb]	-	10 / 0.002	25 / 0.005	50 / 0.01	100 / 0.02	250 / 0.05	500 / 0.1	1000 / 0.2

6.2 Maximalt tillåten belastning

Alla vägningsplattformar är utrustade med ett överbelastningsskydd. Med den robusta vågkonstruktionen kan du emellanåt överskrida plattformens nominella kapacitet utan skada. Den maximala statiska, säkra belastningen får aldrig överskridas.

- Observera följande driftgränser.



Modell	A - Mittbelastning	B - Sidobelastning	C - Hörnbela
PBA439(x/xx)-QA	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-A	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-QB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-BB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-B	200 kg / 400 lb	140 kg / 280 lb	75 kg / 150 lb
PBA439(x/xx)-BC	400 kg / 800 lb	300 kg / 600 lb	150 kg / 300 lb
PBA439(x/xx)-CC	700 kg / 1400 lb	400 kg / 800 lb	200 kg / 400 lb



VARNING

Undvik fallande laster, stötar och sidokollisioner.

6.3 Tekniska data för lastcellen

Märkeffekt	mV/V	$1,8 \pm 0,2$
Ingångsresistans	Ω	384 ± 15
Utgångsresistans	Ω	350 ± 4
Rekommenderad spänning	V (DC / AC)	5 - 15
Max. inducerad spänning	V (DC / AC)	20
Kabelmantel	-	PVC
IP-klass	-	IP68/IP69K

6.3.1 Ex-godkännande

Detta avsnitt täcker endast de ex-relevantas aspekterna av produkten.

Lastcellen SLP84x(x=6,7,8) har beviljats:

ATEX-certifikat	FM21ATEX0003X, FM21ATEX0025X
UK-certifikat	FM21UKEX0079X, FM21UKEX0080X
IECEx-certifikat	IECEx FMG21.0003X
US-certifikat	FM21US0005X
Kanada-certifikat	FM21CA0002X

För certifikaten som anges ovan och de relaterade installationsritningarna, se [Bilaga ▶ sidan 20].

6.3.2 Överensstämmelsestandard för lastcell

US-standarder

Titel	Nummer	Ut-färdandatedatum
Elektrisk utrustning för användning på farliga (klassificerade) platser – Allmänna krav	FM-klass 3600	2018
Egensäkra apparater och tillhörande apparater för användning i klass I, II och III, division 1, farliga (klassificerade) platser	FM-klass 3610	2021
Icke-tändbenägen elektrisk utrustning för användning i klass I och II, division 2, och klass III, division 1 och 2, farliga (klassificerade) platser	FM-klass 3611	2021
Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och för användning i laboratorium	FM-klass 3810	2021
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna krav	ANSI/UL 60079-0	2019
Explosiv atmosfär – Del 11: Utrustningsskydd genom egensäkerhet "i"	ANSI/ISA 60079-11	2014
Icke-tändbenägen elektrisk utrustning för användning i klass I och II, division 2, och klass III, division 1 och 2, farliga (klassificerade) platser	ANSI/UL 121201	2017
Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och användning i laboratorium – Del 1: Allmänna krav	ANSI/UL 61010-1	2012
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)	ANSI/IEC 60529	2020

Kanada-standarder

Titel	Nummer	Ut-färdandatedatum
Icke-tändbenägen elektrisk utrustning för användning i klass I, division 2, farliga platser	CSA C22.2 nr 213	2017
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna krav	CAN/CSA-C22.2 nr 60079-0	2019
Explosiv atmosfär - Del 11: Utrustningsskydd genom egensäkerhet "i"	CAN/CSA-C22.2 nr 60079-11	2014

Titel	Nummer	Ut-färdandatedatum
Explosiv atmosfär - Del 7: Utrustningsskydd genom ökad säkerhet "e"	CAN/CSA-C22.2 nr 60079-7	2018
Explosiv atmosfär - Del 31: Utrustning i utförande med dammskyddande kapsling "t"	CAN/CSA-C22.2 nr 60079-31	2015
Säkerhetskrav för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och användning i laboratorium – Del 1: Allmänna krav	CSA C22.2 nr 61010-1	2012
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)	CSA C22.2 nr 60529	2016

IECEx-standarder

Titel	Nummer	Ut-färdandatedatum
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna krav	IEC 60079-0	2017
Explosiv atmosfär - Del 11: Utrustningsskydd genom egensäkerhet "i"	IEC 60079-11	2011
Explosiv atmosfär - Del 7: Utrustningsskydd genom ökad säkerhet "e"	IEC 60079-7	2017
Explosiv atmosfär - Del 31: Utrustning i utförande med dammskyddande kapsling "t"	IEC 60079-31	2013
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)	IEC 60529	2013


ATEX-standarder

Titel	Nummer	Ut-färdandatedatum
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna krav	EN IEC 60079-0	2018
Explosiv atmosfär - Del 11: Utrustningsskydd genom egensäkerhet "i"	EN 60079-11	2012
Explosiv atmosfär - Del 7: Utrustningsskydd genom ökad säkerhet "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Explosiv atmosfär - Del 31: Utrustning i utförande med dammskyddande kapsling "t"	EN 60079-31	2014
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

UKEX-standarder

Titel	Nummer	Ut-färdandatedatum
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna krav	EN IEC 60079-0	2018
Explosiv atmosfär - Del 11: Utrustningsskydd genom egensäkerhet "i"	EN 60079-11	2012
Explosiv atmosfär - Del 7: Utrustningsskydd genom ökad säkerhet "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Explosiv atmosfär - Del 31: Utrustning i utförande med dammskyddande kapsling "t"	EN 60079-31	2014
Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

6.4 Mått

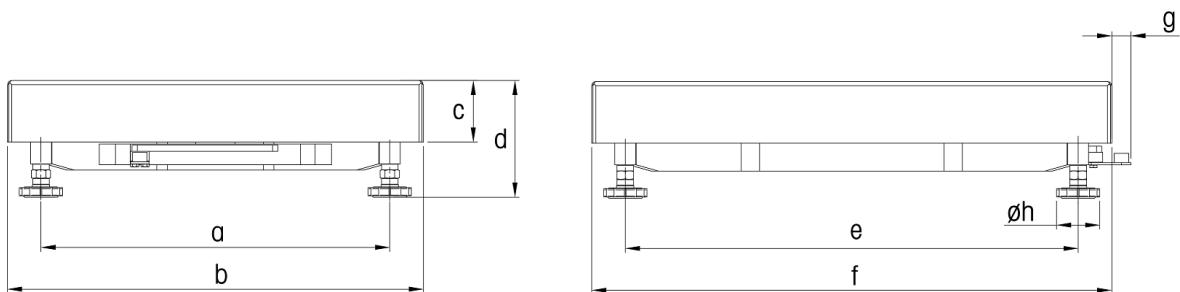


Mått		a	b	c	d *	e	f	g	h
PBA439(x/xx)-QA	mm	163	228	56	85,6	163	228	21	42
	tum	6,42	8,98	2,20	3,37	6,42	8,98	0,83	1,65
PBA439(x/xx)-A	mm	175	240	56	85,6	235	300	21	42
	tum	6,89	9,45	2,20	3,37	9,25	11,81	0,83	1,65
PBA439(x/xx)-QB	mm	240	305	57	96,6	253	305	18	42
	tum	9,45	12,01	2,24	3,8	9,96	12,01	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-BB	mm	235	300	57	96,6	335	400	18	42
	tum	9,25	11,81	2,24	3,8	13,19	15,75	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-B	mm	335	400	59	100,1	435	500	18	42
	tum	13,19	15,75	2,32	3,94	17,13	19,69	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-BC	mm	437	500	73	106,8	584	650	17	42
	tum	17,20	19,69	2,87	4,2	22,99	25,59	0,67	1,65
PBA439(x/xx)-CC	mm	503	600	85	128,3	724	800	18	42
	tum	19,80	23,62	3,35	5,05	28,5	31,50	0,71	1,65

* : 1) d= minsta plattformshöjd. Med vägens justerbara fötter kan plattformshöjden öka med maximalt 10 mm / 0,39 tum.

2) Med den hygieniska tillvalssatsen ökar plattformens minsta höjd (d) med 12 mm / 0,47 tum.

6.5 Information om kapacitetsförbelastning

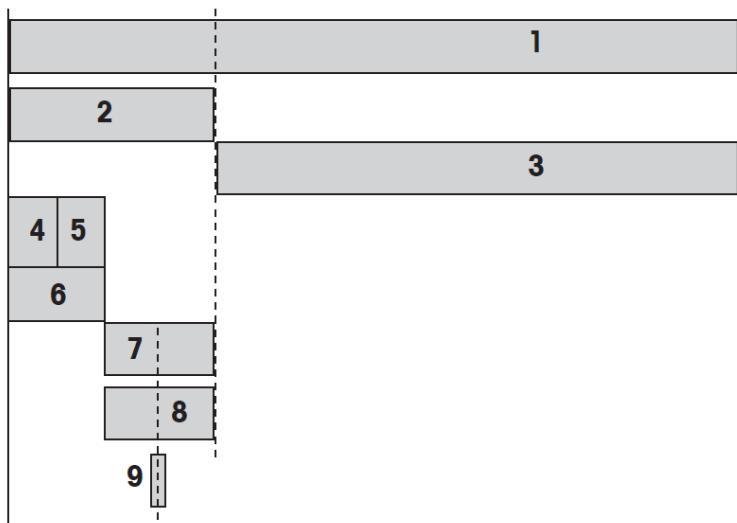

1	Maximalt belastningsområde för lastcellen (E_{max})
2	Maximal förbelastning = Maximalt belastningsområde 1 – Maximal belastning 3
3	Maximal belastning = Maximalt belastningsområde 1 – Maximal förbelastning 2
4	Förbelastning övre sektion
5	Förbelastning vågskål
6	Förbelastning ex works = Förbelastning övre sektion 4 + Förbelastning vågskål 5
7	Mekanisk förbelastningsreserv = Maximal förbelastning 2 – Förbelastning ex works 6
8	Det nollinställda området (tillkoppling) kan ställas in. Det nollinställda området måste ligga inom den maximala förbelastningen. Det nollinställda området kan uppgå till max. 18 % av den maximala belastningen.
9	Nollinställt område $\pm 2\%$ av den maximala belastningen

6.5.1 Förbelastningstabell i kilogram

Typ	Mått [mm]	Max. belastning (3)	Förbelastning övre sektion (4)	Förbelastning vågskål (5)	Förbelastning ex works (6)	Mek. Förbelastningsreserv (7)	Nollinställt område (8)	Max. belastningsområde (1)
PBA439(x/xx)-QA3	228x228	3	1,04	0,95	1,99	6,01	0,54	11
PBA439(x/xx)-QA6	228x228	6	1,04	0,95	1,99	3,01	1,08	11
PBA439(x/xx)-A3	240x300	3	1,49	1,23	2,72	5,28	0,54	11
PBA439(x/xx)-A6	240x300	6	1,49	1,23	2,72	2,28	1,08	11
PBA439(x/xx)-A15	240x300	15	1,49	1,23	2,72	4,28	2,70	22
PBA439(x/xx)-QB15	305x305	15	1,70	1,51	3,21	3,79	2,70	22
PBA439(x/xx)-QB30	305x305	30	1,70	1,51	3,21	16,79	5,40	50
PBA439(x/xx)-QB60	305x305	60	1,70	1,51	3,21	36,79	10,80	100
PBA439(x/xx)-BB30	300x400	30	2,08	1,86	3,94	16,06	5,40	50
PBA439(x/xx)-BB60	300x400	60	2,08	1,86	3,94	36,06	10,80	100
PBA439(x/xx)-B30	400x500	30	3,45	2,85	6,30	13,70	5,40	50
PBA439(x/xx)-B60	400x500	60	3,45	2,85	6,30	33,70	10,80	100
PBA439(x/xx)-B150	400x500	150	3,45	2,85	6,30	43,70	27,00	200
PBA439(x/xx)-BC60	500x650	60	7,00	5,80	12,80	27,20	10,80	100
PBA439(x/xx)-BC150	500x650	150	7,00	58,00	65,00	35,00	27,00	250
PBA439(x/xx)-BC300	500x650	300	7,00	5,80	12,80	187,20	54,00	500
PBA439(x/xx)-CC60	600x800	60	9,36	11,00	20,36	19,64	10,80	100
PBA439(x/xx)-CC150	600x800	150	9,36	11,00	20,36	79,64	27,00	250
PBA439(x/xx)-CC300	600x800	300	9,36	11,00	20,36	179,64	54,00	500
PBA439(x/xx)-CC600	600x800	600	11,50	14,10	25,60	124,40	108,00	750

6.5.2 Förbelastningstabell i pund

Typ	Mått [tum]	Max. belastning (3)	Förbelastning övre sektion (4)	Förbelastning vågskål (5)	Förbelastning ex works (6)	Mek. Förbelastningsreserv (7)	Nollinställt område (8)	Max. belastningsområde (1)
PBA439(x/xx)-QA6	9x9	10	2,29	2,09	4,39	9,86	1,8	24
PBA439(x/xx)-A6	9,5x11,8	10	3,28	2,71	6,00	8,25	1,8	24
PBA439(x/xx)-A15	9,5x11,8	25	3,28	2,71	6,00	17,51	4,5	49
PBA439(x/xx)-QB15	12x12	25	3,75	3,33	7,08	16,42	4,5	49
PBA439(x/xx)-QB30	12x12	50	3,75	3,33	7,08	53,15	9,0	110
PBA439(x/xx)-QB60	12x12	100	3,75	3,33	7,08	113,39	18,0	220
PBA439(x/xx)-BB30	11,8x15,7	50	4,59	4,10	8,69	51,54	9,0	110
PBA439(x/xx)-BB60	11,8x15,7	100	4,59	4,10	8,69	111,78	18,0	220
PBA439(x/xx)-B30	15,7x19,7	50	7,61	6,28	13,89	46,34	9,0	110
PBA439(x/xx)-B60	15,7x19,7	100	7,61	6,28	13,89	106,57	18,0	220
PBA439(x/xx)-B150	15,7x19,7	250	7,61	6,28	13,89	177,04	45,0	441
PBA439(x/xx)-BC60	19,7x25,6	100	15,43	12,79	28,22	92,24	18,0	220
PBA439(x/xx)-BC150	19,7x25,6	250	15,43	127,87	143,30	157,86	45,0	551
PBA439(x/xx)-BC300	19,7x25,6	500	15,43	12,79	28,22	574,09	90,0	1102
PBA439(x/xx)-CC60	23,6x29,5	100	20,64	24,25	44,89	75,58	18,0	220
PBA439(x/xx)-CC150	23,6x29,5	250	20,64	24,25	44,89	256,27	45,0	551
PBA439(x/xx)-CC300	23,6x29,5	500	20,64	24,25	44,89	557,43	90,0	1102
PBA439(x/xx)-CC600	23,6x29,5	1000	25,35	31,09	56,44	597,03	180,0	1653

6.6 Tillbehör

Pelare

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
72229393	Pelare öppen 120mm / 4,7"	Passar för alla plattformsstorlekar
72198702	Pelare öppen 330mm / 13"	Passar för alla plattformsstorlekar
72198703	Pelare öppen 660mm / 26"	Passar för alla plattformsstorlekar
72198704	Pelare öppen 900mm / 35,4"	Passar för alla plattformsstorlekar större än A-storlek

Vagn i rostfritt stål

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
72225939	Vagn i rostfritt stål BC	Passar för plattform i BC-storlek
72225940	Vagn i rostfritt stål CC	Passar för plattform i CC-storlek

Rullbana

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
30253326	Rullbana 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rostfritt stål	Passar för plattform i B-storlek. Rulla till plattformens korta sida.
30253328	Rullbana 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rostfritt stål	Passar för plattform i BC-storlek. Rulla till plattformens korta sida.
30253330	Rullbana 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rostfritt stål	Passar för plattform i CC-storlek. Rulla till plattformens korta sida.
30253327	Rullbana 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rostfritt stål	Passar för plattform i B-storlek. Rulla till plattformens långa sida.
30253329	Rullbana 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rostfritt stål	Passar för plattform i BC-storlek. Rulla till plattformens långa sida.
30253331	Rullbana 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rostfritt stål	Passar för plattform i CC-storlek. Rulla till plattformens långa sida.
30640393	Rullbana 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rostfritt stål	Passar för farligt område
30640394	Rullbana 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rostfritt stål	Passar för farligt område
30640395	Rullbana 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rostfritt stål	Passar för farligt område

Främre monteringsfäste

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
22021062	Främre monteringsfäste	Passar för främre montering ICS4_9

Platta i rostfritt stål


Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
30676769	Platta AISI 316 i rostfritt stål 240 x 300 mm / 9,5" x 11,8"	Passar för plattform i A-storlek
30676770	Platta AISI 316 i rostfritt stål 300 x 400 mm / 11,8" x 15,7"	Passar för plattform i BB-storlek
30676771	Platta AISI 316 i rostfritt stål 400 x 500 mm / 15,7" x 19,7"	Passar för plattform i B-storlek
30676772	Platta AISI 316 i rostfritt stål 228 x 228 mm / 9" x 9"	Passar för plattform i QA-storlek
30676773	Platta AISI 316 i rostfritt stål 305 x 305 mm / 12" x 12"	Passar för plattform i QB-storlek
30676774	Platta AISI 316 i rostfritt stål 500 x 650 mm / 19,7" x 25,6"	Passar för plattform i BC-storlek

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
30676775	Platta AISI 316 i rostfritt stål, tjocklek 2,0 mm, 600 x 800 mm / 23,6" x 31,5"	Passar för plattform i CC-storlek
30676776	Platta AISI 316 i rostfritt stål, tjocklek 2,5 mm, 600 x 800 mm/23,6" x 31,5"	Passar för plattform i CC-storlek

7 Monteringsmöjligheter



PBA439(x/xx) stöder montering på stabil anordning. Om borring på vägningsplattformen är nödvändig, följ borrhögtref nedan.

OBS! På de skuggade områdena är borring tillåten på vägningsplattformen.

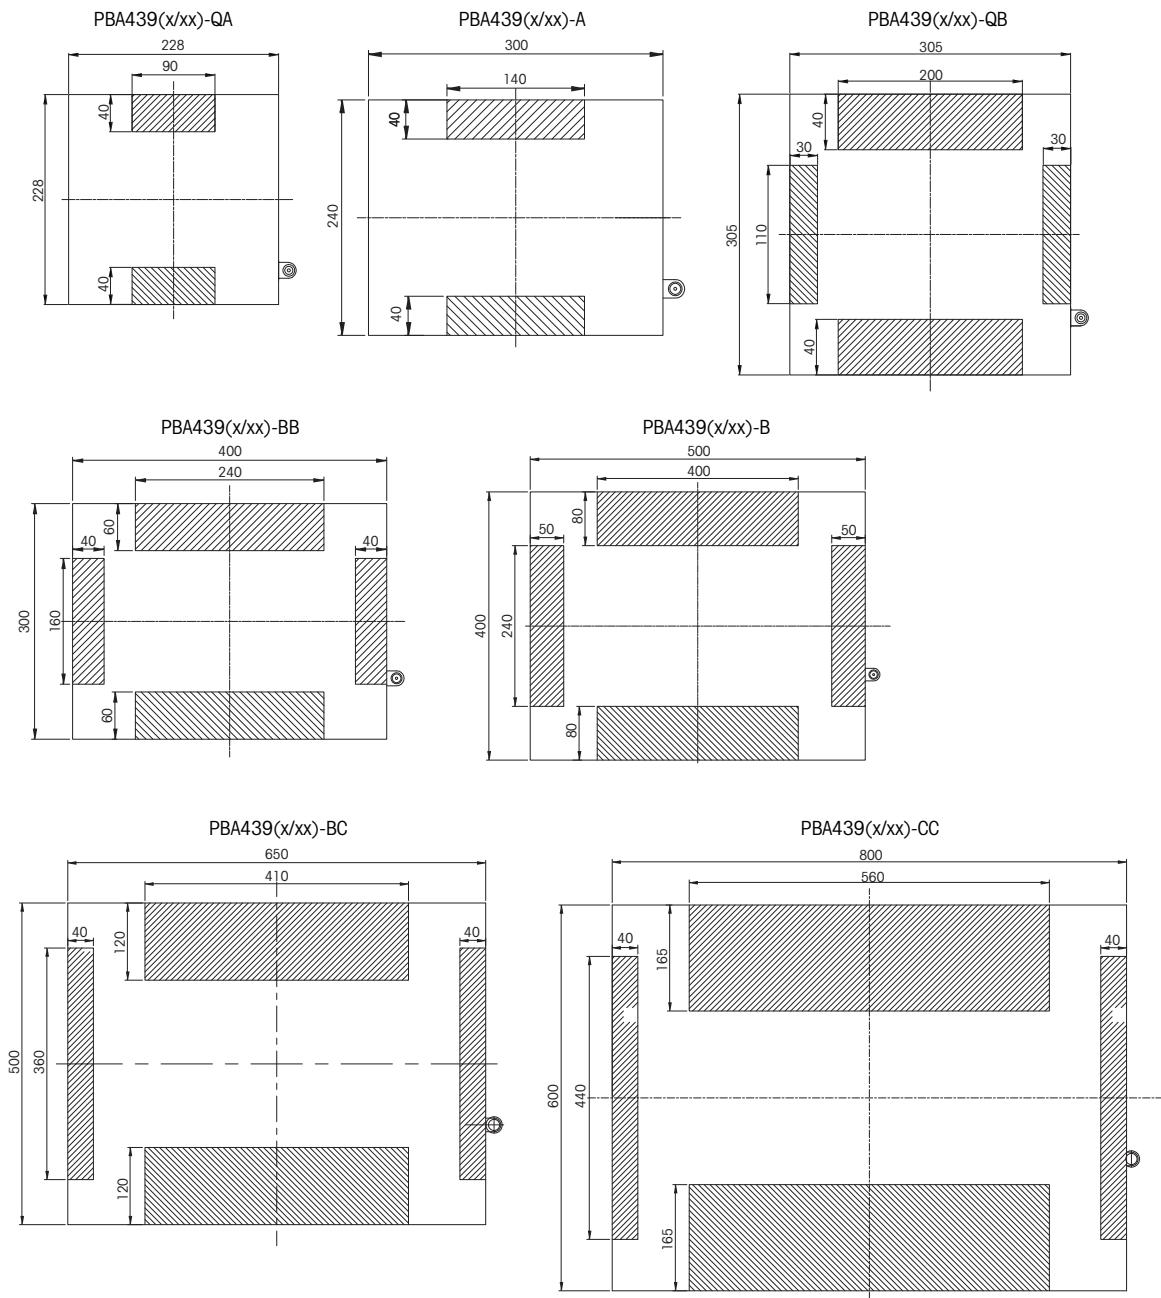

8 Bilaga

8.1 Etikett

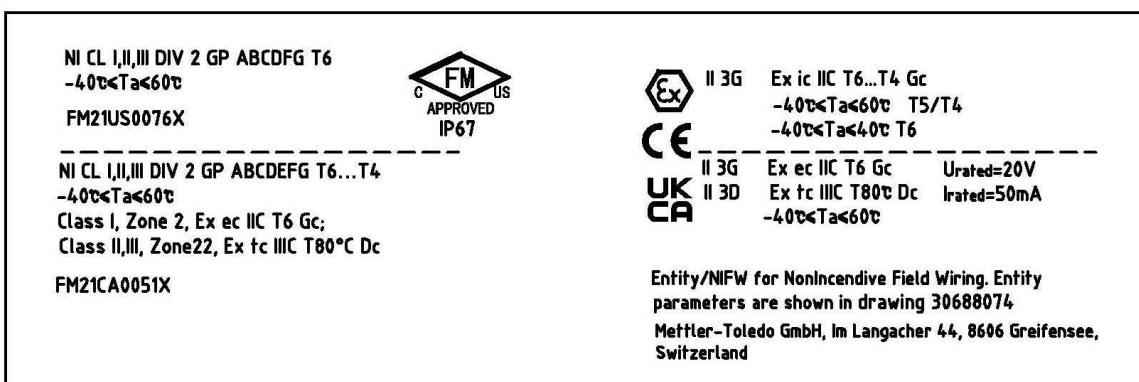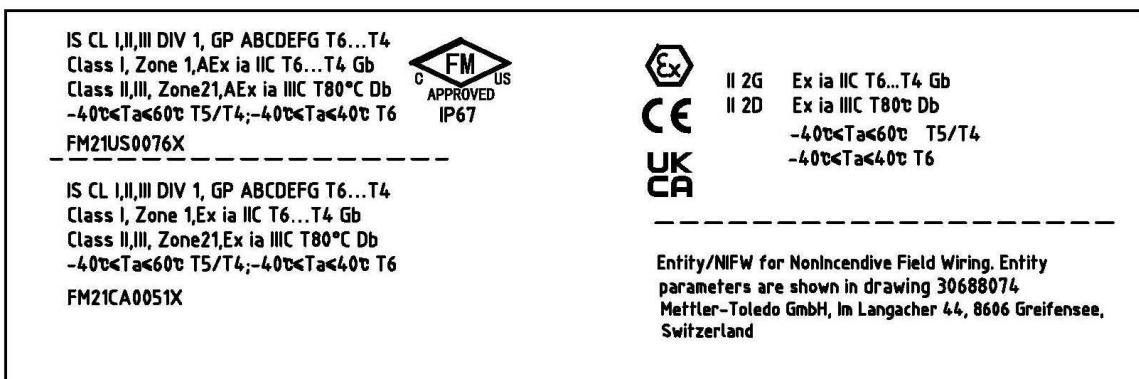

8.2 Kontrollritning

HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION		NON HAZARDOUS LOCATION			
PBA439 and PBA639 ENTITY PARAMETERS $Vi = 20V$	+SEN -SEN +SIGNAL -SIGNAL +EXCITATION -EXCITATION	FM APPROVED ASSOCIATED APPARATUS WITH ENTITY CONCEPT PARAMETERS $IsC \leq li$ $Po \leq Pi$ (Only for "S") $Ca \geq Ci + Cc$ (See Note 5) $La \geq Li + Lc$ (See Note 5)	Ex		
PI = see Table 1 (Only for "S") $Ci = 6nF$ (See Note 4) $Li = 30\mu H$ (See Note 4)		SCALE STRUCTURE TO BE CONNECTED TO SYSTEM SAFETY GROUND (See Note 2)			
HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION		SCALE STRUCTURE TO BE CONNECTED TO SYSTEM SAFETY GROUND (See Note 2)			
PBA439 and PBA639 ENTITY PARAMETERS $Vi = 20V$		FM APPROVED ASSOCIATED APPARATUS WITH ENTITY CONCEPT PARAMETERS $Voc \leq Vi$ $IsC \leq li$ $Po \leq Pi$ (Only for "S") $Ca \geq Ci + Cc$ (See Note 5) $La \geq Li + Lc$ (See Note 5)			
PI = see Table 1 (Only for "S") $Ci = 6nF$ (See Note 4) $Li = 30\mu H$ (See Note 4)		SCALE STRUCTURE TO BE CONNECTED TO SYSTEM SAFETY GROUND (See Note 2)			
NOTES: <ul style="list-style-type: none"> 1. This drawing applies to Scale platform PBA439/PBA639. 2. The resistance between all safety ground connections and the system grounding electrode must not exceed 1 ohm; 3. Installation shall be in accordance with ANSI/NFPA 70 articles 500-506, and ANSI/ISA-RP12.06.01 and CSA 22.1-06 4. Entity parameters Ci and Li include maximum PBA439 and PBA639 cable length of 30m; 5. Entity parameters Cc and Lc is the capacitance and inductance of cable connect between PBA436 and PBA639 and the associated apparatus 6. Manufacturer's control drawing of FM approved apparatus / associated apparatus must be followed. 7. The apparatus / associated apparatus shall be single entity-approved / certified with outputs that are approved / certified for parallel connection, the uses of multiple associated apparatus that are not approved / certified for use in combination with one another as a system are not permitted. 8. This drawing shall not be revised without prior approval from FM. 9. Installation of load cell needs to be done in such way that enclosure welded caps are physically obstructed from any possible impact. 					
METTLER TOLEDO <small>ON-23195 ChongZhou</small> <small>Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzmaßnahmen ISO 16016 beachten</small> <small>Description Control Drawing Ref. PBA439/PBA639</small> Control Drawing CFMUS PBA439/PBA639 <small>EPN No. 30688074</small> <small>External Design Rev. External Design Rev.</small> <small>Status Approved Mass: Unit:mm 1/1</small>					

8.3 Installationsritning

<p style="text-align: center;">Hazardous (Classified) Location</p> <p style="text-align: right;">Approval Mark THIS ITEM IS PART OF AGENCY APPROVED PRODUCT <input type="checkbox"/> Metrology <input type="checkbox"/> Safety <input checked="" type="checkbox"/> Ex DO NOT CHANGE DOCUMENT WITHOUT APPROPRIATE APPROVAL</p> <p>IP67 II 3G Ex ic IIC T6...T4 Gc -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T5/T4; -40°C ≤ Ta ≤ 40°C T6</p> <p>E II 3G Ex ec IIC T6 Gc -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T6 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc FM21UKEX0080X FM21ATEX0025X IECEEx FMG21.0003X</p> <p>E II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T5/T4; -40°C ≤ Ta ≤ 40°C T6</p> <p>C 0344 II 2D Ex ia IIIC T80°C Db FM21UKEX0079X FM21ATEX0003X IECEEx FMG21.0003X</p> <p>Unclassified Location</p> <p>NOTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> The resistance between all safety ground connections and the system grounding electrode must not exceed 1ohm. Installation shall be in accordance with relevant electrical installation standards (Being shown in Table 1) in hazardous areas(other than mines). Entity Parameters Ci And Li Include Maximum Load Cell Cable Length Of 30m Entity Parameters Cc and Lc is the capacitance and inductance of cable connect between load cell and the associated apparatus. In an explosive atmosphere caused by air/dust mixtures, the loose ends of the cable shall be connected outside the hazardous area or in a suitable enclosure with a degree of protection of at least IP6X in accordance with EN 60529. For the application of Ex ec, Ex tc: Urated=20V, Irated=50mA. Installation of load cell needs to be done in such way that enclosure welded caps are physically obstructed from any possible impact. Not following these instructions will jeopardize the explosion safety. For the application of Ex ec, The equipment shall only be used in an area of at least pollution degree 2, as defined in IEC 60664-1. <p>Table 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">EN60079-0: 2018</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-14: 2014</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-11: 2012</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-31: 2014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">EN61241-14: 2004</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-31: 2013</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-7: 2015</td> <td style="padding: 2px;">IEC60079-31: 2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-0-2017</td> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-11-2011</td> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-14-2013</td> <td style="padding: 2px;">IEC60079-7: 2015</td> </tr> </table> <p>Table 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Temperature class</th> <th style="width: 20%;">Pi</th> <th style="width: 20%;">li</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T4</td> <td>2.1W</td> <td>800mA</td> </tr> <tr> <td>T5</td> <td>1.2W</td> <td>600mA</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>0.6W</td> <td>600mA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland Mettler-Toledo Ltd. 64 Boston Rd, Leicester, LE4 1AW, United Kingdom</p> <p>Table 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">D</th> <th style="width: 50%;">update drawing status</th> <th style="width: 10%;">Wang jianwen</th> <th style="width: 10%;">Liu yuchun</th> <th style="width: 10%;">2021-7-26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>removed Ex nA of note6</td> <td>Wang jianwen</td> <td>Liu yuchun</td> <td>2021-1-15</td> </tr> <tr> <td>REV / CHG</td> <td>ZONE</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>BY APPVD</td> <td>AGENCY E.R. No. DATE</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">RECORD OF CHANGES</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">METTLER TOLEDO</td> <td>MTCZ CN-213022 ChangZhou</td> <td>Drawn Wang JW Change</td> <td>2020/05/11 Scale 1:1 Format mt_A4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten</td> <td>Note -</td> <td colspan="2">Replaces -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Description 防爆安装图 SLP84X</td> <td>ERP NO.</td> <td colspan="2">ERP Rev</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx 30555321</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td colspan="2">External Design No.: D000644580</td> <td>External Design Rev.: D</td> <td>Status: Approved</td> <td>Mass: Units: mm 1/1</td> </tr> </tbody> </table>	EN60079-0: 2018	EN60079-14: 2014	EN60079-11: 2012	EN60079-31: 2014	EN61241-14: 2004	EN60079-31: 2013	EN60079-7: 2015	IEC60079-31: 2013	IEC 60079-0-2017	IEC 60079-11-2011	IEC 60079-14-2013	IEC60079-7: 2015	Temperature class	Pi	li	T4	2.1W	800mA	T5	1.2W	600mA	T6	0.6W	600mA	D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-7-26	C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-1-15	REV / CHG	ZONE	DESCRIPTION	BY APPVD	AGENCY E.R. No. DATE	RECORD OF CHANGES					METTLER TOLEDO		MTCZ CN-213022 ChangZhou	Drawn Wang JW Change	2020/05/11 Scale 1:1 Format mt_A4	Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Note -	Replaces -		Description 防爆安装图 SLP84X		ERP NO.	ERP Rev		INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx 30555321			D		External Design No.: D000644580		External Design Rev.: D	Status: Approved	Mass: Units: mm 1/1
EN60079-0: 2018	EN60079-14: 2014	EN60079-11: 2012	EN60079-31: 2014																																																																		
EN61241-14: 2004	EN60079-31: 2013	EN60079-7: 2015	IEC60079-31: 2013																																																																		
IEC 60079-0-2017	IEC 60079-11-2011	IEC 60079-14-2013	IEC60079-7: 2015																																																																		
Temperature class	Pi	li																																																																			
T4	2.1W	800mA																																																																			
T5	1.2W	600mA																																																																			
T6	0.6W	600mA																																																																			
D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-7-26																																																																	
C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-1-15																																																																	
REV / CHG	ZONE	DESCRIPTION	BY APPVD	AGENCY E.R. No. DATE																																																																	
RECORD OF CHANGES																																																																					
METTLER TOLEDO		MTCZ CN-213022 ChangZhou	Drawn Wang JW Change	2020/05/11 Scale 1:1 Format mt_A4																																																																	
Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Note -	Replaces -																																																																		
Description 防爆安装图 SLP84X		ERP NO.	ERP Rev																																																																		
INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx 30555321			D																																																																		
External Design No.: D000644580		External Design Rev.: D	Status: Approved	Mass: Units: mm 1/1																																																																	

AutoCAD Mechanical Template V0.2

METTLER TOLEDO Service

Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne manual samt regelmæssig kalibrering og vedligeholdelse udført af vores uddannede servicemedarbejdere beskytter din investering og sikrer, at udstyret er pålideligt og nøjagtigt. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for en skræddersyet serviceaftale, der passer til dit behov og budget. Du kan finde yderligere oplysninger på www.mt.com/service.

Du kan sikre, at din investering udnyttes maksimalt, på flere vigtige måder:

- 1 **Registrer dit produkt:** Vi opfordrer dig til at registrere dit produkt på www.mt.com/productregistration så vi kan kontakte dig om forbedringer, opdateringer og vigtige oplysninger vedrørende dit produkt.
- 2 **Kontakt METTLER TOLEDO vedrørende service:** Værdien af en måling er proportional med dens nøjagtighed – en vægt, der er uden for specifikationerne, kan medføre forringet kvalitet, reduceret indtjening og øget ansvar. Rettidig service fra METTLER TOLEDO sikrer nøjagtighed og optimerer oppetiden og udstyrets levetid.
 - ➔ **Installation, konfiguration, integration og uddannelse:** Vores serviceteknikere er uddannet på fabrikken og er eksperter i vejecdystyr. Vi sikrer, at dit vejecdystyr er klar til produktion omkostningseffektivt og rettidigt, og at personalet er uddannet til at sikre succesfulde resultater.
 - ➔ **Dokumentation for indledende kalibrering:** Installationsmiljøet og kravene til anvendelsesområdet er unikke for hver enkelt industrivægt, så ydeevnen skal testes og certificeres. Vores kalibreringssydelser og certifikater dokumenterer nøjagtighed med det formål at sikre produktionskvalitet og leverere et kvalitetssystem med dokumenteret ydeevne.
 - ➔ **Periodisk kalibreringsvedligeholdelse:** En serviceaftale om kalibrering sikrer, at du altid kan have tillid til din vejeproses, og at du har dokumentation for overholdelse af kravene. Vi tilbyder mange forskellige typer af serviceordninger, der er tilrettelagt, så de opfylder dine behov og tager højde for dit budget.

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsanvisninger	3
1.1	Tilsigtet brug	3
1.2	Forkert brug.....	3
1.3	Sikkerhedsforanstaltninger	3
1.4	Særlige betingelser for brug.....	3
2	Introduktion	4
2.1	Sortiment	4
2.2	Om denne brugervejledning	4
2.3	Yderligere dokumenter	4
3	Installation og betjening	5
3.1	Kontrol af placering.....	5
3.2	Tilslutning af vejeplatformen til vejeterminalen	5
3.3	Nivellering.....	6
3.4	Ækvipotentiel tilslutning	6
3.5	Kontrol af vejeplatformene.....	6
3.6	Betjening af vejeplatformen	7
3.7	Installation, konfiguration, service og reparation	7
4	Vedligeholdelse	8
4.1	Bemærkninger vedrørende rengøring.....	8
4.2	Efterbehandling.....	8
4.3	Bortskaffelse	8
5	Reparation	9
6	Tekniske data og driftsgrænser	10
6.1	Maksimalt verifikationsvægtinterval.....	10
6.2	Tilladt totalvægt	10
6.3	Tekniske data for vejecellen.....	11
6.3.1	Ex-godkendelse	11
6.3.2	Vejecellen opfylder følgende standarder	11
6.4	Mål	13
6.5	Information om kapacitetsforbelastning	14
6.5.1	Forbelastningstabell i kilo	15
6.5.2	Forbelastningstabell i pound	16
6.6	Tilbehør	17
7	Monteringsmuligheder	19
8	Bilag	20
8.1	Typeskilt	20
8.2	Kontroltegning	21
8.3	Installationstegning	22

1 Sikkerhedsanvisninger

1.1 Tilsigtet brug

Vejeplatforme PBA439(x/xx) er en del af et modulopbygget vejesystem, der består af en METTLER TOLEDO-vejeterminal som indikator og mindst én vejeplatform.

- Brug kun vejeplatformen til vejning i overensstemmelse med denne vejledning.
- Vejeplatformen er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Kun vejeplatformen PBA439x/xx er velegnet til brug i farlige miljøer som angivet nedenfor.
- Enhver anden brug betragtes som utilsigtet.

Lovreguleret måling

- Brug kun godkendte vejeplatforme til lovreguleret måling.
- Ved brug til lovreguleret måling er driftsselskabet ansvarligt for at overholde alle nationale krav til vejning og måling.
- Kontakt METTLER TOLEDOs serviceorganisation i tilfælde af spørgsmål vedrørende brug i lovlige handelsapplikationer.

1.2 Forkert brug

- Brug ikke vejeterminalen til andet end vejning.
- Vejeplatformen må ikke anvendes i andre miljøer end dem, der er angivet i --- MISSING LINK ---.
- Undlad at foretage ændringer på vejeplatformen.
- Brug ikke vejeterminalen uden for de grænser, der er angivet i de tekniske specifikationer.
- Brug ikke vejeplatformen til opbevaring af varer.
- Undgå, at der falder varer ned på vejeplatformen.

1.3 Sikkerhedsforanstaltninger

- Vejeplatformen skal installeres og vedligeholdes af teknikere, der er uddannet og godkendt af METTLER TOLEDO.
- Vær forsiktig ved transport og løft af tunge enheder.
- Vejeplatformen skal altid kobles fra strømkilden, før installation, service, rengøring eller vedligeholdelse foretages.
- Tilslutningskablet kan muligvis ikke kobles fra vejeterminalen, mens strømmen er tilsluttet.
- Kontrollér, at vejeplatformen har rumtemperatur, før strømforsyningen tilsluttes.
- De eksplosionsbeskyttede vejeplatforme PBA439x/xx er godkendt til brug i følgende farlige områder:
 - ATEX/IECEx-kategori 2, -kategori 3, gas/støv (zone 1/21, zone 2/22)
 - cFMus, klasse I,II,III, Div. 1, Div. 2
- Der er øget risiko for skade på personer og ejendom, når vejeplatformene bruges i farlige områder! Der skal udvises særlig stor forsigtighed under arbejde i sådanne områder.
- Til vejeplatformen PBA439x/xx skal der altid anvendes kabelforskruninger, som er velegnede og godkendt til farlige områder, når vejecellens kabel føres ind i vejeterminalen.
- Eksplorationsbeskyttede vejeplatforme må kun bruges i farlige områder sammen med vejeterminaler med de relevante godkendelser og grænsefladespecifikationer.

1.4 Særlige betingelser for brug

- I en eksplorativ atmosfære, der skyldes luft-/støvfugt, skal de løse ender af kablet tilsluttes uden for det farlige område eller i et passende kabinet med en kapslingsklasse på mindst IP6X i henhold til IEC/EN 60529.

2 Introduktion

2.1 Sortiment

Denne brugervejledning fokuserer på produktserien PBA439(x/xx).

Serien PBA439(x/xx) indeholder forskellige vejepalmerne, så du kan let finde en, der passer til dit behov. De kan godkendes og fås i forskellige størrelser og kapaciteter

Type	Vejepladens materiale	Vægtrammens materiale	Vejecellens opbygning	Miljøets IP-kasse	Faregodkendelse
PBA439	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål, hermetisk forseglet	Tørt, vådt, IP68/IP69K	-
PBA439x	AISI304	AISI304			Zone 1/21, Div 1
PBA439xx					Zone 2/22, Div 2

2.2 Om denne brugervejledning



Denne brugervejledning indeholder alle oplysninger til operatøren af produktet.

- Læs brugervejledningen omhyggeligt før brug.
- Gem brugervejledningen, så du har den til fremtidig reference.
- Giv brugervejledningen videre til en eventuel fremtidig ejer eller bruger af produktet.

2.3 Yderligere dokumenter

Ud over brugervejledningen kan du også downloade følgende dokumenter fra www.mt.com:

- Brochure
- Installationsoplysninger (til uddannet personale, der er under driftsselskabets kontrol)
- Typegodkendelsesdokumenter

Download af certifikat


US-, Canada-, ATEX-, UKEX- og IECEx-certifikater kan downloades fra <https://www.mt.com/us/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

3 Installation og betjening

3.1 Kontrol af placering

Den korrekte placering er afgørende for vejeresultaternes nøjagtighed.

- Sørg for, at vejeplatformens placering er stabil, uden vibrationer og vandret.
- Underlaget skal kunne bære vejeplatformen på støttepunkterne, når den er under maksimal belastning.
- Sørg for, at følgende omgivende forhold er til stede:
 - Intet direkte sollys
 - Ingen kraftig træk eller kraftige vibrationer
 - Ingen store temperaturudsving
 - Temperaturområde -10 °C til +40 °C / 14 °F til 104 °F

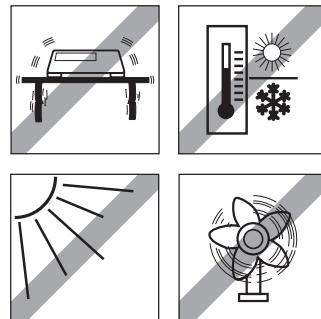

3.2 Tilslutning af vejeplatformen til vejeterminalen

Vejeplatformene PBA439(x/xx) er designet til brug med analoge METTLER TOLEDO vejeterminaler.

- Før vejeplatformens kabel gennem kabelforskrungen og ind i vejeterminalen.
- Tilslut vejeplatformens kabel til klemmerækken på vejeterminalen som vist i tabellen nedenfor.

Signal	Lederfarve	Stik
SIG+	Hvid	CELLER MED 6 LEDERE VEJECELLE ELLER SAMLEBOKS
SIG-	Rød	
EXC+	Grøn	
EXC-	Sort	
SEN+	Gul	
SEN-	Blå	



ADVARSEL

Kabelskærmningen skal jordforbindes.

Sikkerhedsforanstaltninger for tilslutninger


- Ved tilslutning af vejeplatformen i et farligt område skal kravene fra kontroltegningen vedlagt som [Bilag ▶ side 20] overholdes nøje.
- Kontrollér de særlige betingelser for sikker brug på tegningerne og certifikaterne i [Bilag ▶ side 20].
- Kabelskærmningen er forbundet med vejecellens fjederelement (vejecellens korpus). Vær opmærksom på, at vejecellen og klemmen (eller samleboksen) forbides korrekt afhængigt af installationsforholdene.
- Modstanden mellem alle sikkerhedsjordforbindelser og systemets jordingselektrode må ikke overstige 1 ohm.
- Installationen skal udføres i overensstemmelse med gældende standarder for elektrisk installation.
- Hvis disse instruktioner ikke følges, bringes ekspllosionssikkerheden i fare.

3.3 Nivellering

For at vejeplatformene skal kunne levere et præcist vandret vejeresultat, skal de være nivelleret nøjagtigt. Vejeplatformen skal nivelleres under den første installation og hver gang, den flyttes.

- 1 Drej på vejeplatformens justerbare fødder, indtil luftboblen i vaterpasset befinner sig i den inderste cirkel.
- 2 Spænd låsemøtrikkerne på de justerbare fødder.

☞ Scan QR-koden for at se videoen

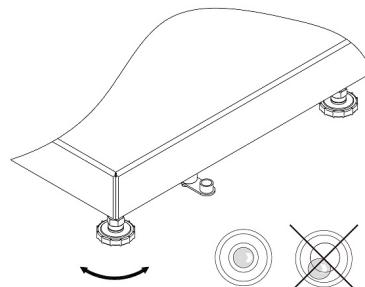


3.4 Ækvipotentiel tilslutning

Den økvipotentielle tilslutning for vejeplatformene PBA439x/xx er monteret fra fabrikken. Kablerne skal monteres hos kunden af en autoriseret elektriker. METTLER TOLEDO service har udelukkende en tilsynsførende og rådgivende funktion i denne forbindelse. Forbind den økvipotentiel tilslutning (PA) på alle enheder (vejeplatform og vejeterminal) i henhold til de regler og standarder, der er gældende i det pågældende land. Kontroller desuden, at alle enheders kabинetter kobles til det samme potentiale via PA-terminalen.

Bemærk

Udstyret er beskyttet mod elektrisk stød iht. IEC60950, klasse II.

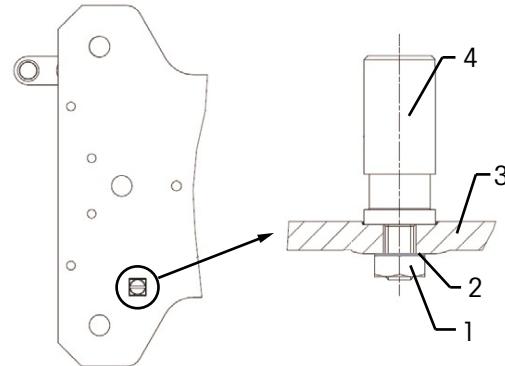

1 - Sekskantlåsemøtrik, M4 KEPS

2 - Skive

3 - Bundramme


4 - Ækvipotentiel tilslutningsklemme, tilspændingsmoment 3,5 Nm

Ordrenummer for økvipotentiel tilslutningssæt 72237321

3.5 Kontrol af vejeplatformene

Funktionskontrol

- 1 Sørg for, at vejeplatformen er tilsluttet til en vejeterminal, og at vejeterminalen er tændt.
- 2 Sørg for, at vejeplatformen er uden vægt, og at displayet på vejeterminalen viser 0.
- 3 Fyld vægt på vejeplatformen. Vejeterminalen skal vise en værdi forskellig fra 0.
- 4 Fjern vægten fra vejeplatformen. Vejeterminalen skal returnere til 0.

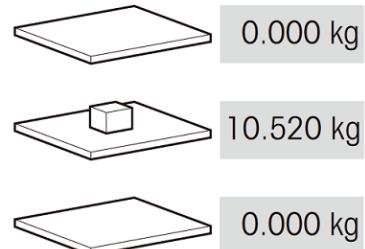


Verifikationstest

Oplysninger om verifikationstest findes i brugervejledningen til den tilsluttede vejeterminal. Hvis verifikationsseget er brudt, er verifikationen ikke længere gyldig.


3.6 Betjening af vejepalatromen

For at opnå de bedst mulige vejeresultater skal følgende regler overholdes:


- Sørg for, at belastningspladen er korrekt på plads.

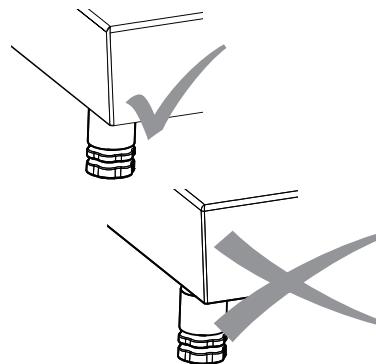


- For at opnå de bedst mulige vejeresultater skal det emne, der skal vejes, altid placeres det samme sted på vejepalatromen.

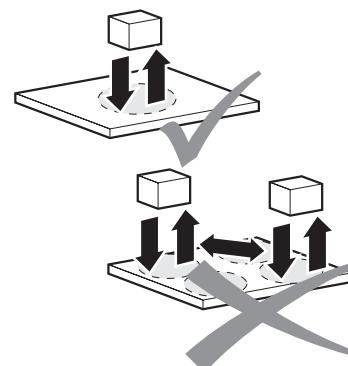

- Undgå processer, der har en slibende effekt eller medfører slitage.

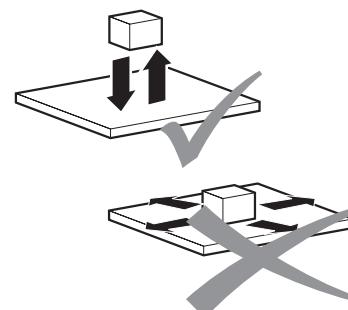

- Undgå faldende belastninger, stød og sideværts påvirkninger.



3.7 Installation, konfiguration, service og reparation

Ring til METTLER TOLEDO service angående installation, konfiguration, service og reparation af vejepalatromene.

4 Vedligeholdelse

4.1 Bemærkninger vedrørende rengøring


Bemærk

Forkert brug af rengøringsmidler kan beskadige vejeplatformen.

- Brug kun desinficerende midler og rengøringsmidler i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Brug ikke meget syreholdige, basiske eller klorholdige rengøringsmidler. Undgå midler med høj eller lav pH-værdi, da disse skaber øget risiko for korrosion.
- Vær særlig omhyggelig ved rengøring af vejecellen.


Rengøring

- Fjern regelmæssigt snavs og aflejringer på ydersiden og indersiden af vejeplatformen.
→ Fremgangsmåden afhænger både af overfladetypen og af de miljømæssige forhold på installationsstedet.



Rengøring i et vådt miljø (modeller i rustfrit stål)

- Rengør med vandstråle op til 80 °C / 176 °F og maks. 80 bar, minimumafstand 40 cm / 16".
- Brug rengøringsmidler til husholdningsbrug.




Rengøring i et korrosionsfremmende miljø (modeller i rustfrit stål)

- Rengør med vandstråle.
Indvendig rengøring, vejecelle, vejelade åbnet: op til 60 °C / 140 °F og maks. 2 bar, minimumafstand 40 cm / 16".
Udvendig rengøring, vejecelle lukket: op til 80 °C / 176 °F og maks. 80 bar, minimumafstand 40 cm / 16".
- Fjern regelmæssigt korrosionsfremmende stoffer.
- Brug kun desinficerende midler og rengøringsmidler i overensstemmelse med producentens specifikationer og anvisninger.

4.2 Efterbehandling

For at beskytte vægten skal følgende efterbehandling udføres:



- Skyl vægten med rent vand, og fjern rengøringsmidlet helt.
- Tør vægten af med en fnugfri klud.
- Behandl vægte af rustfrit stål indvendigt og udvendigt med olie, der er egnet til fødevarer.

4.3 Bortskaffelse

I overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må denne enhed ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Dette gælder også for lande uden for EU, i henhold til deres specifikke krav.



Bortskaf venligst dette produkt i overensstemmelse med de lokale love og regler og på det indsamlingssted, der er beregnet til elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte de ansvarlige myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt enheden. Hvis enheden overdrages til andre, skal der også relateres til indholdet i denne bestemmelse.

5 Reparation

Udstyret er certificeret til brug i farlige områder, derfor er det ikke tilladt at foretage ændringer. Reparationer må kun udføres af personale, som er uddannet specifikt til reparation af dette udstyr.

6 Tekniske data og driftsgrænser

6.1 Maksimalt verifikationsvægtinterval


Maks. verifikationsvægtinterval [e] / OIML	Kapacitet							
	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
1 x 3000e Max / e [kg]	3 / 0.001	6 / 0.002	15 / 0.005	30 / 0.01	60 / 0.02	150 / 0.05	300 / 0.1	600 / 0.2

Maks. verifikationsvægtinterval [d] / NTEP	Kapacitet							
	-	10 lb	25 lb	50 lb	100 lb	250 lb	500 lb	1000 lb
1 x 5000d Max / d [lb]	-	10 / 0.002	25 / 0.005	50 / 0.01	100 / 0.02	250 / 0.05	500 / 0.1	1000 / 0.2

6.2 Tilladt totalvægt

Alle vejeplatforme er udstyret med overbelastningsbeskyttelse. Det robuste vægtdesign betyder, at platformens mærkekapacitet af og til kan overskrides, uden at der sker skader på enheden. Den maksimale sikre statiske belastning må aldrig overskrides.

- Følgende driftsgrænser skal overholdes.



Model	A - Centreret belastning	B - Belastning i en af siderne	C - Belastning i et af hjørnerne
PBA439(x/xx)-QA	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-A	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-QB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-BB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-B	200 kg / 400 lb	140 kg / 280 lb	75 kg / 150 lb
PBA439(x/xx)-BC	400 kg / 800 lb	300 kg / 600 lb	150 kg / 300 lb
PBA439(x/xx)-CC	700 kg / 1400 lb	400 kg / 800 lb	200 kg / 400 lb



ADVARSEL

Undgå belastning som følge af tab af enheden, stødbelastning samt slag fra siden.

6.3 Tekniske data for vejecellen

Mærkeeffekt	mV/V	$1,8 \pm 0,2$
Indgangsresistans	Ω	384 ± 15
Udgangsresistans	Ω	350 ± 4
Anbefalet spænding	V (DC / AC)	5 - 15
Maks. magnetiseringsspænding	V (DC / AC)	20
Kabelkappe	-	PVC
IP-klasse	-	IP68/IP69K

6.3.1 Ex-godkendelse

Dette afsnit omhandler udelukkende produktets Ex-relevante egenskaber.

Vejecellen SLP84x(x=6,7,8) har:

ATEX-certifikat	FM21ATEX0003X, FM21ATEX0025X
UK-certifikat	FM21UKEX0079X, FM21UKEX0080X
IECEx-certifikat	IECEx FMG21.0003X
US-certifikat	FM21US0005X
Canadisk certifikat	FM21CA0002X

Ovennævnte certifikater og de tilhørende installationstegninger fremgår af [Bilag ▶ side 20].

6.3.2 Vejecellen opfylder følgende standarder

US-standarder

Titel	Nummer	Udstedelsesdato
Elektrisk udstyr til brug i farlige (klassificerede) områder – Generelle krav	FM-klasse 3600	2018
Egensikkert udstyr og tilhørende udstyr til brug i klasse I, II og III, Division 1, farlige (klassificerede) områder	FM-klasse 3610	2021
Ikke-antændelsesfarligt elektrisk udstyr til brug i farlige (klassificerede) områder defineret som klasse I og II, division 2 og klasse III, division 1 og 2	FM-klasse 3611	2021
Elektrisk udstyr til måling, betjening og laboratoriebrug	FM-klasse 3810	2021
Eksplasive atmosfærer - del 0: Udstyr - Generelle krav	ANSI/UL 60079-0	2019
Eksplasive atmosfærer - del 11: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "I"	ANSI/ISA 60079-11	2014
Ikke-antændelsesfarligt elektrisk udstyr til brug i farlige (klassificerede) områder defineret som klasse I og II, division 2 og klasse III, division 1 og 2	ANSI/UL 121201	2017
Sikkerhedskrav for elektrisk udstyr til måling, betjening og laboratoriebrug – del 1: Generelle krav	ANSI/UL 61010-1	2012
Kapslingsklasse ved hjælp af kabinet (IP-kode)	ANSI/IEC 60529	2020

Canadiske standarder

Titel	Nummer	Udstedelsesdato
Ikke-antændelsesfarligt elektrisk udstyr til brug i farlige områder defineret som klasse I, division 2	CSA C22.2 nr. 213	2017
Eksplasive atmosfærer - del 0: Udstyr - Generelle krav	CAN/CSA-C22.2 nr. 60079-0	2019
Eksplasive atmosfærer - del 11: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "I"	CAN/CSA-C22.2 nr. 60079-11	2014

Titel	Nummer	Udstedelses-dato
Eksplosive atmosfærer - del 7: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "e"	CAN/CSA-C22.2 nr. 60079-7	2018
Eksplosive atmosfærer - del 31: Udstyrsbeskyttelse mod støvantændelse ved hjælp af kabinet "t"	CAN/CSA-C22.2 nr. 60079-31	2015
Sikkerhedskrav for elektrisk udstyr til måling, betjening og laboratoriebrug – del 1: Generelle krav	CSA C22.2 nr. 61010-1	2012
Kapslingsklasse ved hjælp af kabinet (IP-kode)	CSA C22.2 nr. 60529	2016

IECEx-standarder

Titel	Nummer	Udstedelses-dato
Eksplosive atmosfærer - del 0: Udstyr - Generelle krav	IEC 60079-0	2017
Eksplosive atmosfærer - del 11: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "i"	IEC 60079-11	2011
Eksplosive atmosfærer - del 7: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "e"	IEC 60079-7	2017
Eksplosive atmosfærer - del 31: Udstyrsbeskyttelse mod støvantændelse ved hjælp af kabinet "t"	IEC 60079-31	2013
Kapslingsklasse ved hjælp af kabinet (IP-kode)	IEC 60529	2013


ATEX-standarder

Titel	Nummer	Udstedelses-dato
Eksplosive atmosfærer - del 0: Udstyr - Generelle krav	EN IEC 60079-0	2018
Eksplosive atmosfærer - del 11: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "i"	EN 60079-11	2012
Eksplosive atmosfærer - del 7: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Eksplosive atmosfærer - del 31: Udstyrsbeskyttelse mod støvantændelse ved hjælp af kabinet "t"	EN 60079-31	2014
Kapslingsklasse ved hjælp af kabinet (IP-kode)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

UKEX-standarder

Titel	Nummer	Udstedelses-dato
Eksplosive atmosfærer - del 0: Udstyr - Generelle krav	EN IEC 60079-0	2018
Eksplosive atmosfærer - del 11: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "i"	EN 60079-11	2012
Eksplosive atmosfærer - del 7: Udstyrsbeskyttelse via egensikkerhed "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Eksplosive atmosfærer - del 31: Udstyrsbeskyttelse mod støvantændelse ved hjælp af kabinet "t"	EN 60079-31	2014
Kapslingsklasse ved hjælp af kabinet (IP-kode)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

6.4 Mål

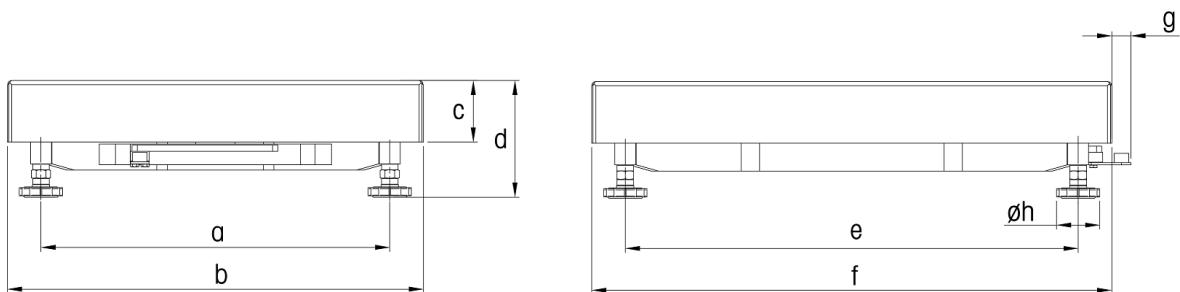


Mål		a	b	c	d *	e	f	g	h
PBA439(x/xx)-QA	mm	163	228	56	85,6	163	228	21	42
	inch	6,42	8,98	2,20	3,37	6,42	8,98	0,83	1,65
PBA439(x/xx)-A	mm	175	240	56	85,6	235	300	21	42
	inch	6,89	9,45	2,20	3,37	9,25	11,81	0,83	1,65
PBA439(x/xx)-QB	mm	240	305	57	96,6	253	305	18	42
	inch	9,45	12,01	2,24	3,8	9,96	12,01	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-BB	mm	235	300	57	96,6	335	400	18	42
	inch	9,25	11,81	2,24	3,8	13,19	15,75	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-B	mm	335	400	59	100,1	435	500	18	42
	inch	13,19	15,75	2,32	3,94	17,13	19,69	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-BC	mm	437	500	73	106,8	584	650	17	42
	inch	17,20	19,69	2,87	4,2	22,99	25,59	0,67	1,65
PBA439(x/xx)-CC	mm	503	600	85	128,3	724	800	18	42
	inch	19,80	23,62	3,35	5,05	28,5	31,50	0,71	1,65

* : 1) d= min. platformshøjde. Med de justerbare fødder kan platformshøjden øges med maks. 10 mm / 0,39".

2) Ved brug af hygiejnescætten (ekstratilbehør) øges platformens højde (d) med 12 mm / 0,47".

6.5 Information om kapacitetsforbelastning

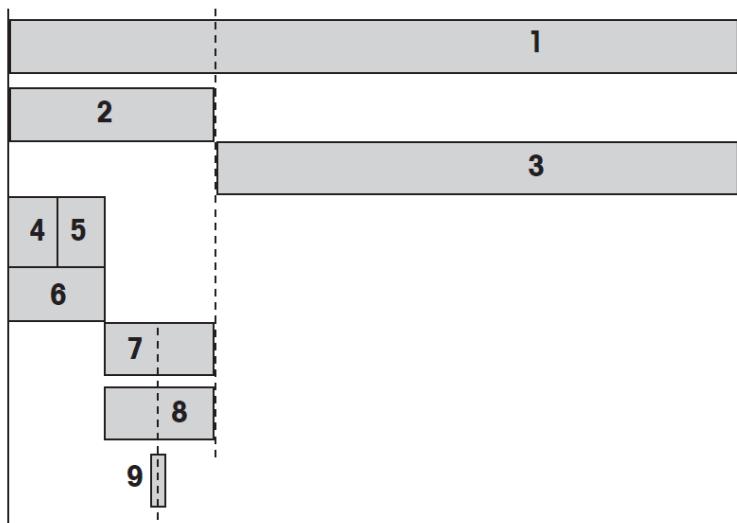

1	Maks. belastningområde for vejecellen (E_{max})
2	Maks. forbelastning = Maks. belastningsområde 1 – Maks. belastning 3
3	Maks. belastning = Maks. belastningsområde 1 – Maks. forbelastning 2
4	Forbelastning, øverste område
5	Forbelastning, vejeplade
6	Forbelastning fra fabrikken = Forbelastning, øverste område 4 + Forbelastning, vejeplade 5
7	Mekanisk forbelastningsreserve = Maks. forbelastning 2 – Forbelastning fra fabrikken 6
8	Nulstillingsintervallet (tænding) kan indstilles. Nulstillingsintervallet skal ligge inden for den maksimale forbelastning. Nulstillingsintervallet må udgøre maks. 18 % af den maksimale belastning.
9	Nulstillingsintervallet $\pm 2\%$ af den maksimale belastning

6.5.1 Forbelastningstabell i kilo

Type	Mål [mm]	Maks. belastning (3)	Forbelastning, øverste område (4)	Forbelastning, vejeplade (5)	Forbelastning fra fabrikken (6)	Mek. Forbelastningsreserve (7)	Nulstilningsinterval (8)	Maks. belastningsinterval (1)
PBA439(x/xx)-QA3	228x228	3	1,04	0,95	1,99	6,01	0,54	11
PBA439(x/xx)-QA6	228x228	6	1,04	0,95	1,99	3,01	1,08	11
PBA439(x/xx)-A3	240x300	3	1,49	1,23	2,72	5,28	0,54	11
PBA439(x/xx)-A6	240x300	6	1,49	1,23	2,72	2,28	1,08	11
PBA439(x/xx)-A15	240x300	15	1,49	1,23	2,72	4,28	2,70	22
PBA439(x/xx)-QB15	305x305	15	1,70	1,51	3,21	3,79	2,70	22
PBA439(x/xx)-QB30	305x305	30	1,70	1,51	3,21	16,79	5,40	50
PBA439(x/xx)-QB60	305x305	60	1,70	1,51	3,21	36,79	10,80	100
PBA439(x/xx)-BB30	300x400	30	2,08	1,86	3,94	16,06	5,40	50
PBA439(x/xx)-BB60	300x400	60	2,08	1,86	3,94	36,06	10,80	100
PBA439(x/xx)-B30	400x500	30	3,45	2,85	6,30	13,70	5,40	50
PBA439(x/xx)-B60	400x500	60	3,45	2,85	6,30	33,70	10,80	100
PBA439(x/xx)-B150	400x500	150	3,45	2,85	6,30	43,70	27,00	200
PBA439(x/xx)-BC60	500x650	60	7,00	5,80	12,80	27,20	10,80	100
PBA439(x/xx)-BC150	500x650	150	7,00	58,00	65,00	35,00	27,00	250
PBA439(x/xx)-BC300	500x650	300	7,00	5,80	12,80	187,20	54,00	500
PBA439(x/xx)-CC60	600x800	60	9,36	11,00	20,36	19,64	10,80	100
PBA439(x/xx)-CC150	600x800	150	9,36	11,00	20,36	79,64	27,00	250
PBA439(x/xx)-CC300	600x800	300	9,36	11,00	20,36	179,64	54,00	500
PBA439(x/xx)-CC600	600x800	600	11,50	14,10	25,60	124,40	108,00	750

6.5.2 Forbelastningstabell i pound

Type	Mål [inch]	Maks. belastning (3)	Forbelastning, øverste område (4)	Forbelastning, vejeplade (5)	Forbelastning fra fabrikken (6)	Mek. Forbelastningsreserve (7)	Nulstillingsinterval (8)	Maks. belastningsinterval (1)
PBA439(x/xx)-QA6	9x9	10	2,29	2,09	4,39	9,86	1,8	24
PBA439(x/xx)-A6	9,5x11,8	10	3,28	2,71	6,00	8,25	1,8	24
PBA439(x/xx)-A15	9,5x11,8	25	3,28	2,71	6,00	17,51	4,5	49
PBA439(x/xx)-QB15	12x12	25	3,75	3,33	7,08	16,42	4,5	49
PBA439(x/xx)-QB30	12x12	50	3,75	3,33	7,08	53,15	9,0	110
PBA439(x/xx)-QB60	12x12	100	3,75	3,33	7,08	113,39	18,0	220
PBA439(x/xx)-BB30	11,8x15,7	50	4,59	4,10	8,69	51,54	9,0	110
PBA439(x/xx)-BB60	11,8x15,7	100	4,59	4,10	8,69	111,78	18,0	220
PBA439(x/xx)-B30	15,7x19,7	50	7,61	6,28	13,89	46,34	9,0	110
PBA439(x/xx)-B60	15,7x19,7	100	7,61	6,28	13,89	106,57	18,0	220
PBA439(x/xx)-B150	15,7x19,7	250	7,61	6,28	13,89	177,04	45,0	441
PBA439(x/xx)-BC60	19,7x25,6	100	15,43	12,79	28,22	92,24	18,0	220
PBA439(x/xx)-BC150	19,7x25,6	250	15,43	127,87	143,30	157,86	45,0	551
PBA439(x/xx)-BC300	19,7x25,6	500	15,43	12,79	28,22	574,09	90,0	1102
PBA439(x/xx)-CC60	23,6x29,5	100	20,64	24,25	44,89	75,58	18,0	220
PBA439(x/xx)-CC150	23,6x29,5	250	20,64	24,25	44,89	256,27	45,0	551
PBA439(x/xx)-CC300	23,6x29,5	500	20,64	24,25	44,89	557,43	90,0	1102
PBA439(x/xx)-CC600	23,6x29,5	1000	25,35	31,09	56,44	597,03	180,0	1653

6.6 Tilbehør

Stander

Varenummer	Betegnelse	Beskrivelse
72229393	Stander åben 120 mm / 4,7"	Passer til alle platformsstørrelser
72198702	Stander åben 330 mm / 13"	Passer til alle platformsstørrelser
72198703	Stander åben 660 mm / 26"	Passer til alle platformsstørrelser
72198704	Stander åben 900 mm / 35,4"	Passer til alle platformsstørrelser større end A-størrelse

Vogn i rustfrit stål

Varenummer	Betegnelse	Beskrivelse
72225939	Vogn BC i rustfrit stål	Passer til platforme i BC-størrelse
72225940	Vogn CC i rustfrit stål	Passer til platforme i CC-størrelse

Rulleskinne

Varenummer	Betegnelse	Beskrivelse
30253326	Rulleskinne 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rustfrit stål	Passer til platforme i B-størrelse. Ruller til platformens korte side
30253328	Rulleskinne 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rustfrit stål	Passer til platforme i BC-størrelse. Ruller til platformens korte side
30253330	Rulleskinne 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rustfrit stål	Passer til platforme i CC-størrelse. Ruller til platformens korte side
30253327	Rulleskinne 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rustfrit stål	Passer til platforme i B-størrelse. Ruller til platformens lange side
30253329	Rulleskinne 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rustfrit stål	Passer til platforme i BC-størrelse. Ruller til platformens lange side
30253331	Rulleskinne 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rustfrit stål	Passer til platforme i CC-størrelse. Ruller til platformens lange side
30640393	Rulleskinne 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rustfrit stål	Passer til farligt område
30640394	Rulleskinne 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rustfrit stål	Passer til farligt område
30640395	Rulleskinne 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rustfrit stål	Passer til farligt område

Frontmonteringsbeslag

Varenummer	Betegnelse	Beskrivelse
22021062	Frontmonteringsbeslag	Passer til ICS4_9 frontmontering

Tallerken i rustfrit stål


Varenummer	Betegnelse	Beskrivelse
30676769	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål 240 × 300mm / 9,5" × 11,8"	Passer til platforme i A-størrelse
30676770	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål 300 × 400 mm / 11,8" × 15,7"	Passer til platforme i BB-størrelse
30676771	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7"	Passer til platforme i B-størrelse
30676772	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål 228 × 228 mm / 9" × 9"	Passer til platforme i QA-størrelse
30676773	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål 305 × 305 mm / 12" × 12"	Passer til platforme i QB-størrelse
30676774	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6"	Passer til platforme i BC-størrelse

Varenummer	Betegnelse	Beskrivelse
30676775	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål, tykkelse 2,0 m, 600 x 800 mm / 23,6" x 31,5"	Passer til platforme i CC-størrelse
30676776	Tallerken i AISI 316 rustfrit stål, tykkelse 2,5 mm, 600 x 800 mm / 23,6" x 31,5"	Passer til platforme i CC-størrelse

7 Monteringsmuligheder



PBA439(x/xx) understøtter montering på stabil enhed. Hvis det bliver nødvendigt at bore på vejeplatformen, skal nedenstående boremønstre følges.

BEMÆRK: De mørke områder er de steder, hvor det er tilladt at bore på vejeplatformen.

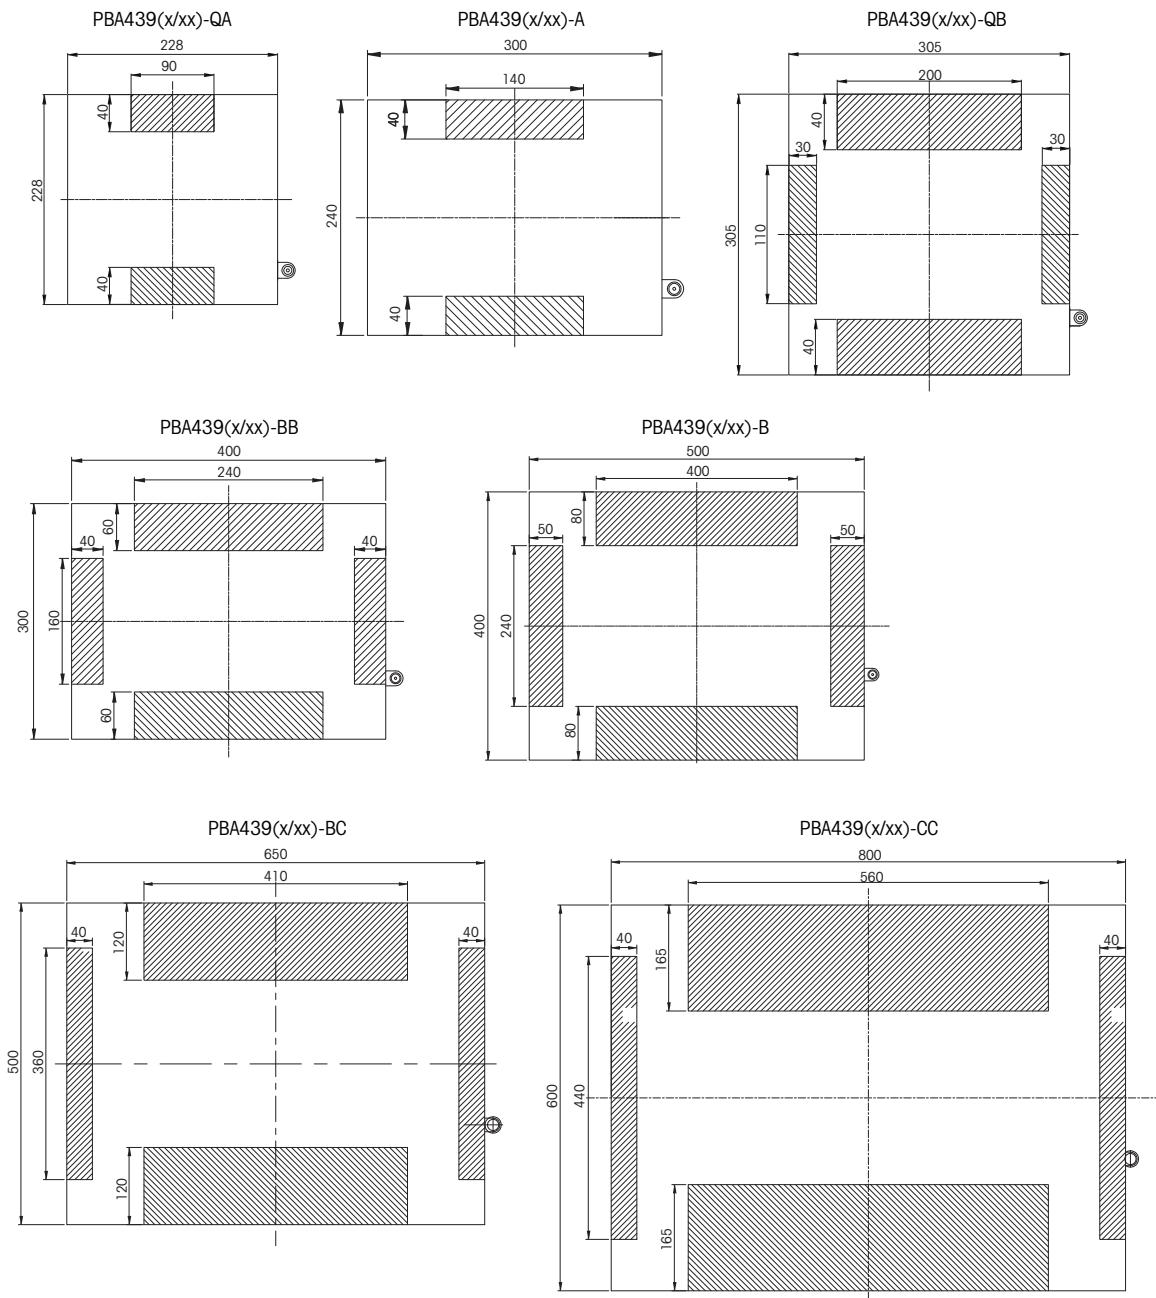


8 Bilag

8.1 Typeskilt

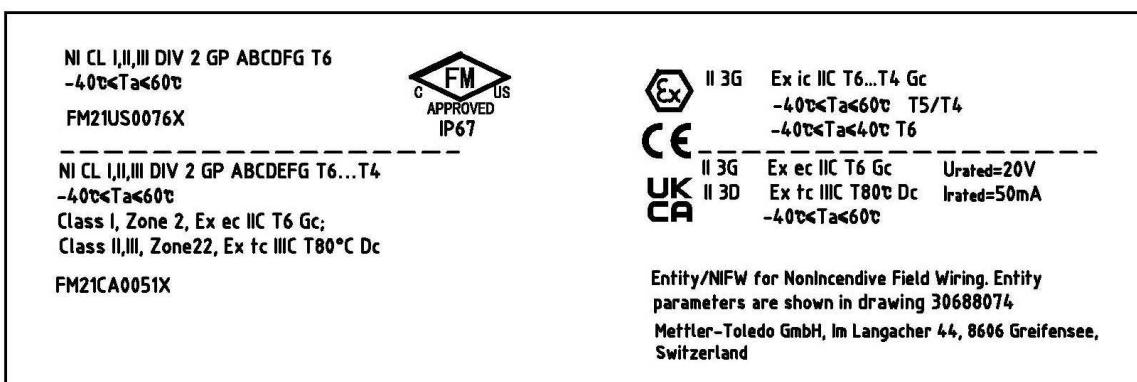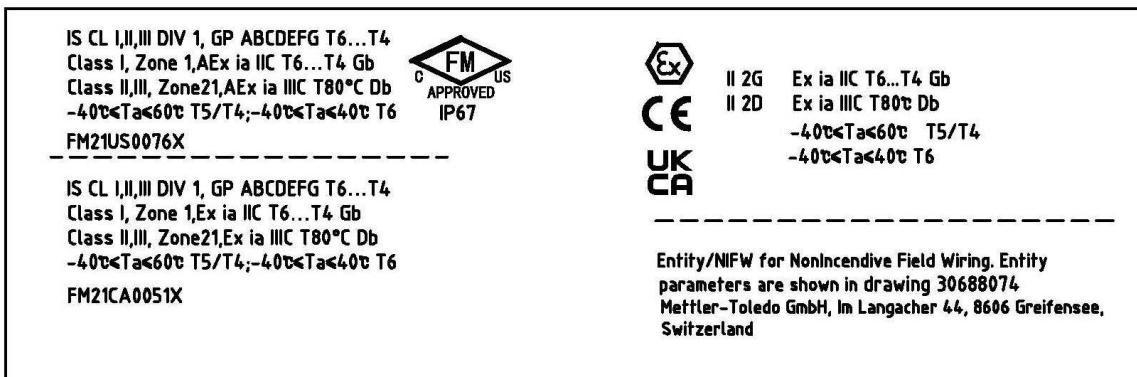

8.2 Kontroltegning

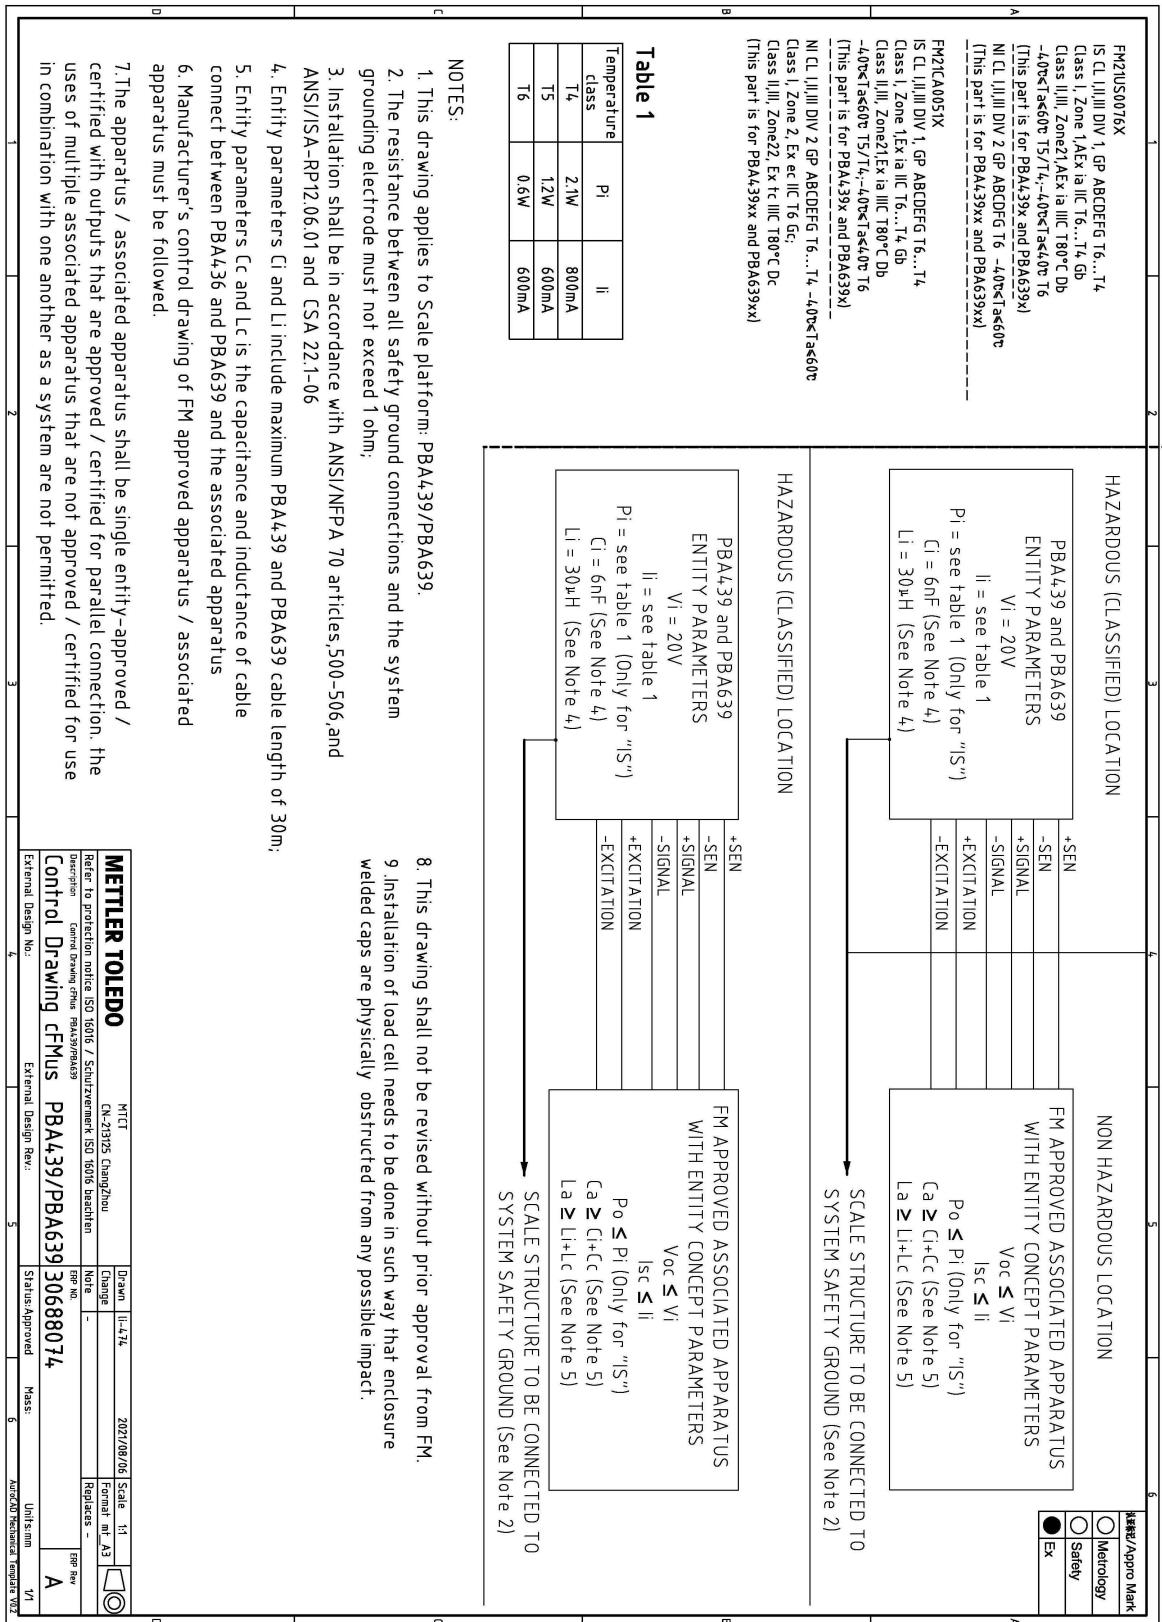

8.3 Installationstegning

<p style="text-align: center;">Hazardous (Classified) Location</p> <p style="text-align: right;">Approval Mark THIS ITEM IS PART OF AGENCY APPROVED PRODUCT <input type="checkbox"/> Metrology <input type="checkbox"/> Safety <input checked="" type="checkbox"/> Ex DO NOT CHANGE DOCUMENT WITHOUT APPROPRIATE APPROVAL</p> <p>IP67 II 3G Ex ic IIC T6...T4 Gc -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T5/T4; -40°C ≤ Ta ≤ 40°C T6</p> <p>E II 3G Ex ec IIC T6 Gc -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T6 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc FM21UKEX0080X FM21ATEX0025X IECEEx FMG21.0003X</p> <p>CE II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T5/T4; -40°C ≤ Ta ≤ 40°C T6</p> <p>0344 II 2D Ex ia IIIC T80°C Db FM21UKEX0079X FM21ATEX0003X IECEEx FMG21.0003X</p> <p>UK CA 22815</p> <p>SLP84x Load Cell Ui = 20V li = see table2 Pi = see table 2 Ci = 6nF Li = 30uH</p> <p>+Excitation(Green) -Excitation(Black) +SEN(Yellow) -SEN(Blue) +Signal(White) -Signal(Red)</p> <p>Unclassified Location</p> <p>Ex Approved Associated Apparatus with Entity Concept Parameters Uo ≤ Ui Io ≤ li Po ≤ pi Co ≥ Cc+Ci Lo ≥ Lc+Li</p> <p>Scale structure (attached to load cell) to be connected to system safety ground. See Note.</p> <p>NOTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> The resistance between all safety ground connections and the system grounding electrode must not exceed 1ohm. Installation shall be in accordance with relevant electrical installation standards (Being shown in Table 1)in hazardous areas(other than mines). Entity Parameters Ci And Li Include Maximum Load Cell Cable Length Of 30m Entity Parameters Cc and Lc is the capacitance and inductance of cable connect between load cell and the associated apparatus. In an explosive atmosphere caused by air/dust mixtures, the loose ends of the cable shall be connected outside the hazardous area or in a suitable enclosure with a degree of protection of at least IP6X in accordance with EN 60529. For the application of Ex ec, Ex tc: Urated=20V, Irated=50mA. Installation of load cell needs to be done in such way that enclosure welded caps are physically obstructed from any possible impact. Not following these instructions will jeopardize the explosion safety. For the application of Ex ec, The equipment shall only be used in an area of at least pollution degree 2, as defined in IEC 60664-1. <p>Table 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">EN60079-0: 2018</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-14: 2014</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-11: 2012</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-31: 2014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">EN61241-14: 2004</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-31: 2013</td> <td style="padding: 2px;">EN60079-7: 2015</td> <td style="padding: 2px;">IEC60079-31: 2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-0-2017</td> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-11-2011</td> <td style="padding: 2px;">IEC 60079-14-2013</td> <td style="padding: 2px;">IEC60079-7: 2015</td> </tr> </table> <p>Table 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Temperature class</th> <th style="width: 20%;">Pi</th> <th style="width: 20%;">li</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T4</td> <td>2.1W</td> <td>800mA</td> </tr> <tr> <td>T5</td> <td>1.2W</td> <td>600mA</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>0.6W</td> <td>600mA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland Mettler-Toledo Ltd. 64 Boston Rd, Leicester, LE4 1AW, United Kingdom</p> <p>Table 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">D</th> <th style="width: 50%;">update drawing status</th> <th style="width: 10%;">Wang jianwen</th> <th style="width: 10%;">Liu yuchun</th> <th style="width: 10%;">2021-7-26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>removed Ex nA of note6</td> <td>Wang jianwen</td> <td>Liu yuchun</td> <td>2021-1-15</td> </tr> <tr> <td>REV / CHG</td> <td>ZONE</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>BY APPVD</td> <td>AGENCY E.R. No. DATE</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">RECORD OF CHANGES</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">METTLER TOLEDO</td> <td>MTCZ CN-213022 ChangZhou</td> <td>Drawn Wang JW Change</td> <td>2020/05/11 Scale 1:1 Format mt_A4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten</td> <td>Note -</td> <td colspan="2">Replaces -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Description 防爆安装图 SLP84X</td> <td>ERP NO.</td> <td colspan="2">ERP Rev</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx 30555321</td> <td></td> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td colspan="2">External Design No.: D000644580</td> <td>External Design Rev.: D</td> <td>Status: Approved</td> <td>Mass: Units: mm 1/1</td> </tr> </tbody> </table>	EN60079-0: 2018	EN60079-14: 2014	EN60079-11: 2012	EN60079-31: 2014	EN61241-14: 2004	EN60079-31: 2013	EN60079-7: 2015	IEC60079-31: 2013	IEC 60079-0-2017	IEC 60079-11-2011	IEC 60079-14-2013	IEC60079-7: 2015	Temperature class	Pi	li	T4	2.1W	800mA	T5	1.2W	600mA	T6	0.6W	600mA	D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-7-26	C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-1-15	REV / CHG	ZONE	DESCRIPTION	BY APPVD	AGENCY E.R. No. DATE	RECORD OF CHANGES					METTLER TOLEDO		MTCZ CN-213022 ChangZhou	Drawn Wang JW Change	2020/05/11 Scale 1:1 Format mt_A4	Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Note -	Replaces -		Description 防爆安装图 SLP84X		ERP NO.	ERP Rev		INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx 30555321			D		External Design No.: D000644580		External Design Rev.: D	Status: Approved	Mass: Units: mm 1/1
EN60079-0: 2018	EN60079-14: 2014	EN60079-11: 2012	EN60079-31: 2014																																																																		
EN61241-14: 2004	EN60079-31: 2013	EN60079-7: 2015	IEC60079-31: 2013																																																																		
IEC 60079-0-2017	IEC 60079-11-2011	IEC 60079-14-2013	IEC60079-7: 2015																																																																		
Temperature class	Pi	li																																																																			
T4	2.1W	800mA																																																																			
T5	1.2W	600mA																																																																			
T6	0.6W	600mA																																																																			
D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-7-26																																																																	
C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun	2021-1-15																																																																	
REV / CHG	ZONE	DESCRIPTION	BY APPVD	AGENCY E.R. No. DATE																																																																	
RECORD OF CHANGES																																																																					
METTLER TOLEDO		MTCZ CN-213022 ChangZhou	Drawn Wang JW Change	2020/05/11 Scale 1:1 Format mt_A4																																																																	
Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Note -	Replaces -																																																																		
Description 防爆安装图 SLP84X		ERP NO.	ERP Rev																																																																		
INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx 30555321			D																																																																		
External Design No.: D000644580		External Design Rev.: D	Status: Approved	Mass: Units: mm 1/1																																																																	

AutoCAD Mechanical Template V0.2

METTLER TOLEDO Service

Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne veilederingen og regelmessig kalibrering og vedlikehold utført av vårt serviceteam som er lært opp ved fabrikken, sikrer pålitelig og nøyaktig drift, slik at investeringen din beskyttes. Kontakt oss om en serviceavtale skreddersydd dine behov og økonomi. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.mt.com/service.

Det er flere viktige måter du kan sikre og optimere ytelsen av din investering på:

- 1 **Registrer ditt produkt:** Vi ber deg om å registrere ditt produkt på www.mt.com/productregistration slik at vi kan kontakte deg om forbedringer, oppdateringer og viktig informasjon vedrørende ditt produkt.
- 2 **Kontakt METTLER TOLEDO for service:** Verdien av en måling er proporsjonal med dens nøyaktighet – en vekt som er utenfor spesifikasjonene kan redusere kvaliteten, redusere profitten og øke ansvaret. Service i rett tid fra METTLER TOLEDO vil sikre nøyaktigheten og optimere driftstiden og utstyrets levetid.
 - ➔ **Installasjon, konfigurering, integrering og opplæring:** Våre servicerepresentanter er eksperter på veieutstyr, opplært ved fabrikken. Vi sikrer at ditt veieutstyr er klart for produksjon til rett tid på en kostnadseffektiv måte, og at personell blir opplært for gode resultater.
 - ➔ **Dokumentering av initiell kalibrering:** Installasjonsmiljøet og kravene til bruk er unike for enhver industriell vekt, slik at ytelsen må testes og sertifiseres. Våre kalibreringstjenester og sertifikater dokumenterer nøyaktigheten for å sikre produksjonskvalitet og gi en kvalitetssystem-ytelseslogging.
 - ➔ **Periodisk kalibreringsvedlikehold:** En kalibreringsserviceavtale gir vedvarende tilført til din veieprosess og dokumenterer samsvar med kravene. Vi tilbyr et utvalg av serviceplaner som er tilpasset dine behov og ditt budsjett.

Innhold

1	Sikkerhetsanvisninger	3
1.1	Tiltenk bruk	3
1.2	Misbruk	3
1.3	Sikkerhetstiltak.....	3
1.4	Spesielle bruksbetingelser	3
2	Innledning	4
2.1	Utvalg	4
2.2	Om denne veileddningen	4
2.3	Andre dokumenter.....	4
3	Installasjon og drift	5
3.1	Sjekke plasseringen	5
3.2	Koble veieplattformen til veieterminalen	5
3.3	Vatring	6
3.4	Ekvipotensialutjevning	6
3.5	Sjekke veieplattformen	6
3.6	Drift av veieplattformen	7
3.7	Installasjon, konfigurasjon, service og reparasjon.....	7
4	Vedlikehold	8
4.1	Merknader om rengjøring	8
4.2	Etterbehandling.....	8
4.3	Kassering	8
5	Reparasjon	9
6	Tekniske data og driftsgrenser	10
6.1	Maksimum verifiseringsvektintervall	10
6.2	Maksimum tillatt last	10
6.3	Tekniske data for lastcellen	11
6.3.1	Ex-godkjenning.....	11
6.3.2	Samsvarsstandard for lastcelle	11
6.4	Mål	13
6.5	Informasjon om forbelastingskapasitet	14
6.5.1	Forbelastningstabell i kilogram	15
6.5.2	Forbelastningstabell i pund	16
6.6	Tilbehør	17
7	Monteringsalternativer	19
8	Tillegg	20
8.1	Etikett	20
8.2	Kontrolltegning	21
8.3	Installasjonstegning	22

1 Sikkerhetsanvisninger

1.1 Tiltenkt bruk

PBA439(x/xx) Veieplattformer er en del av et modulært veiesystem som omfatter en METTLER TOLEDO veiterminal som indikator og minst én veieplattform.

- Bruk veieplattformen kun til veiling i samsvar med denne veileddningen.
- Veieplattformen er kun ment for innendørs bruk.
- Bare PBA439x/xx veieplattform er egnet for bruk i farlige omgivelser, som spesifisert nedenfor.
- All annen bruk anses som ikke tiltenkt bruk.

Lovregulert måling

- Ved bruk til lovregulert måling må det bare benyttes godkjente veieplattformer.
- Ved bruk til lovregulert måling er driftsselskapet ansvarlig for å overholde alle nasjonale krav til mål og vekt.
- Vennligst kontakt METTLER TOLEDO serviceorganisasjon når det gjelder spørsmål knyttet til bruk i lovlige handelsapplikasjoner.

1.2 Misbruk

- Ikke bruk veiterminalen til annet enn veieoperasjoner.
- Ikke bruk veieplattformen i andre omgivelser enn det som er spesifisert i --- MISSING LINK ---.
- Ikke utfør modifikasjoner på veieplattformen.
- Ikke bruk veiterminalen utover grensene i de tekniske spesifikasjonene.
- Ikke bruk veieplattformen til lagring av varer.
- Unngå at det faller varer ned på veieplattformen.

1.3 Sikkerhetstiltak

- Bare personale som er opplært og kvalifisert av METTLER TOLEDO, skal installere og vedlikeholde veieplattformen.
- Vær forsiktig ved transport og løfting av tunge enheter.
- Koble alltid veieplattformen fra strømkilden før installasjon, service, rengjøring eller vedlikehold.
- Tilkoblingskabelen må ikke kobles fra veiterminalen når den er aktivert.
- Vent til veieplattformen har nådd romtemperatur før du slår på strømforsyningen.
- De eksplosjonsbeskyttede veieplattformene PBA439x/xx er godkjent for drift i følgende farlige områder:
 - ATEX/IECEx kategori 2, kategori 3, gass/støv (sone 1/21, sone 2/22)
 - cFMus, klasse I,II,III, div. 1, div. 2
- Det er økt fare for personskader og materielle skader når veieplattformene brukes i farlige områder! Man må være ekstra forsiktig under arbeid i slike områder.
- Når det gjelder PBA439x/xx veieplattform, må det bare brukes kabelmuffer som egner seg og er godkjent for bruk i farlige områder, når veiecellekablene kobles til veiterminalen.
- Eksplosjonsbeskyttede veieplattformer kan bare brukes i farlige områder sammen med veiterminaler med egnet godkjennelse og grensesnittspesifikasjon.

1.4 Spesielle bruksbetingelser

- I en eksplosiv atmosfære som skyldes luft-/støvfuktighet, må de ledige endene på kabelen kobles utenfor det farlige området eller i en egnert kapsling med en beskyttelsesgrad på minst IP6X i samsvar med IEC/EN 60529.

2 Innledning

2.1 Utvalg

Denne veiledningen omhandler produktserien PBA439(x/xx).

PBA439(x/xx) Serien tilbyr en rekke veieplattformer for å oppfylle dine behov. Den er godkjennbar og leveres i ulike størrelser og med forskjellig kapasitet

Type	Lastplatema-teriale	Vektrammema-teriale	Lastcellekons-truksjon	Omgivelser IP-beskyttelse	Godkjenning for farlig bruk
PBA439	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål, hermetisk forseglet	Tørre, våte, IP68/IP69K	-
PBA439x	AISI304	AISI304			Sone 1/21, div 1
PBA439xx					Sone 2/22, div 2

2.2 Om denne veiledningen



Denne veiledningen inneholder all informasjon for operatøren av produktet.

- Les denne veiledningen grundig før bruk.
- Ta vare på denne veiledningen for framtidig referanse.
- Legg ved denne veiledningen til eventuelle framtidige eiere eller brukere av produktet.

2.3 Andre dokumenter

I tillegg til denne veiledningen kan du laste ned de følgende dokumentene fra www.mt.com:

- Brosjyre
- Installasjonsinformasjon (for utdannet personell under kontroll av driftsselskapet)
- Typegodkjenningsdokumenter

Nedlasting av sertifikat


Sertifikater for USA, Canada, ATEX, UKEX og IECEx kan lastes ned fra <https://www.mt.com/us/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

3 Installasjon og drift

3.1 Sjekke plasseringen

Riktig plassering er avgjørende for nøyaktigheten av veieresultatene.

- Sørg for at plasseringen av veieplattformen er stabil, vibrasjonsfri og horisontal.
- Underlaget må tåle veieplattformen med maksimal belastning i støttepunktene.
- Overhold følgende krav til omgivelsene:
 - Ikke direkte solskinn
 - Ikke kraftig trekk eller vibrasjoner
 - Ingen ekstreme temperatursvingninger
 - Temperaturområde -10°C til $+40^{\circ}\text{C}$ / 14°F til 104°F

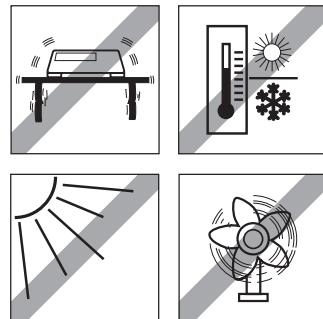

3.2 Koble veieplattformen til veiterminalen

PBA439(x/xx) veieplattformer er beregnet for bruk sammen med analoge METTLER TOLEDO-veiterminaler.

- Stikk veieplattformkabelen gjennom kabelmuffen og inn i veiterminalen.
- Koble veieplattformkabelen til rekkeklemmen på veiterminalen i henhold til tabellen nedenfor.

Signal	Ledningsfarge	Kontakt
SIG+	Hvit	6-LEDNINGS-CELLER LASTCELLE ELLER KOBLINGSBOKS
SIG-	Rød	
EXC+	Grønn	
EXC-	Svart	
SEN+	Gul	
SEN-	Blå	



ADVARSEL

Kabelskjermen må være jordet.

Sikkerhetstiltak for tilkoblinger


- Ved tilkobling av veieplattformen i et farlig område, må kravene på kontrolltegningen som finnes i [Tillegg ▶ side 20], følges strengt.
- Kontroller spesialbetingelsene for sikker bruk på tegningene og sertifikatene i [Tillegg ▶ side 20].
- Kabelskjermen er koblet til lastcellens fjærelement (lastcellens kropp). Husk å sørge for riktig tilkobling mellom lastcelle og klemme (eller koblingsboks) ut fra installasjonsscenariet.
- Motstanden mellom alle sikkerhetsjordingstilkoblingene og systemjordingselektroden må ikke overskride 1 ohm.
- Installasjonen må være i samsvar med relevante elektriske installasjonsstandarder.
- Manglende overholdelse av disse instruksjonene vil sette eksplosjonssikkerheten i fare.

3.3 Vatring

Bare en veieplattform som er justert slik at den er helt horisontal, gir nøyaktige veieresultater. Veieplattformen må vatres under den opprinnelige installasjonen og hver gang den flyttes.

- 1 Drei de justerbare føttene på veieplattformen til luftboblen i libellen befinner seg i den innerste sirkelen.
- 2 Stram låsemutterne på de justerbare bena.

☞ **Skann QR-koden for å se videoen**

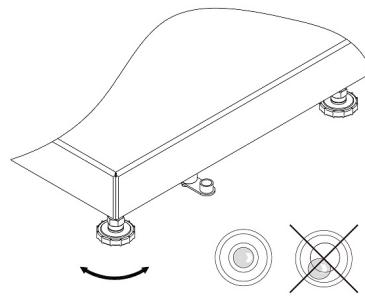


3.4 Ekvipotensialutjevning

Ekvipotensialutjevningen for PBA439x/xx veieplattformer er montert fra fabrikken. Kablingen må installeres av en autorisert elektriker på anleggsstedet. METTLER TOLEDO service har bare en overvåkings- og rådgivningsfunksjon her. Koble ekvipotensialutjevningen (PA) for alle enhetene (veieplattform og veieterminal) i samsvar med gjeldende nasjonale normer og forskrifter. Underveis må du kontrollere at alle enhetsrammene er koblet til det samme potensialet via PA-klemmen.

Merk

Utstyret er beskyttet mot elektrisk støt iht. IEC60950, klasse II.

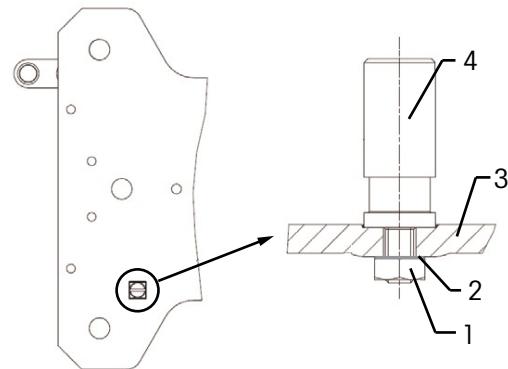


- 1 - Sekskantet låsemutter, M4 KEPS
2 - Skive
3 - Bunngummi
4 - Ekvipotensialutjevningsklemme, dreiemoment 3,5 Nm

Bestillingsnummer for
ekvipotensialutjevningssett
72237321

3.5 Sjekke veieplattformen

Funksjonssjekk

- 1 Forsikre deg om at veieplattformen er koblet til en veieterminal og at veieterminalen er slått på.
- 2 Forsikre deg om at veieplattformen er ubelastet og at displayet på veieterminalen viser 0.
- 3 Belast veieplattformen. Veieterminalen må vise en verdi forskjellig fra 0.
- 4 Avlast veieplattformen. Veieterminalen skal gå tilbake til 0.

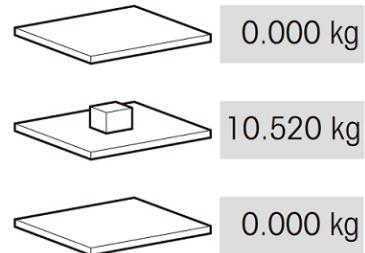


Godkjenningstest

For godkjenningstest, se brukerveiledningen for den tilkoblede veieterminalen. Hvis godkjenningsmerket er brutt, er godkjenningen ikke lenger gyldig.


3.6 Drift av veieplattformen

For best mulige veieresultater, pass på følgende:


- Forsikre deg om at lasteplaten er riktig plassert.

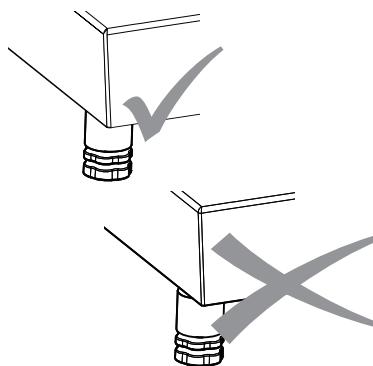


- For å oppnå de beste veieresultatene, plasser alltid veieprøven på samme sted på veieplattformen.

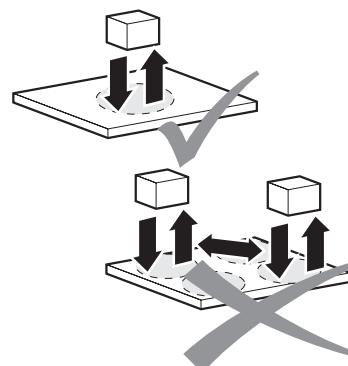

- Unngå prosesser som er abrasive og gir slitasje.

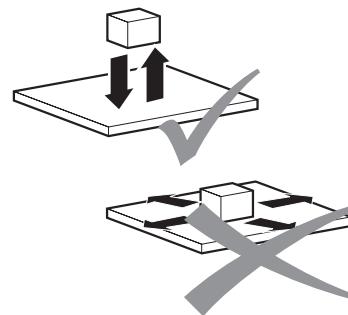

- Unngå fallende laster, støt og sideveis slag.



3.7 Installasjon, konfigurasjon, service og reparasjon

For installasjon, konfigurasjon, service og reparasjon av veieplattformene, kontakt METTLER TOLEDO service.

4 Vedlikehold

4.1 Merknader om rengjøring

Merknad

Skader på veieplattformen på grunn av feil bruk av rengjøringsmidler.


- Bruk kun desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk ikke svært sure, svært alkaliske eller svært klorholdige rengjøringsmidler. Unngå stoffer med høy eller lav pH-verdi, da de fører til økt fare for korrosjon.
- Utvis spesiell forsiktighet ved rengjøring av lastecellen.

Rengjøringsprosedyre

- Fjern skitt og avsetninger fra utsiden og innsiden av veieplattformen med regelmessige intervaller.
→ Prosedyren avhenger både av typen overflate og miljøbetingelsene på installasjonsstedet.


Rengjøring i våte omgivelser (versjoner i rustfritt stål)

- Bruk en vannstråle på opp til 80 °C / 176 °F og maks. 80 bar, minimumsavstand 40 cm / 16".
- Bruk vanlige rengjøringsmidler.



Rengjøring i korrosive omgivelser (versjoner i rustfritt stål)


- Bruk en vannstråle.
Innwendig rengjøring, lastcelle, lastplate åpnet: inntil 60 °C / 140 °F og maks. 2 bar, minimumsavstand 40 cm / 16".
Utvendig rengjøring, lastplate lukket: inntil 80 °C / 176 °F og maks. 80 bar, minimumsavstand 40 cm / 16".
- Fjern korrosive stoffer regelmessig.
- Bruk kun desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler i samsvar med produsentens spesifikasjoner og instruksjoner.



4.2 Etterbehandling

Utfør følgende etterbehandling for å beskytte vekten:

- Skyll vekten med rent vann og fjern alt rengjøringsmiddel fullstendig.
- Tørk av vekten med en lofri klut.
- På vekter i rustfritt stål smøres innsiden og utsiden med en olje egnet for matvarer.



4.3 Kassering

In conformance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.



Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you purchased this device. Should this device be passed on to other parties, the content of this regulation must also be related.

5 Reparasjon

Dette utstyret er sertifisert for bruk på farlige steder, derfor er det ikke tillatt med noen modifikasjoner. Alle reparasjoner skal utføres av personale som har spesialopplæring i reparasjon av dette utstyret.

6 Tekniske data og driftsgrenser

6.1 Maksimum verifiseringsvektintervall


Maks. verifiseringsvekt-intervall [e] / OIML	Kapasitet							
	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
1 x 3000e Max / e [kg]	3 / 0.001	6 / 0.002	15 / 0.005	30 / 0.01	60 / 0.02	150 / 0.05	300 / 0.1	600 / 0.2

Maks. verifiseringsvekt-intervall [d] / NTEP	Kapasitet							
	-	10 lb	25 lb	50 lb	100 lb	250 lb	500 lb	1000 lb
1 x 5000d Max / d [lb]	-	10 / 0.002	25 / 0.005	50 / 0.01	100 / 0.02	250 / 0.05	500 / 0.1	1000 / 0.2

6.2 Maksimum tillatt last

Alle veieplattformer er utstyrt med en overbelastningsbeskyttelse. Med den robuste vektkonstruksjonen kan du av og til overskride nominell kapasitet for plattformen uten at det oppstår skade. Den maksimale statiske bæreevnen må aldri overskrides.

- Overhold driftsgrensene nedenfor.



Modell	A - Sentral last	B - Sidelast	C - Hjørnelast
PBA439(x/xx)-QA	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-A	40 kg / 80 lb	30 kg / 60 lb	15 kg / 30 lb
PBA439(x/xx)-QB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-BB	100 kg / 200 lb	70 kg / 140 lb	35 kg / 70 lb
PBA439(x/xx)-B	200 kg / 400 lb	140 kg / 280 lb	75 kg / 150 lb
PBA439(x/xx)-BC	400 kg / 800 lb	300 kg / 600 lb	150 kg / 300 lb
PBA439(x/xx)-CC	700 kg / 1400 lb	400 kg / 800 lb	200 kg / 400 lb



ADVARSEL

Unngå fallende laster, støtbelastning og sideveis slag.

6.3 Tekniske data for lastcellen

Nominell effekt	mV/V	$1,8 \pm 0,2$
Inngangsmotstand	Ω	384 ± 15
Utgangsmotstand	Ω	350 ± 4
Anbefalt spenning	V (DC / AC)	5 - 15
Maks. eksistert spenning	V (DC / AC)	20
Kabelmantel	-	PVC
IP-klasse	-	IP68/IP69K

6.3.1 Ex-godkjenning

Denne delen omhandler bare de Ex-relevante sidene ved produktet.

Lastcellen SLP84x(x=6,7,8) er tildelt:

ATEX-sertifikat	FM21ATEX0003X, FM21ATEX0025X
UK-sertifikat	FM21UKEX0079X, FM21UKEX0080X
IECEx-sertifikat	IECEx FMG21.0003X
US-sertifikat	FM21US0005X
Kanadisk sertifikat	FM21CA0002X

Sertifikatene over og de tilknyttede installasjonstegningene finner du i [Tillegg ▶ side 20].

6.3.2 Samsvarsstandard for lastcelle

US-standarder

Tittel	Nummer	Utstedt
Elektrisk utstyr for bruk på farlige (klassifiserte) steder – Generelle krav	FM-klasse 3600	2018
Egensikkert apparat og tilknyttet apparat for bruk i klasse I, II og III, divisjon 1, farlige (klassifiserte) steder	FM-klasse 3610	2021
Ikke-tennfarlig elektrisk utstyr for bruk i klasse I og II, divisjon 2, og klasse III, divisjon 1 og 2, farlige (klassifiserte) steder	FM-klasse 3611	2021
Elektrisk utstyr for målings-, kontroll- og laboratoriebruk	FM-klasse 3810	2021
Eksplasive atmosfærer - Del 0: Utstyr - Generelle krav	ANSI/UL 60079-0	2019
Eksplasive atmosfærer - Del 11: Utstyrsbeskyttelse gjennom egen-sikkerhet "i"	ANSI/ISA 60079-11	2014
Ikke-tennfarlig elektrisk utstyr for bruk i klasse I og II, divisjon 2, og klasse III, divisjon 1 og 2, farlige (klassifiserte) steder	ANSI/UL 121201	2017
Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for målings-, kontroll- og laboratorie-bruk - Del 1: Generelle krav	ANSI/UL 61010-1	2012
Beskyttelsesgrad oppnådd gjennom kapslinger (IP-kode)	ANSI/IEC 60529	2020

Kanadiske standarder

Tittel	Nummer	Utstedt
Ikke-tennfarlig elektrisk utstyr for bruk i klasse I, divisjon 2 Farlige steder	CSA C22.2 No. 213	2017
Eksplasive atmosfærer - Del 0: Utstyr - Generelle krav	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0	2019
Eksplasive atmosfærer - Del 11: Utstyrsbeskyttelse gjennom egen-sikkerhet "i"	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11	2014
Eksplasive atmosfærer - Del 7: Utstyrsbeskyttelse gjennom økt sikkerhet "e"	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-7	2018
Eksplasive atmosfærer - Del 31: Utstyr støvantennelsesbeskyttelse gjennom kapsling "t"	CAN/CSA-C22.2 No. 60079-31	2015

Tittel	Nummer	Utstedt
Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for målings-, kontroll- og laboratoriebruk - Del 1: Generelle krav	CSA C22.2 nr. 61010-1	2012
Beskyttelsesgrad oppnådd gjennom kapslinger (IP-kode)	CSA C22.2 No. 60529	2016

IECEx-standarder

Tittel	Nummer	Utstedt
Eksplosive atmosfærer - Del 0: Utstyr - Generelle krav	IEC 60079-0	2017
Eksplosive atmosfærer - Del 11: Utstyr beskyttelse gjennom egen-sikkerhet "i"	IEC 60079-11	2011
Eksplosive atmosfærer - Del 7: Utstyr beskyttelse gjennom økt sikkerhet "e"	IEC 60079-7	2017
Eksplosive atmosfærer - Del 31: Utstyr støvantennelsesbeskyttelse gjennom kapsling "t"	IEC 60079-31	2013
Beskyttelsesgrad oppnådd gjennom kapslinger (IP-kode)	IEC 60529	2013


ATEX-standarder

Tittel	Nummer	Utstedt
Eksplosive atmosfærer - Del 0: Utstyr - Generelle krav	EN IEC 60079-0	2018
Eksplosive atmosfærer - Del 11: Utstyr beskyttelse gjennom egen-sikkerhet "i"	EN 60079-11	2012
Eksplosive atmosfærer - Del 7: Utstyr beskyttelse gjennom økt sikkerhet "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Eksplosive atmosfærer - Del 31: Utstyr støvantennelsesbeskyttelse gjennom kapsling "t"	EN 60079-31	2014
Beskyttelsesgrad oppnådd gjennom kapslinger (IP-kode)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

UKEX-standarder

Tittel	Nummer	Utstedt
Eksplosive atmosfærer - Del 0: Utstyr - Generelle krav	EN IEC 60079-0	2018
Eksplosive atmosfærer - Del 11: Utstyr beskyttelse gjennom egen-sikkerhet "i"	EN 60079-11	2012
Eksplosive atmosfærer - Del 7: Utstyr beskyttelse gjennom økt sikkerhet "e"	EN 60079-7	2015 +A1:2018
Eksplosive atmosfærer - Del 31: Utstyr støvantennelsesbeskyttelse gjennom kapsling "t"	EN 60079-31	2014
Beskyttelsesgrad oppnådd gjennom kapslinger (IP-kode)	EN 60529	1991 + A1:2000 + A2:2013

6.4 Mål

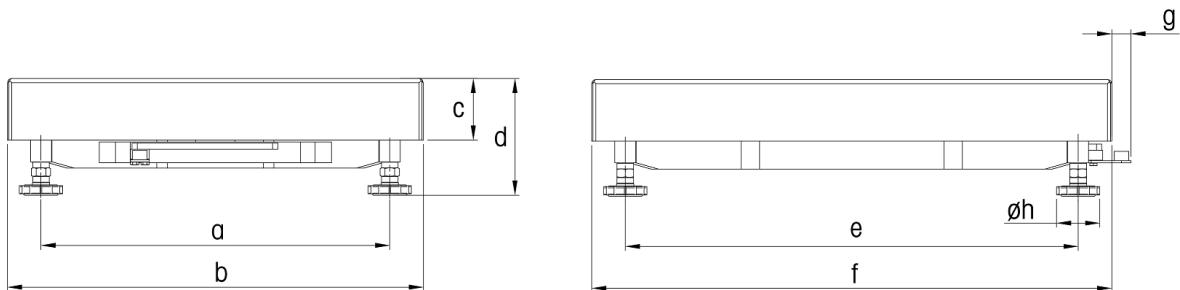


Mål		a	b	c	d *	e	f	g	h
PBA439(x/xx)-QA	mm	163	228	56	85,6	163	228	21	42
	tomme	6,42	8,98	2,20	3,37	6,42	8,98	0,83	1,65
PBA439(x/xx)-A	mm	175	240	56	85,6	235	300	21	42
	tomme	6,89	9,45	2,20	3,37	9,25	11,81	0,83	1,65
PBA439(x/xx)-QB	mm	240	305	57	96,6	253	305	18	42
	tomme	9,45	12,01	2,24	3,8	9,96	12,01	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-BB	mm	235	300	57	96,6	335	400	18	42
	tomme	9,25	11,81	2,24	3,8	13,19	15,75	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-B	mm	335	400	59	100,1	435	500	18	42
	tomme	13,19	15,75	2,32	3,94	17,13	19,69	0,71	1,65
PBA439(x/xx)-BC	mm	437	500	73	106,8	584	650	17	42
	tomme	17,20	19,69	2,87	4,2	22,99	25,59	0,67	1,65
PBA439(x/xx)-CC	mm	503	600	85	128,3	724	800	18	42
	tomme	19,80	23,62	3,35	5,05	28,5	31,50	0,71	1,65

* : 1) d= minimum plattformhøyde. Med vektens justerbare føtter kan plattformhøyden økes med maksimalt 10 mm / 0,39 tommer.

2) Med hygienesettet (tilleggsutstyr) økes plattformens minimumshøyde (d) med 12 mm / 0,47 tommer.

6.5 Informasjon om forbelastingskapasitet

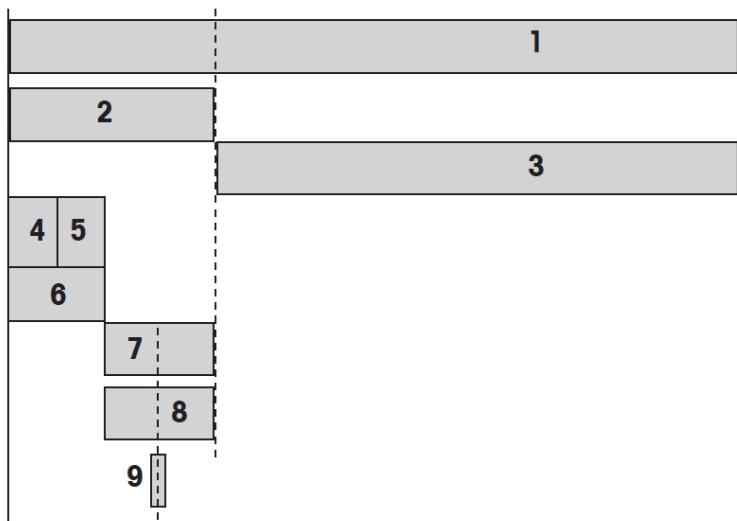

1	Maksimalt belastningsområde for lastcellen (E_{max})
2	Maksimal forbelastning = Maksimalt belastningsområde 1 – Maksimal belastning 3
3	Maksimal last = Maksimalt belastningsområde 1 – Maksimal forbelastning 2
4	Forbelastning toppseksjon
5	Forbelastning veieskål
6	Forbelastning fra fabrikk = Forbelastning toppseksjon 4 + Forbelastning veieskål 5
7	Mekanisk forbelastningsreserve = Maksimal forbelastning 2 – Forbelastning fra fabrikk 6
8	Nullstillingsområdet (slå på) kan stilles inn. Nullstillingsområdet må ligge innenfor maksimal forbelastning. Nullstillingsområdet kan maks. være 18 % av maksimal belastning.
9	Nullstillingsområde $\pm 2\%$ av den maksimale belastningen

6.5.1 Forbelastningstabell i kilogram

Type	Mål [mm]	Maks. belastning (3)	Forbelastning toppseksjon (4)	Forbelastning veieskål (5)	Forbelastning fra fabrikk (6)	Mek. Forbelastningsreserve (7)	Nullstillingsområde (8)	Maks. belastningsområde (1)
PBA439(x/xx)-QA3	228x228	3	1,04	0,95	1,99	6,01	0,54	11
PBA439(x/xx)-QA6	228x228	6	1,04	0,95	1,99	3,01	1,08	11
PBA439(x/xx)-A3	240x300	3	1,49	1,23	2,72	5,28	0,54	11
PBA439(x/xx)-A6	240x300	6	1,49	1,23	2,72	2,28	1,08	11
PBA439(x/xx)-A15	240x300	15	1,49	1,23	2,72	4,28	2,70	22
PBA439(x/xx)-QB15	305x305	15	1,70	1,51	3,21	3,79	2,70	22
PBA439(x/xx)-QB30	305x305	30	1,70	1,51	3,21	16,79	5,40	50
PBA439(x/xx)-QB60	305x305	60	1,70	1,51	3,21	36,79	10,80	100
PBA439(x/xx)-BB30	300x400	30	2,08	1,86	3,94	16,06	5,40	50
PBA439(x/xx)-BB60	300x400	60	2,08	1,86	3,94	36,06	10,80	100
PBA439(x/xx)-B30	400x500	30	3,45	2,85	6,30	13,70	5,40	50
PBA439(x/xx)-B60	400x500	60	3,45	2,85	6,30	33,70	10,80	100
PBA439(x/xx)-B150	400x500	150	3,45	2,85	6,30	43,70	27,00	200
PBA439(x/xx)-BC60	500x650	60	7,00	5,80	12,80	27,20	10,80	100
PBA439(x/xx)-BC150	500x650	150	7,00	58,00	65,00	35,00	27,00	250
PBA439(x/xx)-BC300	500x650	300	7,00	5,80	12,80	187,20	54,00	500
PBA439(x/xx)-CC60	600x800	60	9,36	11,00	20,36	19,64	10,80	100
PBA439(x/xx)-CC150	600x800	150	9,36	11,00	20,36	79,64	27,00	250
PBA439(x/xx)-CC300	600x800	300	9,36	11,00	20,36	179,64	54,00	500
PBA439(x/xx)-CC600	600x800	600	11,50	14,10	25,60	124,40	108,00	750

6.5.2 Forbelastningstabell i pund

Type	Mål [tomme]	Maks. belast- ning (3)	Forbelas- ting toppsek- sjon (4)	Forbelast- ning veie- skål (5)	Forbelast- ning fra fabrikk (6)	Mek. Forbelast- ningsre- serve (7)	Nullstillin- gs- område (8)	Maks. belast- nings- område (1)
PBA439(x/xx)-QA6	9x9	10	2,29	2,09	4,39	9,86	1,8	24
PBA439(x/xx)-A6	9,5x11,8	10	3,28	2,71	6,00	8,25	1,8	24
PBA439(x/xx)-A15	9,5x11,8	25	3,28	2,71	6,00	17,51	4,5	49
PBA439(x/xx)-QB15	12x12	25	3,75	3,33	7,08	16,42	4,5	49
PBA439(x/xx)-QB30	12x12	50	3,75	3,33	7,08	53,15	9,0	110
PBA439(x/xx)-QB60	12x12	100	3,75	3,33	7,08	113,39	18,0	220
PBA439(x/xx)-BB30	11,8x15,7	50	4,59	4,10	8,69	51,54	9,0	110
PBA439(x/xx)-BB60	11,8x15,7	100	4,59	4,10	8,69	111,78	18,0	220
PBA439(x/xx)-B30	15,7x19,7	50	7,61	6,28	13,89	46,34	9,0	110
PBA439(x/xx)-B60	15,7x19,7	100	7,61	6,28	13,89	106,57	18,0	220
PBA439(x/xx)-B150	15,7x19,7	250	7,61	6,28	13,89	177,04	45,0	441
PBA439(x/xx)-BC60	19,7x25,6	100	15,43	12,79	28,22	92,24	18,0	220
PBA439(x/xx)-BC150	19,7x25,6	250	15,43	127,87	143,30	157,86	45,0	551
PBA439(x/xx)-BC300	19,7x25,6	500	15,43	12,79	28,22	574,09	90,0	1102
PBA439(x/xx)-CC60	23,6x29,5	100	20,64	24,25	44,89	75,58	18,0	220
PBA439(x/xx)-CC150	23,6x29,5	250	20,64	24,25	44,89	256,27	45,0	551
PBA439(x/xx)-CC300	23,6x29,5	500	20,64	24,25	44,89	557,43	90,0	1102
PBA439(x/xx)-CC600	23,6x29,5	1000	25,35	31,09	56,44	597,03	180,0	1653

6.6 Tilbehør

Søyle

Artikkel #	Betegnelse	Beskrivelse
72229393	Søyle åpen 120 mm / 4,7"	Egnet til alle plattformstørrelser
72198702	Søyle åpen 330 mm / 13"	Egnet til alle plattformstørrelser
72198703	Søyle åpen 660 mm / 26"	Egnet til alle plattformstørrelser
72198704	Søyle åpen 900 mm / 35,4"	Egnet til alle plattformstørrelser over A-størrelse

Vogn, rustfritt stål

Artikkel #	Betegnelse	Beskrivelse
72225939	Vogn, rustfritt stål BC	Egnet til plattform i BC-størrelse
72225940	Vogn, rustfritt stål CC	Egnet til plattform i CC-størrelse

Rullebane

Artikkel #	Betegnelse	Beskrivelse
30253326	Rullebane 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rustfritt stål	Egnet til plattform i B-størrelse. Rulles til kortssiden av plattformen
30253328	Rullebane 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rustfritt stål	Egnet assen til plattform i BC-størrelse. Rulles til kortssiden av plattformen
30253330	Rullebane 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rustfritt stål	Egnet til plattform i CC-størrelse. Rulles til kortssiden av plattformen
30253327	Rullebane 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rustfritt stål	Egnet til plattform i B-størrelse. Rulles til langsiden av plattformen
30253329	Rullebane 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rustfritt stål	Egnet assen til plattform i BC-størrelse. Rulles til langsiden av plattformen
30253331	Rullebane 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rustfritt stål	Egnet til plattform i CC-størrelse. Rulles til langsiden av plattformen
30640393	Rullebane 400 × 500 mm / 15,7" × 19,7" rustfritt stål	Egnet til farlig område
30640394	Rullebane 500 × 650 mm / 19,7" × 25,6" rustfritt stål	Egnet til farlig område
30640395	Rullebane 600 × 800 mm / 23,6" × 31,5" rustfritt stål	Egnet til farlig område

Brakett til frontmontering

Artikkel #	Betegnelse	Beskrivelse
22021062	Brakett til frontmontering	Egnet til ICS4_9 frontmontering

Plate, rustfritt stål


Artikkel #	Betegnelse	Beskrivelse
30676769	AISI 316 plate, rustfritt stål 240 x 300 mm / 9,5" x 11,8"	Egnet til plattform i A-størrelse
30676770	AISI 316 plate, rustfritt stål 300 x 400 mm / 11,8" x 15,7"	Egnet til plattform i BB-størrelse
30676771	AISI 316 plate, rustfritt stål 400 x 500 mm / 15,7" x 19,7"	Egnet til plattform i B-størrelse
30676772	AISI 316 plate, rustfritt stål 228 x 228 mm / 9" x 9"	Egnet til plattform i QA-størrelse
30676773	AISI 316 plate, rustfritt stål 305 x 305 mm / 12" x 12"	Egnet til plattform i QB-størrelse
30676774	AISI 316 plate, rustfritt stål 500 x 650 mm / 19,7" x 25,6"	Egnet til plattform i BC-størrelse

Artikkel #	Betegnelse	Beskrivelse
30676775	AISI 316 plate, rustfritt stål, tykkelse 2,0 mm, 600 x 800 mm /23,6" x 31,5"	Egnet til plattform i CC-størrelse
30676776	AISI 316 plate, rustfritt stål, tykkelse 2,5 mm, 600 x 800 mm /23,6" x 31,5"	Egnet til plattform i CC-størrelse

7 Monteringsalternativer



PBA439(x/xx) støtter montering på stabil enhet. Hvis det kreves boring på veieplattformen, må boremønsteret under følges.

MERK: Boring er tillatt på de skraverte feltene på veieplattformen.

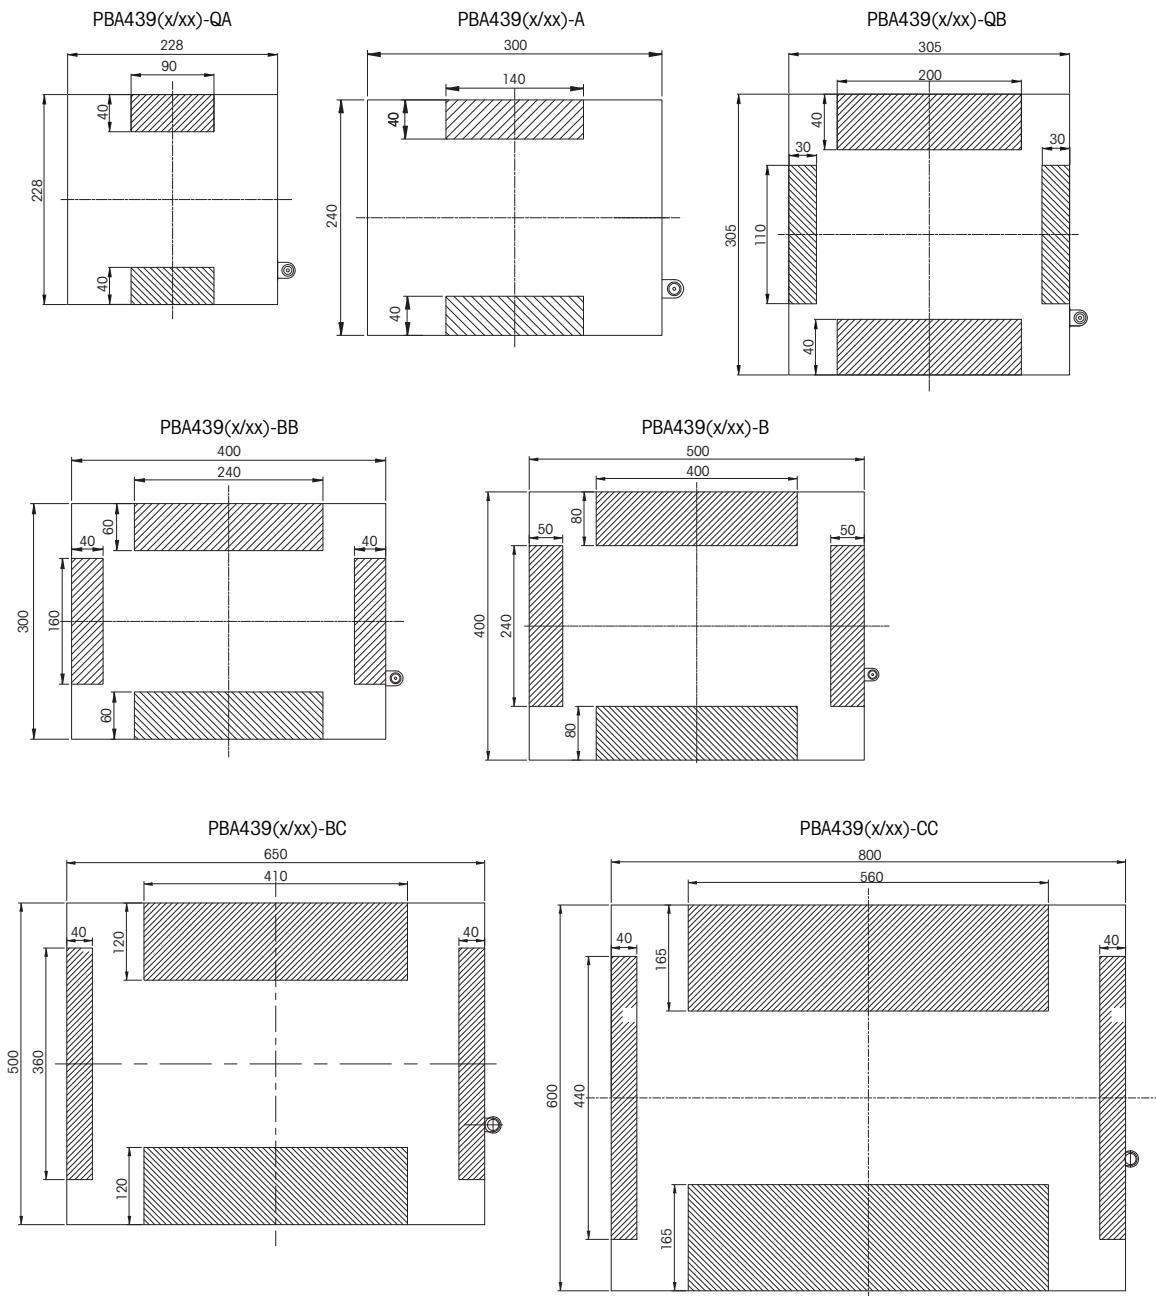


8 Tillegg

8.1 Etikett

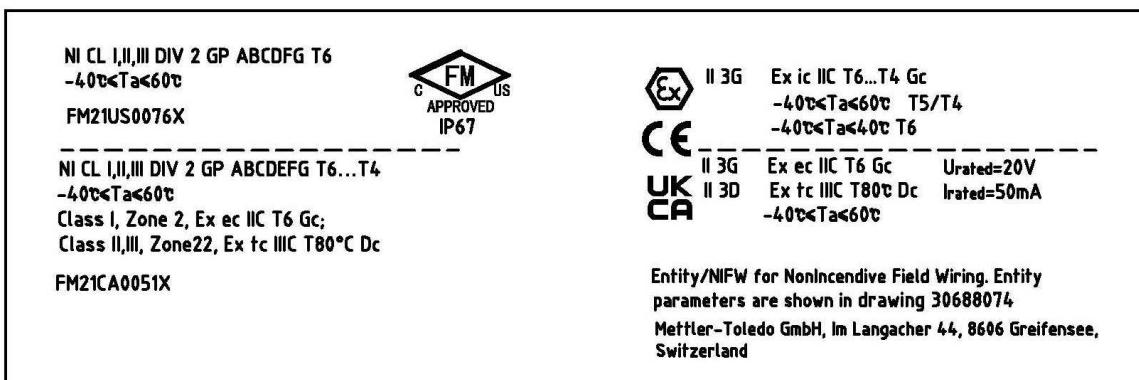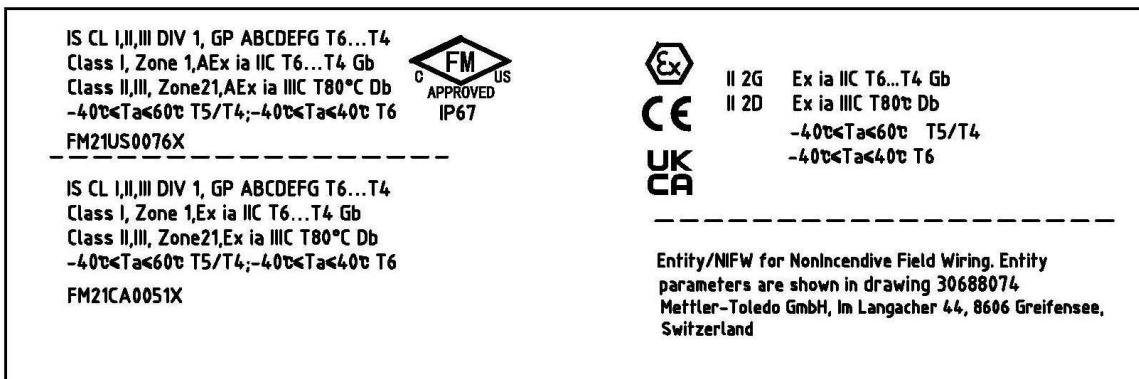

8.2 Kontrolltegning

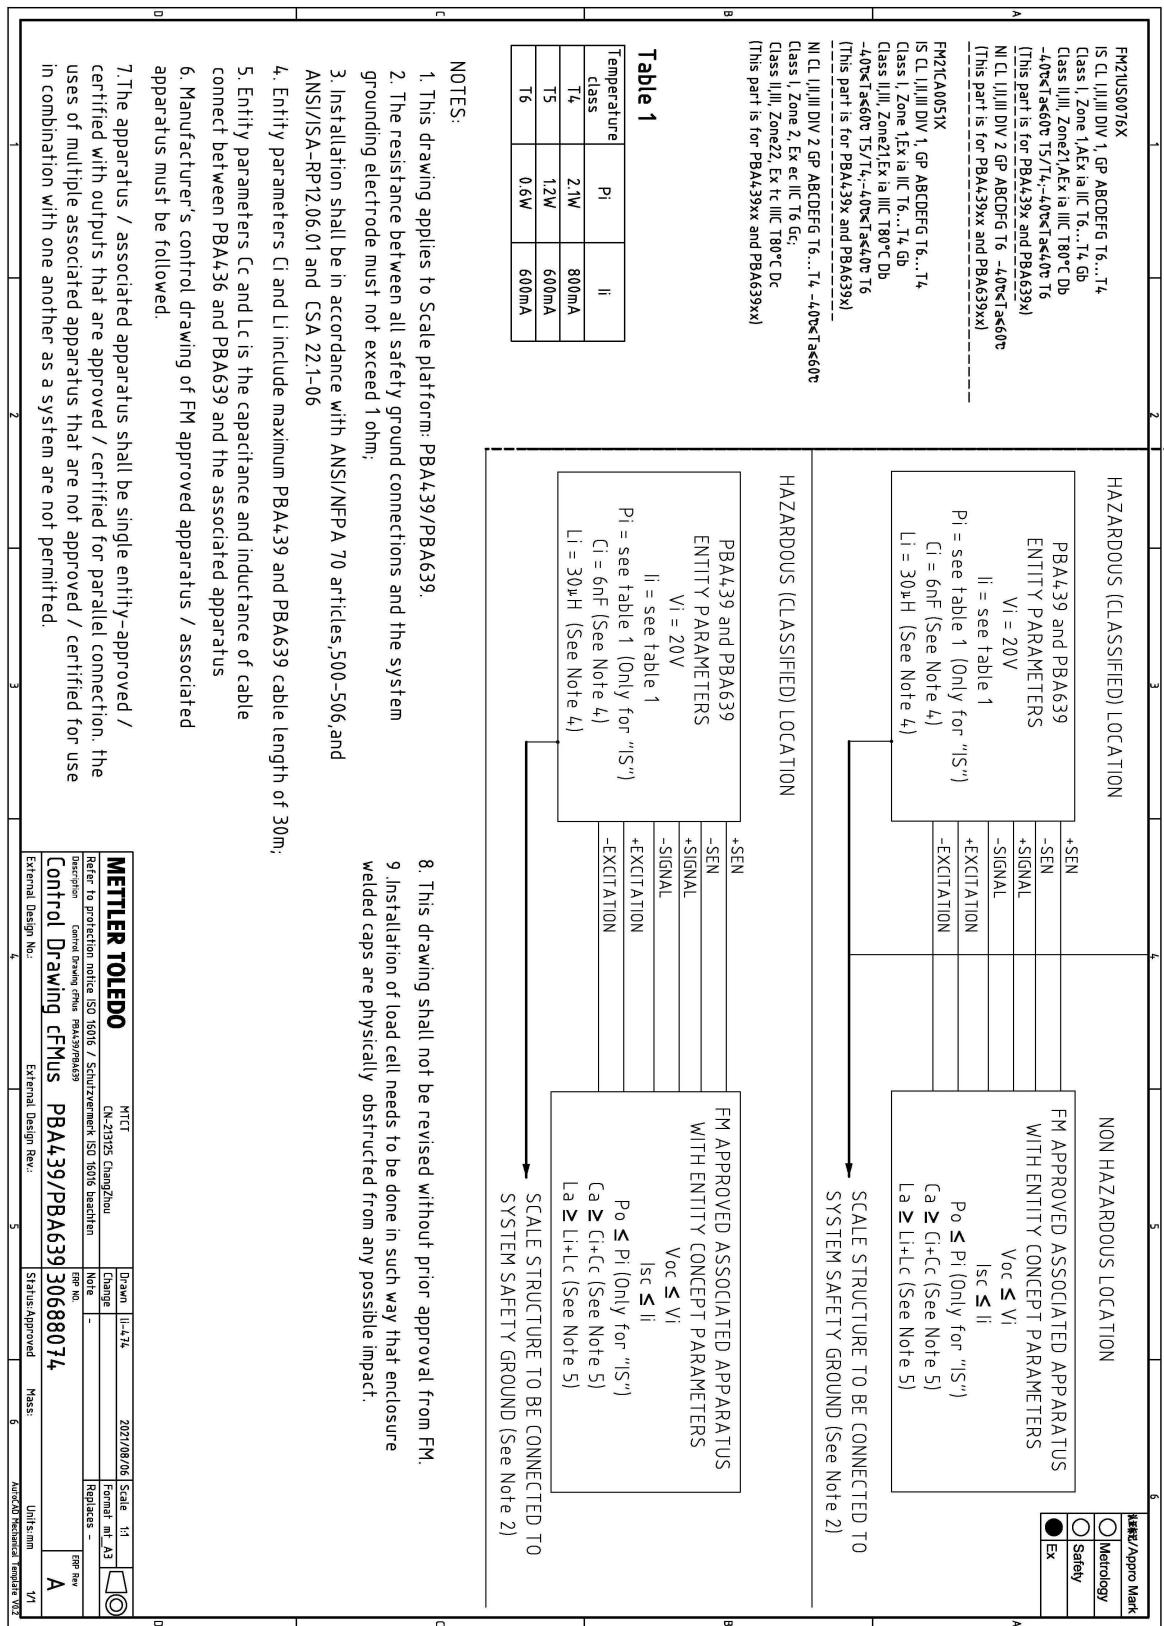

8.3 Installasjonsstegning

<p style="text-align: center;">Hazardous (Classified) Location</p> <p style="text-align: right;">Approval Mark THIS ITEM IS PART OF AGENCY APPROVED PRODUCT <input type="checkbox"/> Metrology <input type="checkbox"/> Safety <input checked="" type="checkbox"/> Ex DO NOT CHANGE DOCUMENT WITHOUT APPROPRIATE APPROVAL</p> <p>IP67 II 3G Ex ic IIC T6...T4 Gc -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T5/T4; -40°C ≤ Ta ≤ 40°C T6</p> <p>E CE UK CA FM21UKEX0080X FM21ATEX0025X IECEEx FMG21.0003X</p> <p>II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb -40°C ≤ Ta ≤ 60°C T5/T4; -40°C ≤ Ta ≤ 40°C T6</p> <p>E CE 0344 UK CA 22815 II 2D Ex ia IIIC T80°C Db FM21UKEX0079X FM21ATEX0003X IECEEx FMG21.0003X</p> <p>SLP84x Load Cell Ui = 20V li = see table2 Pi = see table 2 Ci = 6nF Li = 30uH</p> <p>+Excitation(Green) -Excitation(Black) +SEN(Yellow) -SEN(Blue) +Signal(White) -Signal(Red)</p> <p>Unclassified Location</p> <p>Ex Approved Associated Apparatus with Entity Concept Parameters Uo ≤ Ui Io ≤ li Po ≤ pi Co ≥ Cc+Ci Lo ≥ Lc+Li</p> <p>Scale structure (attached to load cell) to be connected to system safety ground. See Note.</p> <p>NOTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> The resistance between all safety ground connections and the system grounding electrode must not exceed 1ohm. Installation shall be in accordance with relevant electrical installation standards (Being shown in Table 1)in hazardous areas(other than mines). Entity Parameters Ci And Li Include Maximum Load Cell Cable Length Of 30m Entity Parameters Cc and Lc is the capacitance and inductance of cable connect between load cell and the associated apparatus. In an explosive atmosphere caused by air/dust mixtures, the loose ends of the cable shall be connected outside the hazardous area or in a suitable enclosure with a degree of protection of at least IP6X in accordance with EN 60529. For the application of Ex ec, Ex tc: Urated=20V, Irated=50mA. Installation of load cell needs to be done in such way that enclosure welded caps are physically obstructed from any possible impact. Not following these instructions will jeopardize the explosion safety. For the application of Ex ec, The equipment shall only be used in an area of at least pollution degree 2, as defined in IEC 60664-1. <p>Table 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>EN60079-0: 2018 EN60079-14: 2014 EN60079-11: 2012 EN60079-31: 2014 EN61241-14: 2004 EN60079-31: 2013 EN60079-7: 2015 IEC60079-31: 2013 IEC 60079-0-2017 IEC 60079-11-2011 IEC 60079-14-2013 IEC60079-7: 2015</td> </tr> </table> <p>Table 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Temperature class</th> <th>Pi</th> <th>li</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T4</td> <td>2.1W</td> <td>800mA</td> </tr> <tr> <td>T5</td> <td>1.2W</td> <td>600mA</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>0.6W</td> <td>600mA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher 44, 8606 Greifensee, Switzerland Mettler-Toledo Ltd. 64 Boston Rd, Leicester, LE4 1AW, United Kingdom</p> <p>Table 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>update drawing status</th> <th>Wang jianwen</th> <th>Liu yuchun</th> <th></th> <th>2021-7-26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>removed Ex nA of note6</td> <td>Wang jianwen</td> <td>Liu yuchun</td> <td></td> <td>2021-1-15</td> </tr> <tr> <td>REV / CHG</td> <td>ZONE</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>BY</td> <td>APPVD</td> <td>AGENCY</td> <td>E.R. No.</td> <td>DATE</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">RECORD OF CHANGES</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">METTLER TOLEDO</td> <td>MTCZ CN-213022 ChangZhou</td> <td>Drawn</td> <td>Wang JW</td> <td>2020/05/11</td> <td>Scale 1:1</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Change</td> <td></td> <td></td> <td>Format mt_A4</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten</td> <td>Note</td> <td>-</td> <td></td> <td>Replaces -</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Description</td> <td>防爆安装图 SLP84X</td> <td>ERP NO.</td> <td></td> <td></td> <td>ERP Rev</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx</td> <td>30555321</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">External Design No.: D000644580</td> <td>External Design Rev.: D</td> <td>Status: Approved</td> <td>Mass:</td> <td>Units: mm</td> <td>1/1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	EN60079-0: 2018 EN60079-14: 2014 EN60079-11: 2012 EN60079-31: 2014 EN61241-14: 2004 EN60079-31: 2013 EN60079-7: 2015 IEC60079-31: 2013 IEC 60079-0-2017 IEC 60079-11-2011 IEC 60079-14-2013 IEC60079-7: 2015	Temperature class	Pi	li	T4	2.1W	800mA	T5	1.2W	600mA	T6	0.6W	600mA	D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun		2021-7-26	C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun		2021-1-15	REV / CHG	ZONE	DESCRIPTION	BY	APPVD	AGENCY	E.R. No.	DATE	RECORD OF CHANGES								METTLER TOLEDO		MTCZ CN-213022 ChangZhou	Drawn	Wang JW	2020/05/11	Scale 1:1	<input type="checkbox"/>				Change			Format mt_A4	<input type="checkbox"/>			Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Note	-		Replaces -		Description		防爆安装图 SLP84X	ERP NO.			ERP Rev				INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx	30555321			D		External Design No.: D000644580		External Design Rev.: D	Status: Approved	Mass:	Units: mm	1/1		<p style="text-align: right;">AutoCAD Mechanical Template V0.2</p>
EN60079-0: 2018 EN60079-14: 2014 EN60079-11: 2012 EN60079-31: 2014 EN61241-14: 2004 EN60079-31: 2013 EN60079-7: 2015 IEC60079-31: 2013 IEC 60079-0-2017 IEC 60079-11-2011 IEC 60079-14-2013 IEC60079-7: 2015																																																																																										
Temperature class	Pi	li																																																																																								
T4	2.1W	800mA																																																																																								
T5	1.2W	600mA																																																																																								
T6	0.6W	600mA																																																																																								
D	update drawing status	Wang jianwen	Liu yuchun		2021-7-26																																																																																					
C	removed Ex nA of note6	Wang jianwen	Liu yuchun		2021-1-15																																																																																					
REV / CHG	ZONE	DESCRIPTION	BY	APPVD	AGENCY	E.R. No.	DATE																																																																																			
RECORD OF CHANGES																																																																																										
METTLER TOLEDO		MTCZ CN-213022 ChangZhou	Drawn	Wang JW	2020/05/11	Scale 1:1	<input type="checkbox"/>																																																																																			
			Change			Format mt_A4	<input type="checkbox"/>																																																																																			
		Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Note	-		Replaces -																																																																																				
Description		防爆安装图 SLP84X	ERP NO.			ERP Rev																																																																																				
		INSTALLATION DRAWING SLP84X ATEX/IECEEx	30555321			D																																																																																				
External Design No.: D000644580		External Design Rev.: D	Status: Approved	Mass:	Units: mm	1/1																																																																																				

To protect your product's future:

METTLER TOLEDO Service assures the quality, measuring accuracy and preservation of value of this product for years to come.

Please request full details about our attractive terms of service.

www.mt.com

For more information

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject to technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 01/2022
30704764B



30704764